AIOF OSTENDE 2015

AIOF OSTENDE 2015

LA SOLUTION GLOBALE NUMERIQUE


Axe Ortho
Laboratoire d'Orthodontie

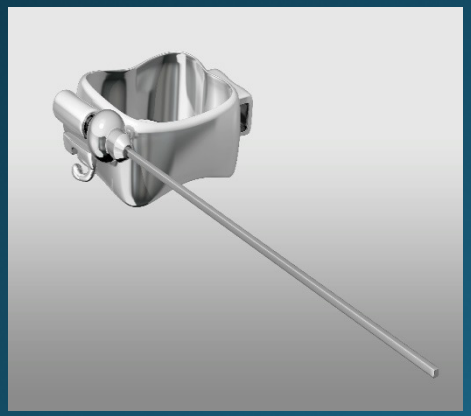

Optimax
Global Class II Treatment

Optimax Lab



Optimax Distaler





Optimax Fix

DE L’ ORTHODONTIE

DE L'ORTHODONTIE
A L'ORTHODONTIE NUMERIQUE

LA CHAINE NUMERIQUE

LA CHAINE NUMERIQUE

REFLECHIR POUR CONSTITUER UNE CHAINE NUMERIQUE GLOBALE

La Solution Globale 3 D

Empreintes alginates ou silicones et plâtre



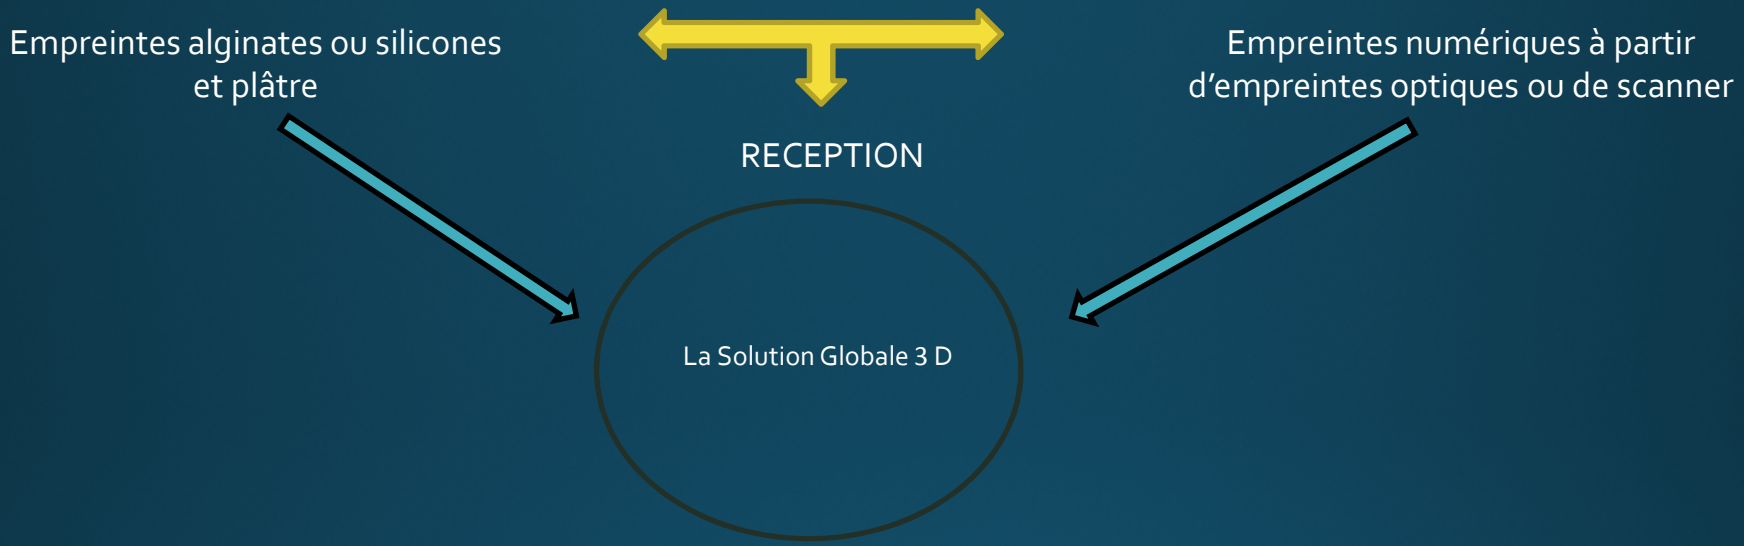
RECEPTION

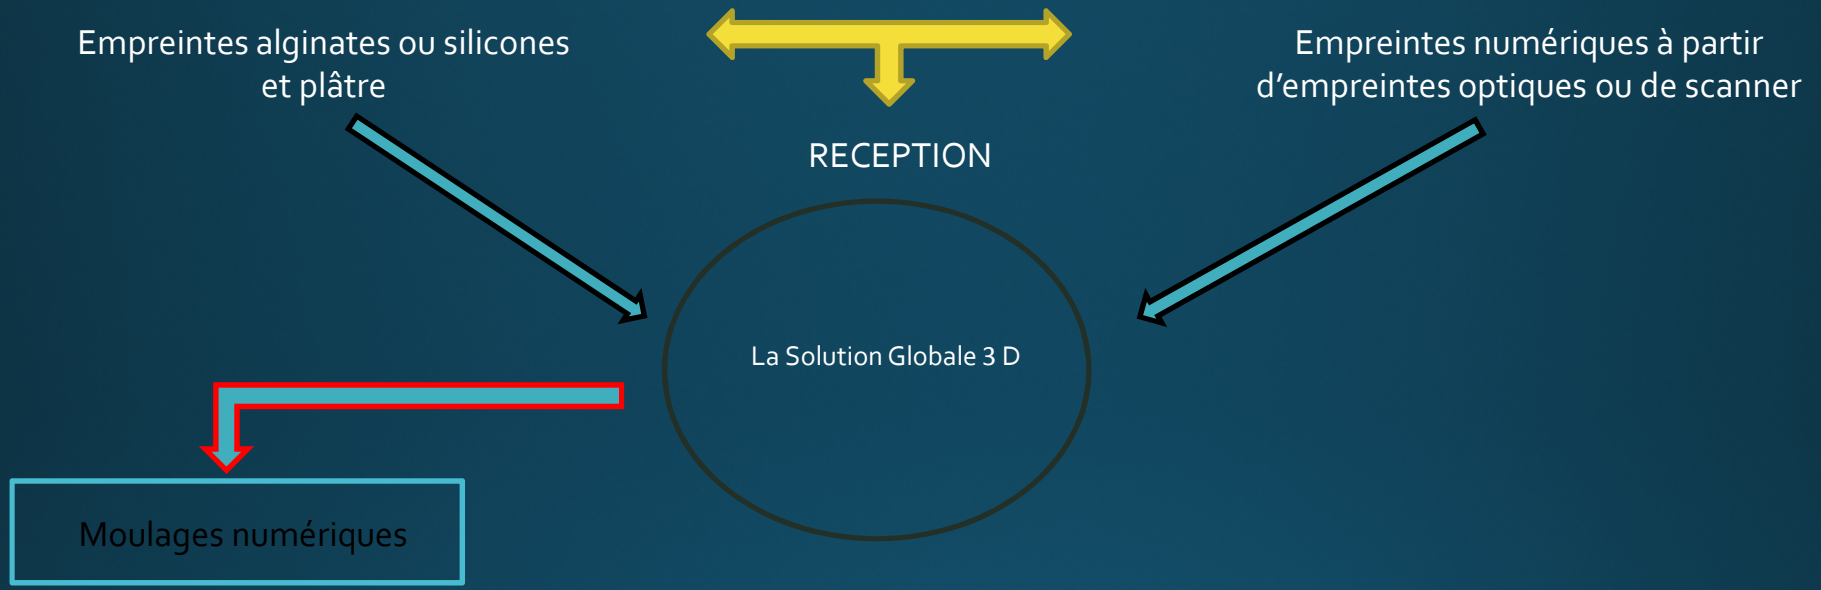
Empreintes alginates ou silicones et plâtre

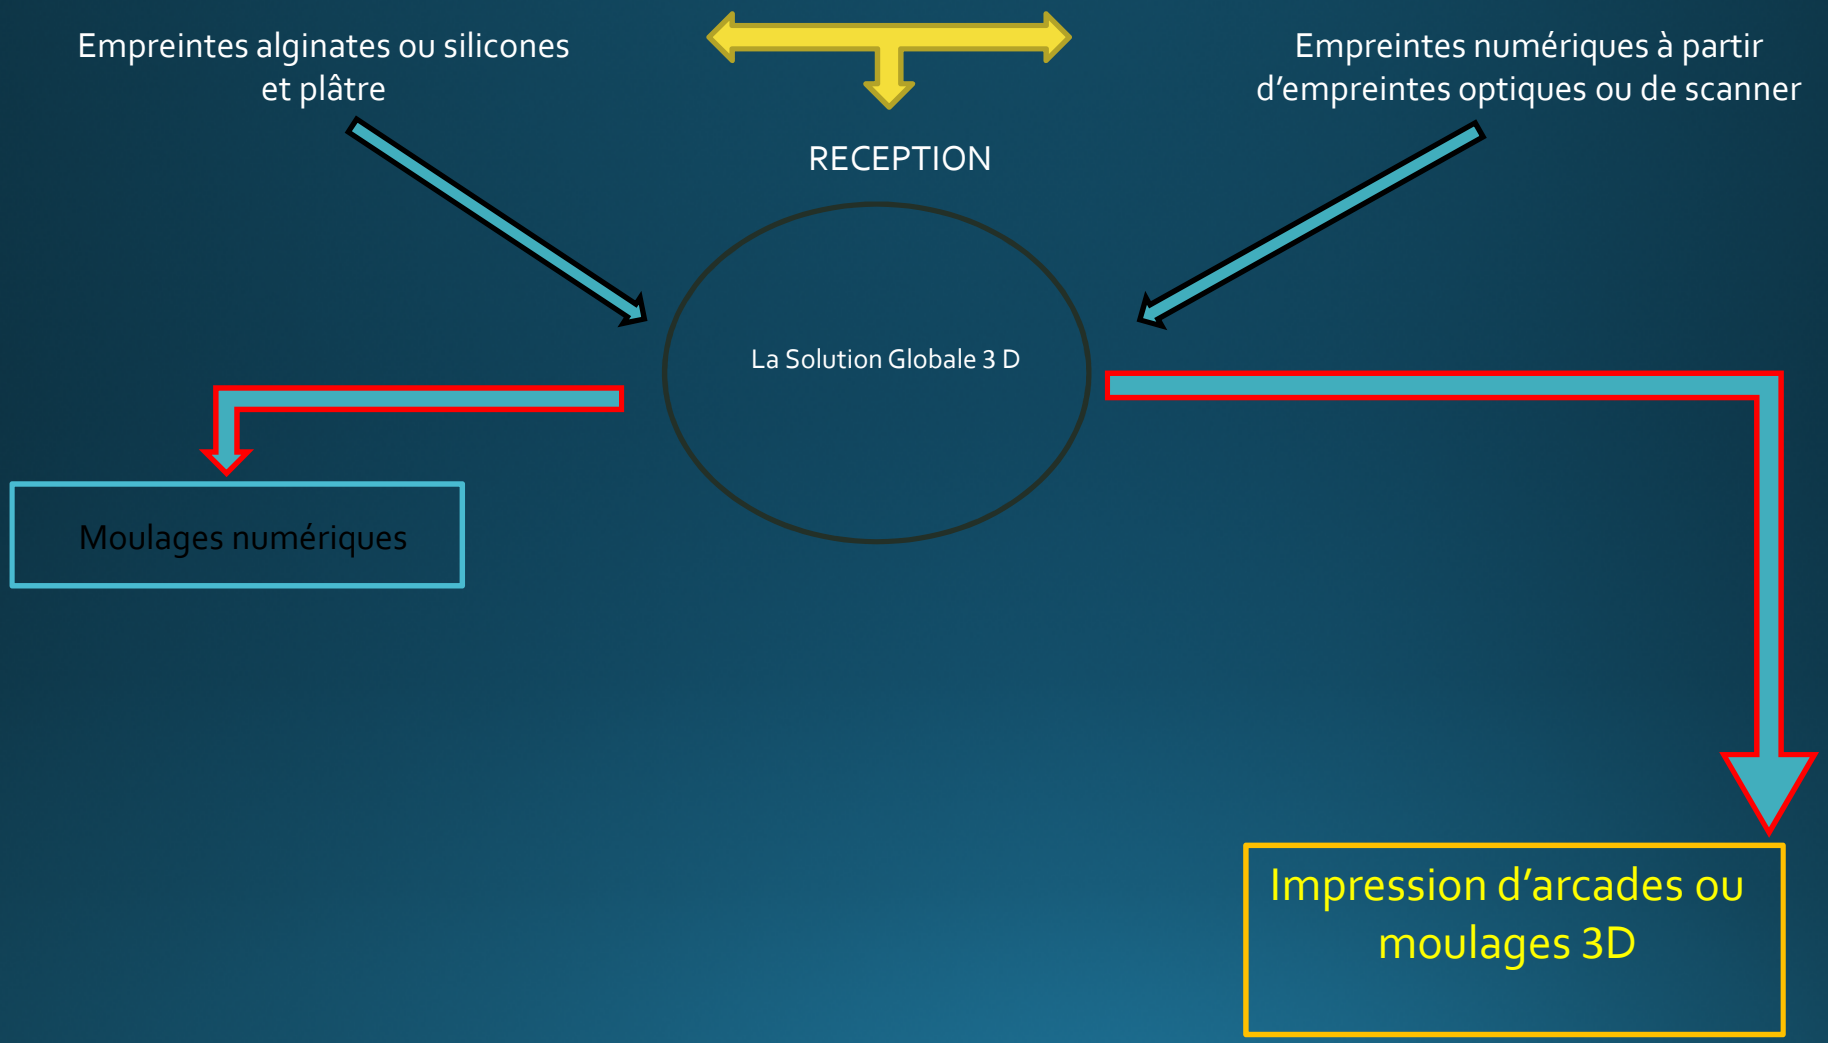


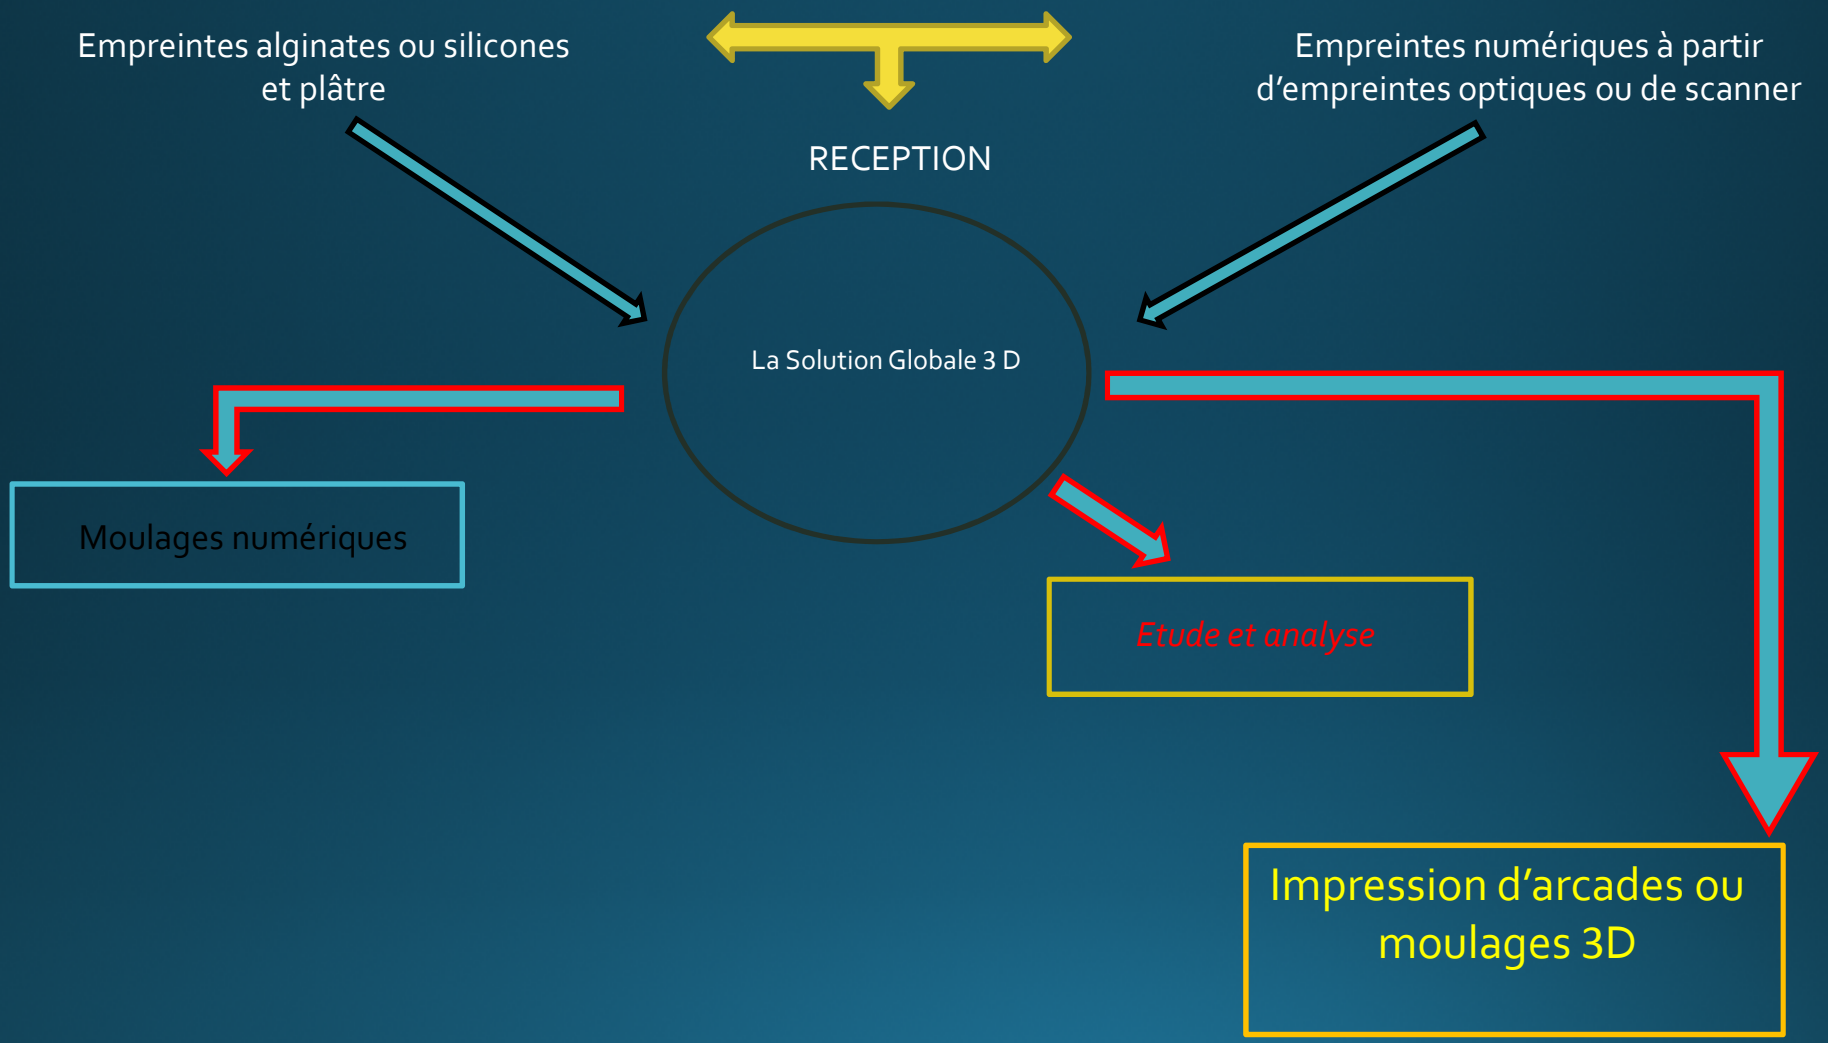
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner

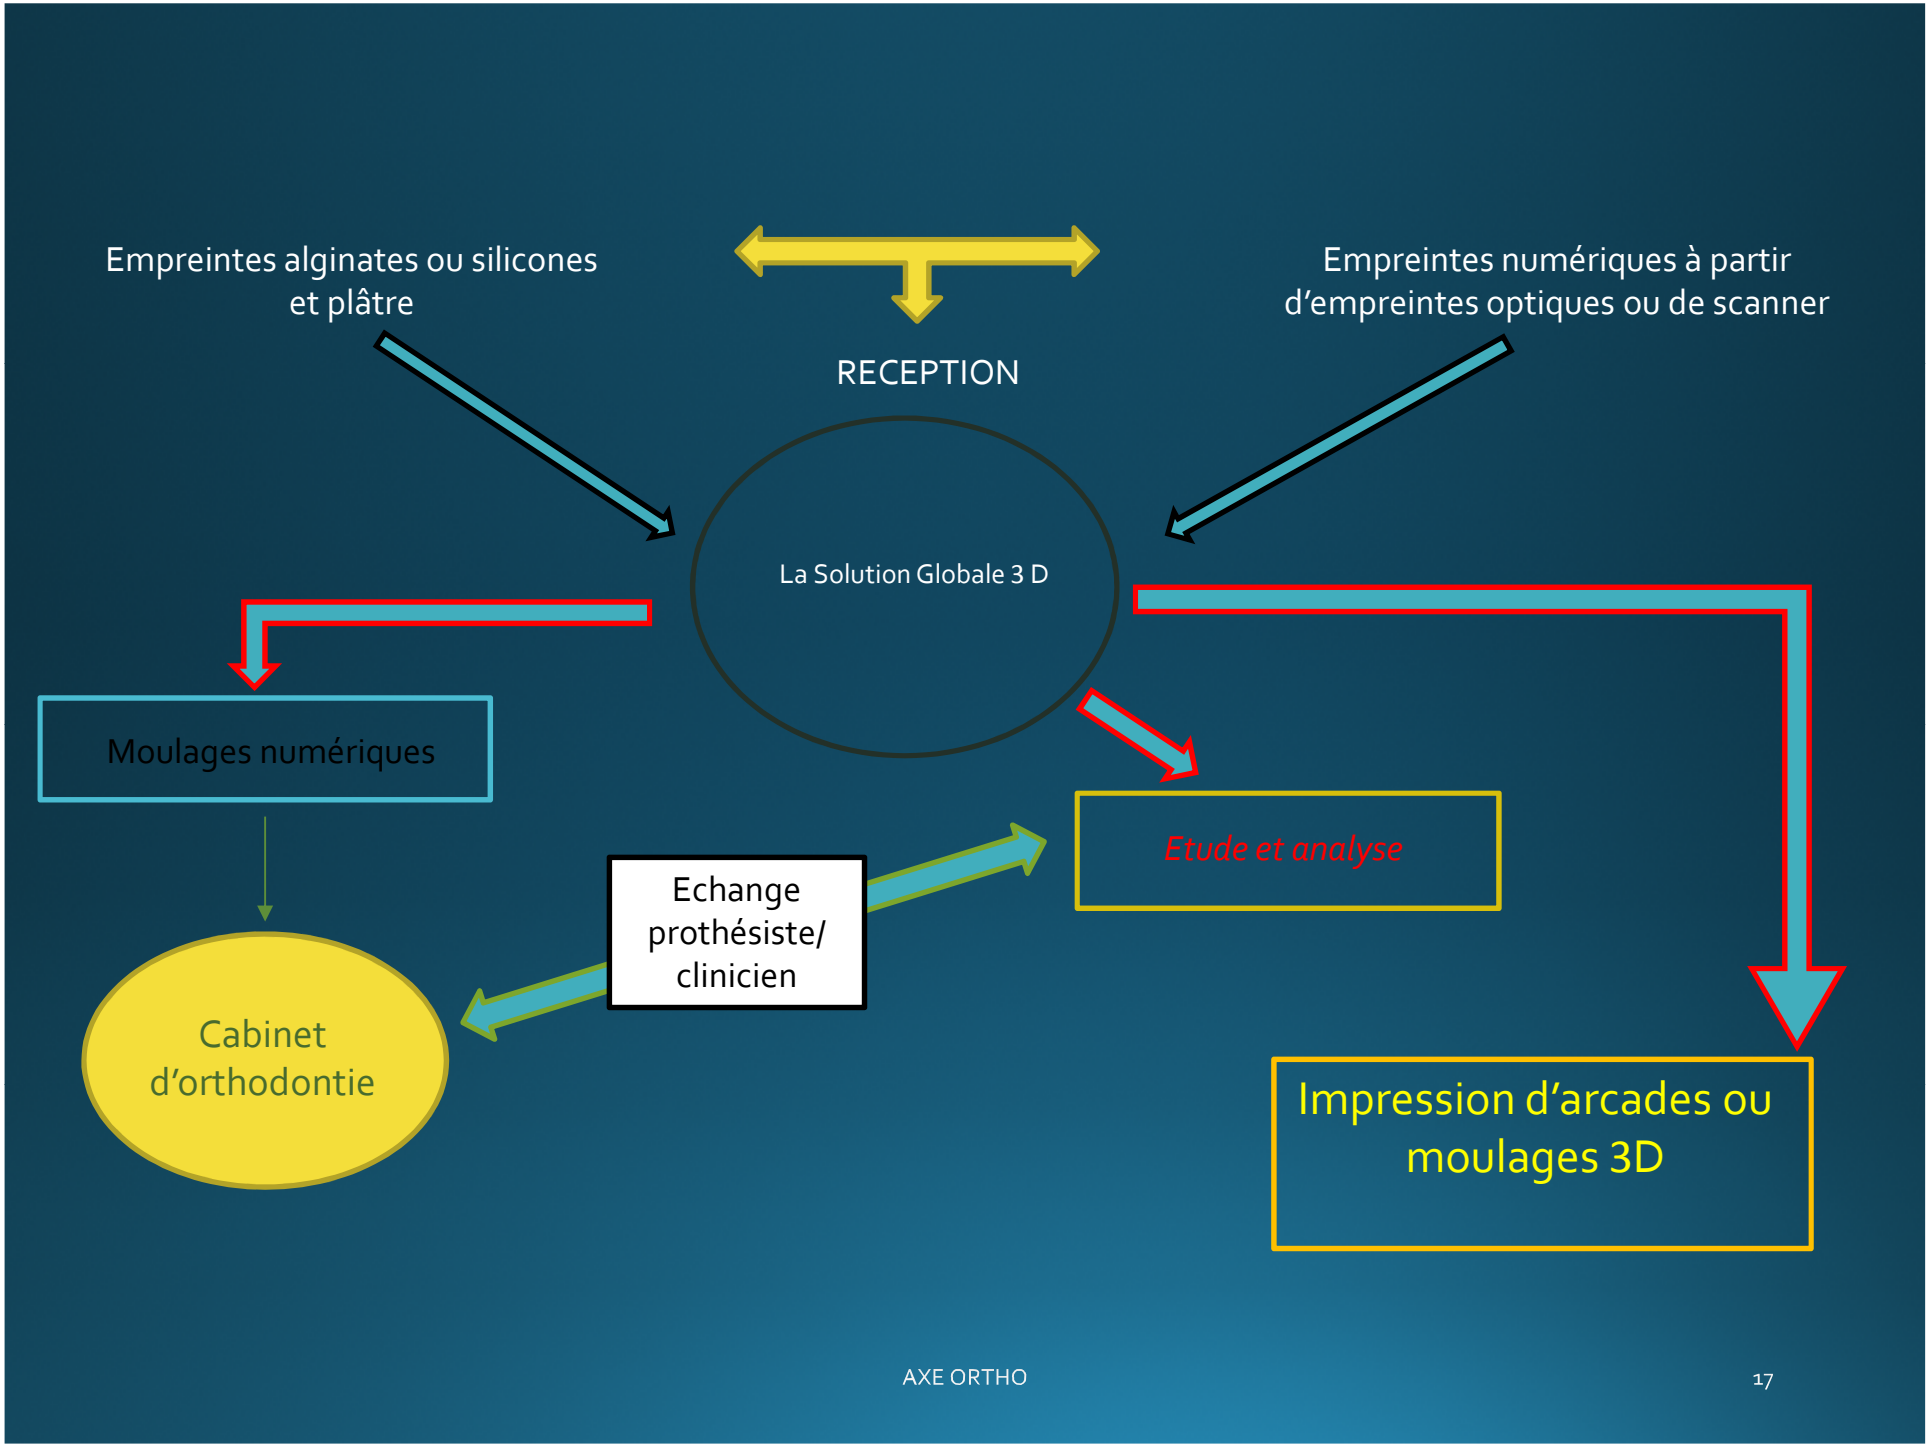
RECEPTION

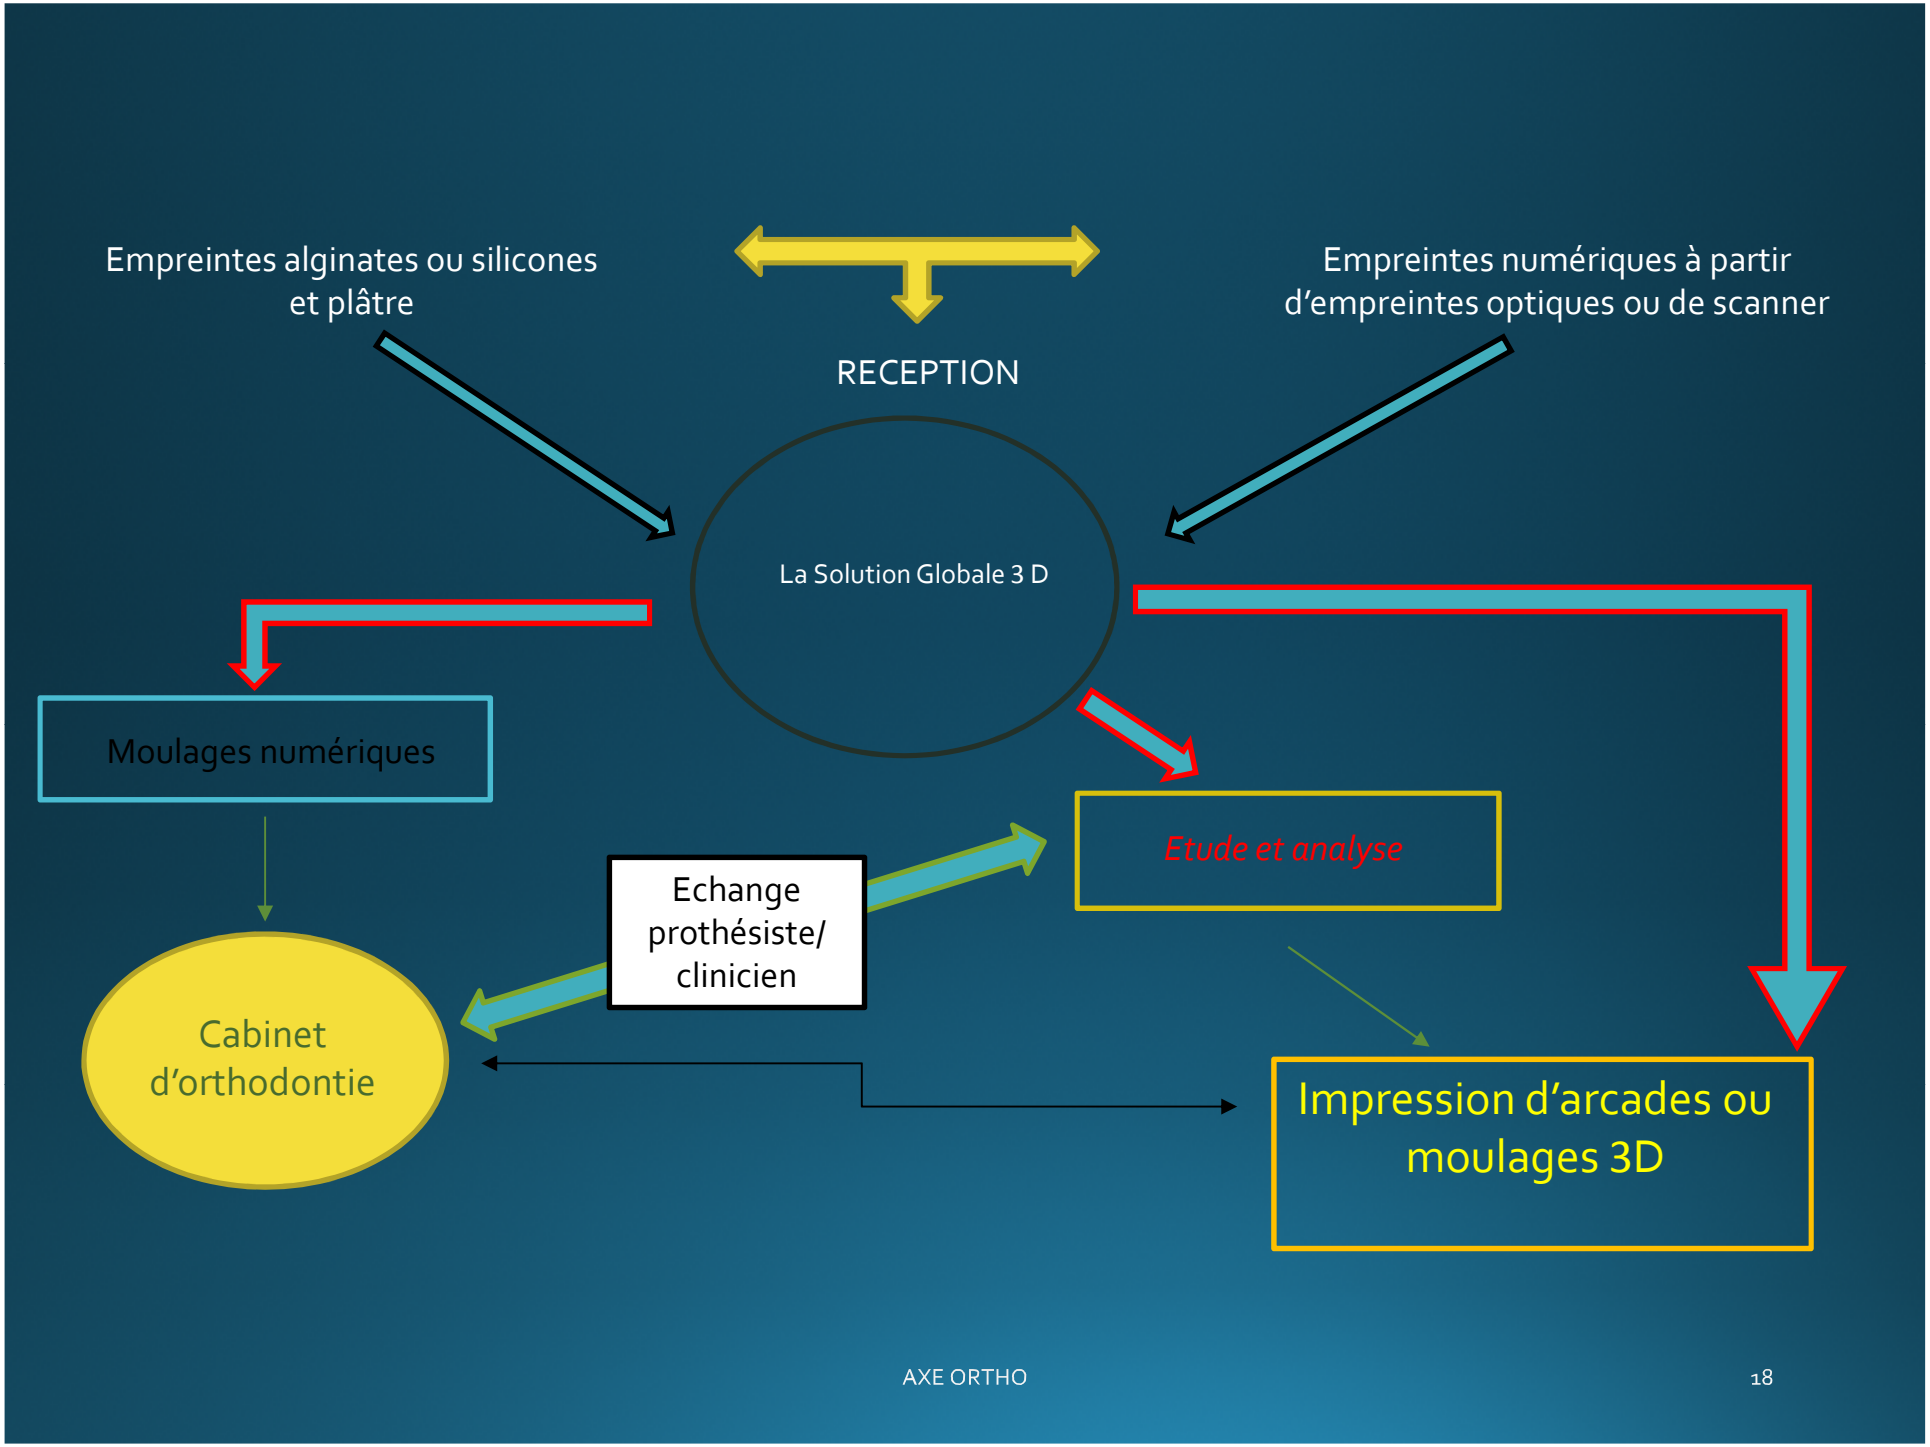

Empreintes alginates ou silicones et plâtre
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
RECEPTION
La Solution Globale 3 D

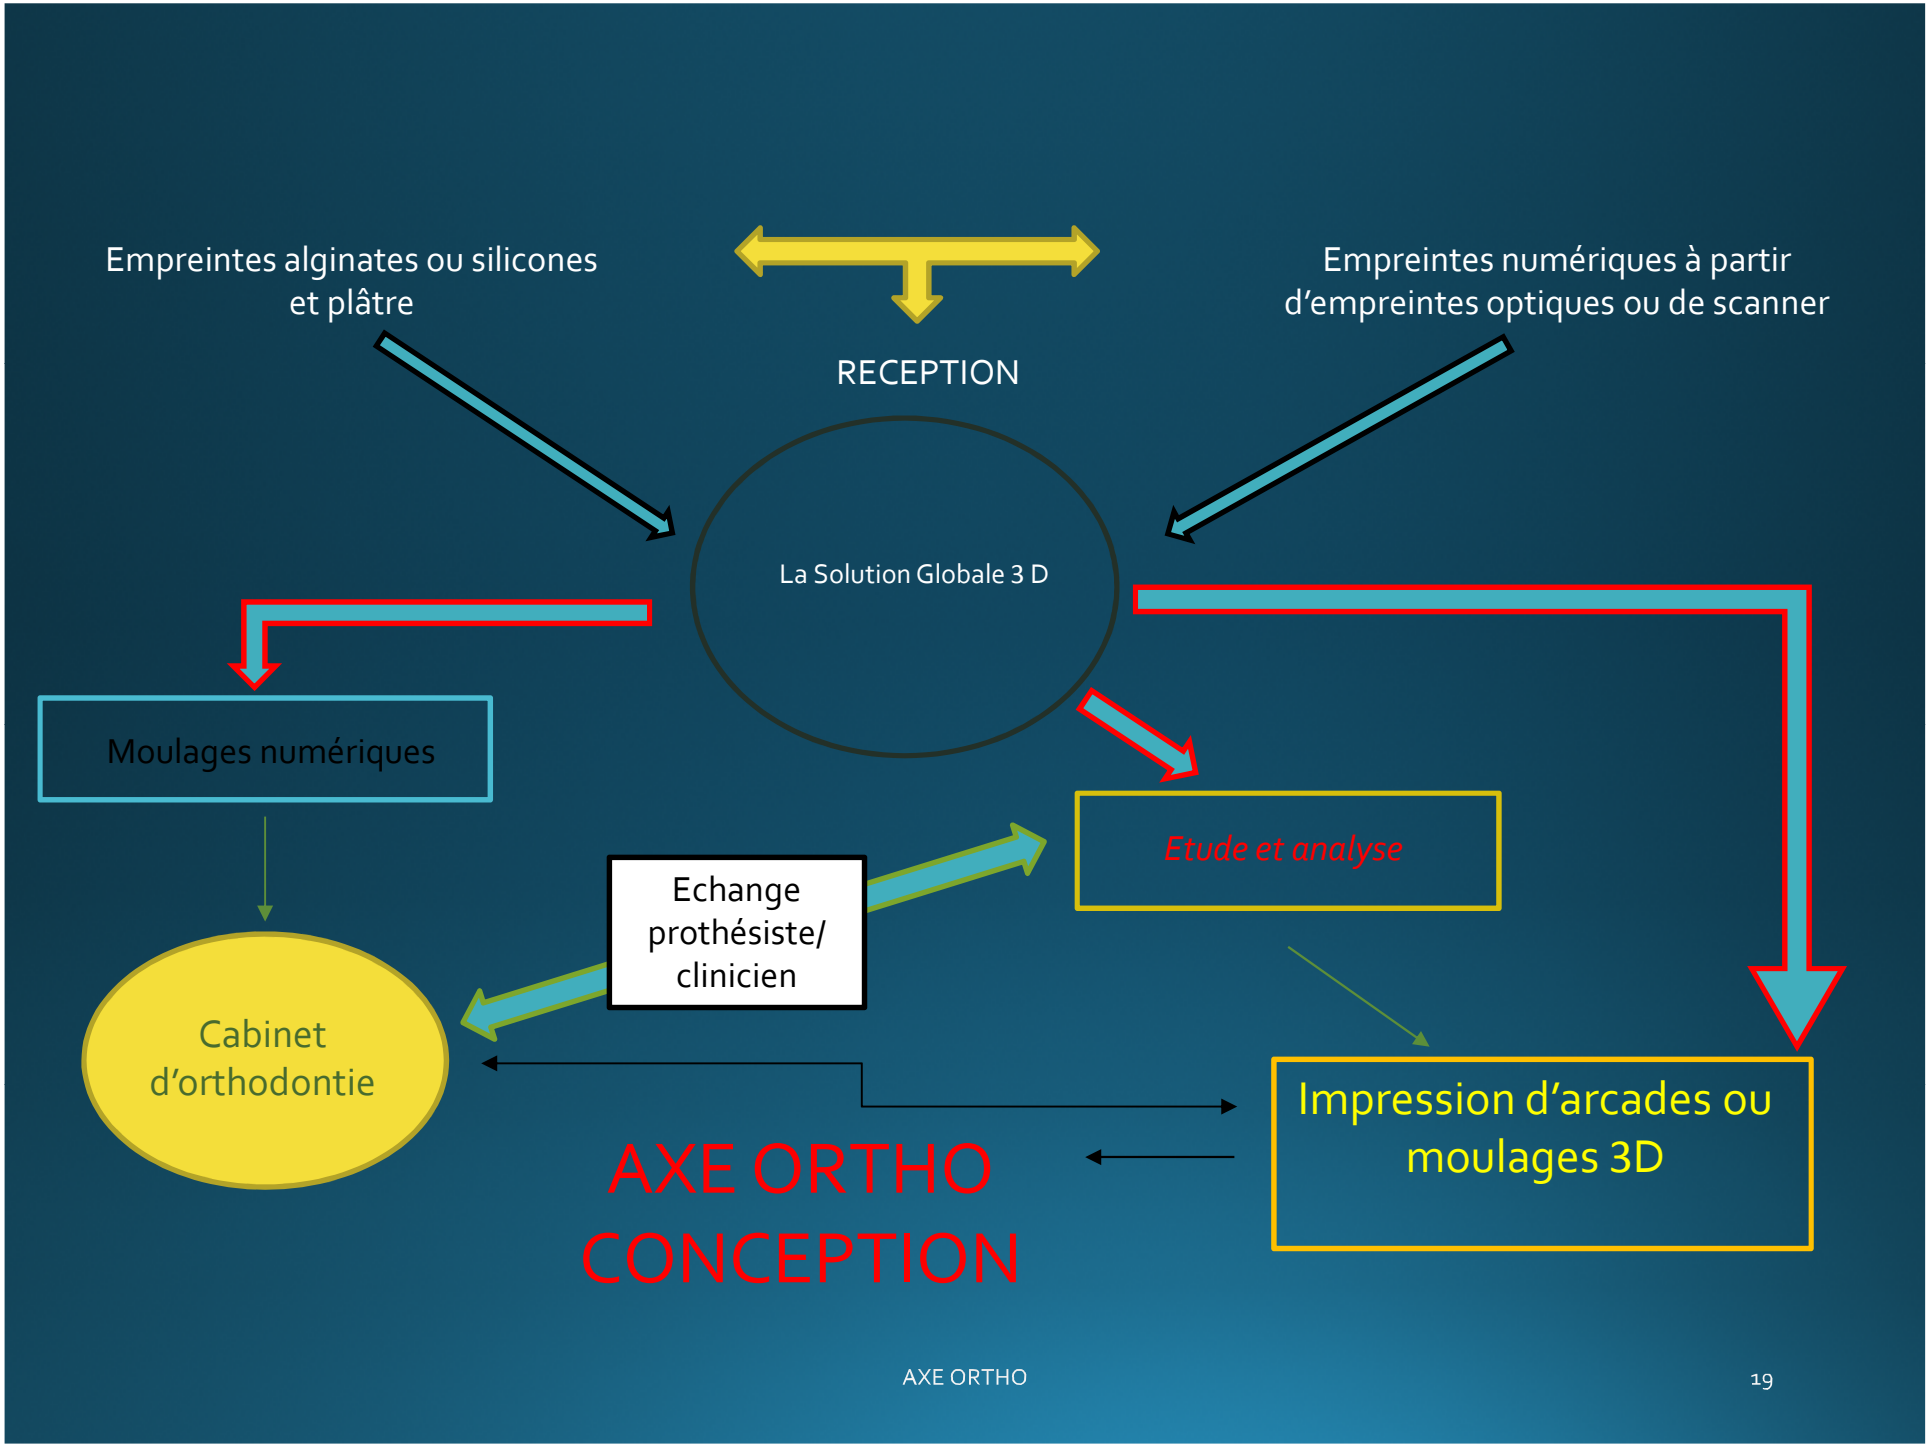

Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Impression d'arcades ou moulages 3D

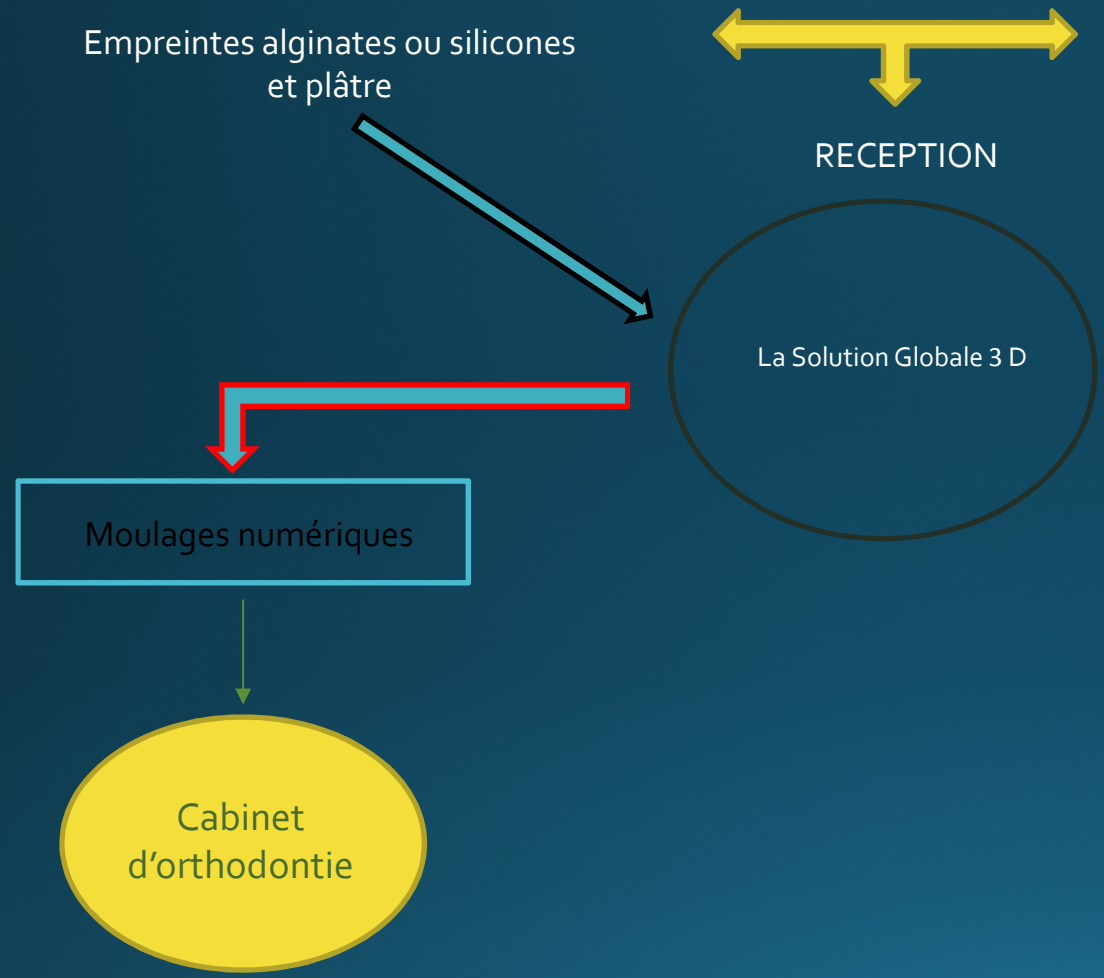

Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Etude et analyse
Impression d'arcades ou moulages 3D


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie
Impression d'arcades ou moulages 3D


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie
Impression d'arcades ou moulages 3D


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie
Impression d'arcades ou moulages 3D
AXE ORTHO CONCEPTION

LES OUTILS NUMERIQUES EN ORTHODONTIE


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Cabinet d'orthodontie

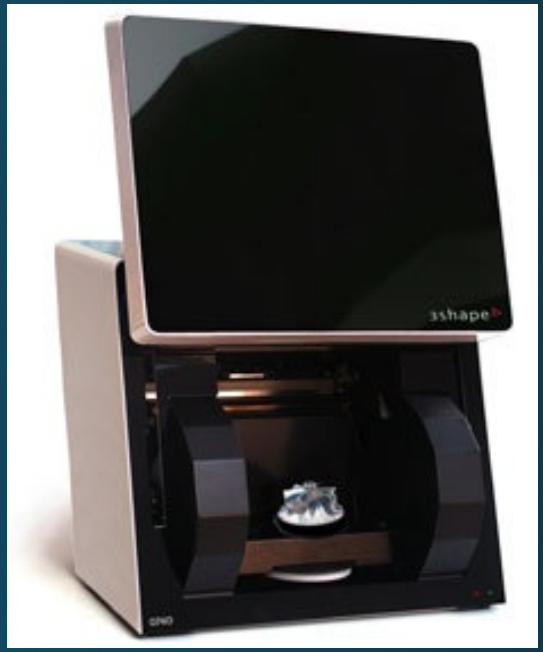
Empreintes alginates ou silicones et plâtre

RECEPTION

La Solution Globale 3 D

Moulages numériques

Cabinet d'orthodontie



Empreintes alginates ou silicones et plâtre

RECEPTION

La Solution Globale 3 D



Moulages numériques

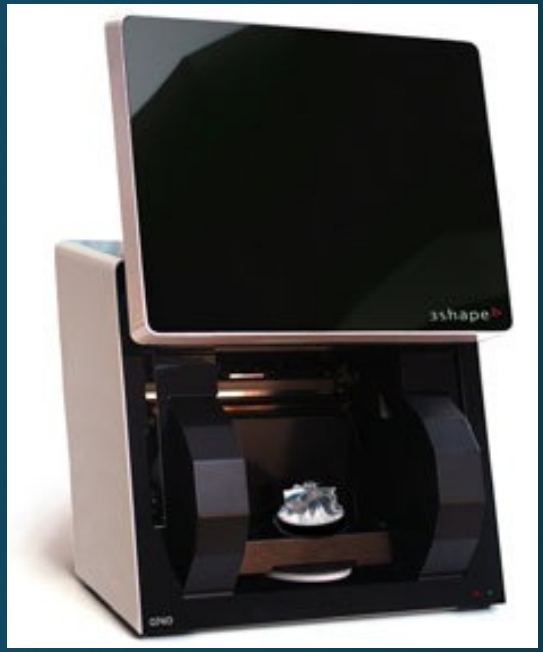
Etude et analyse

Cabinet d'orthodontie

Empreintes alginates ou silicones et plâtre

RECEPTION

La Solution Globale 3 D



Moulages numériques

Etude et analyse

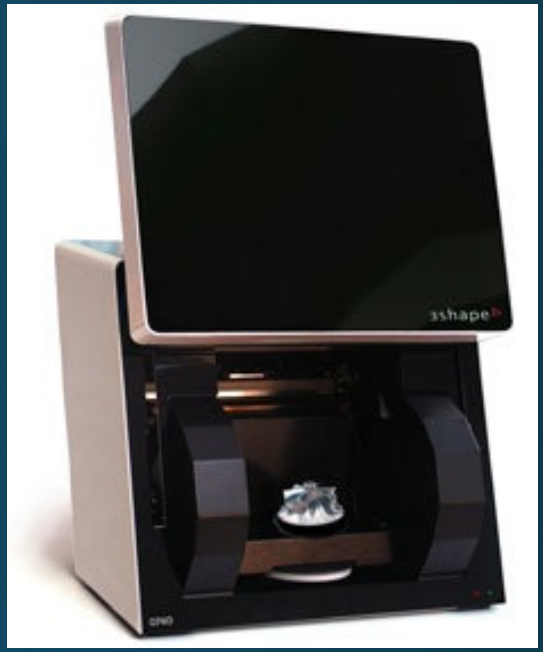
Cabinet d'orthodontie

ORTHOANALYZER 3SHAPE

Empreintes alginates ou silicones et plâtre

RECEPTION

La Solution Globale 3 D



Moulages numériques

Etude et analyse

Echange prothésiste/ clinicien

Cabinet d'orthodontie

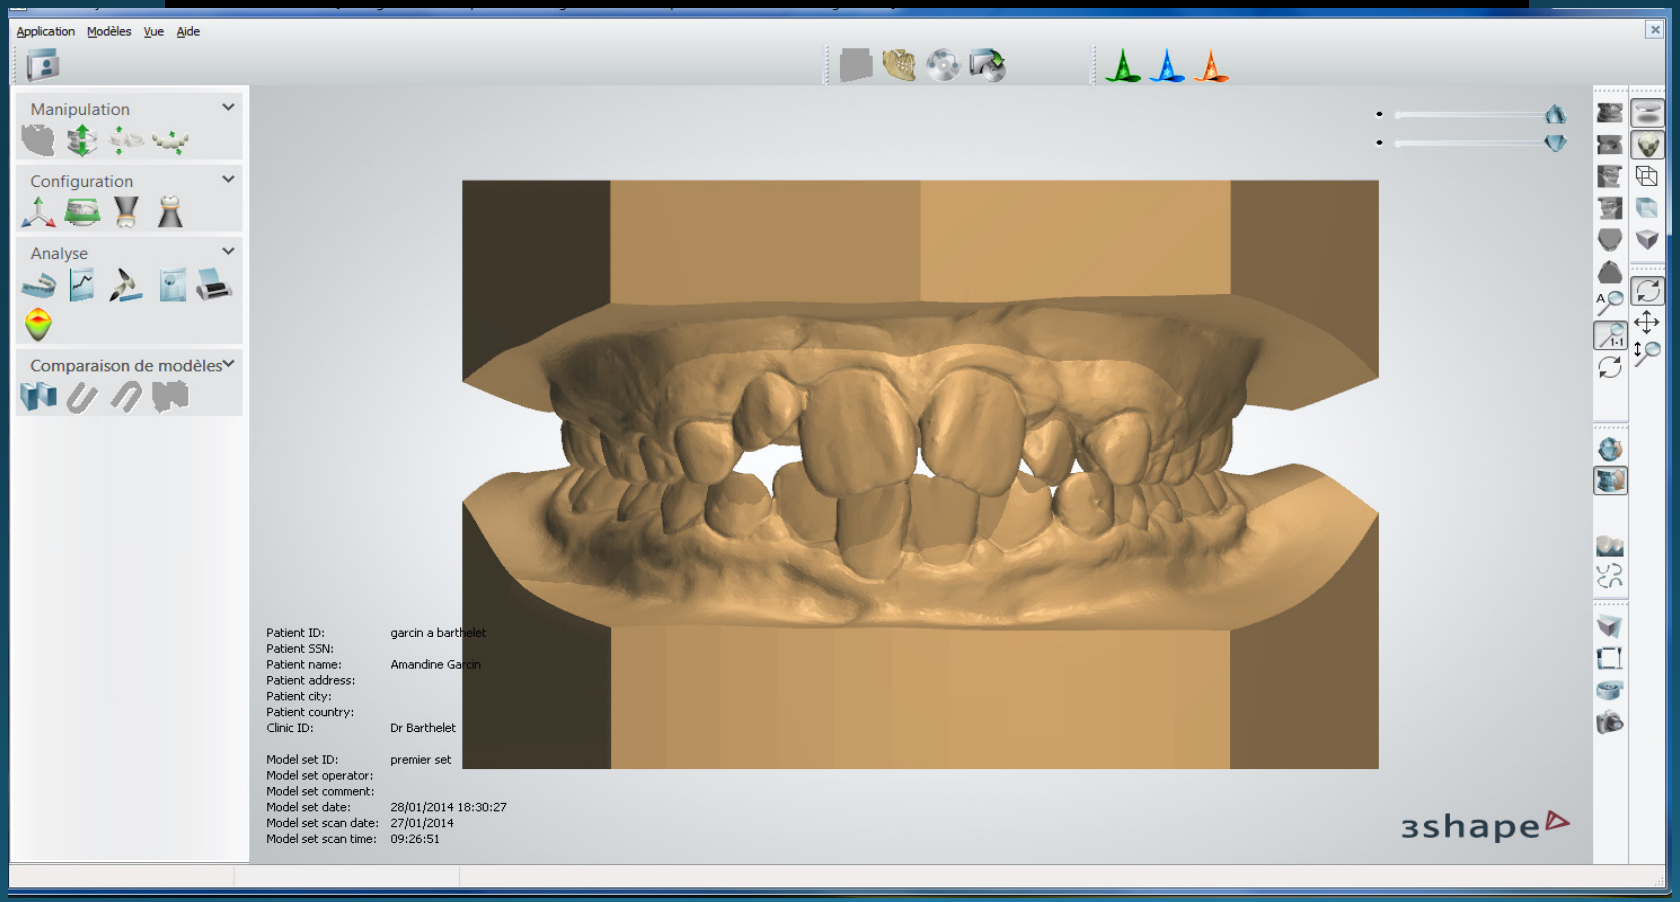
ORTHOANALYZER 3SHAPE

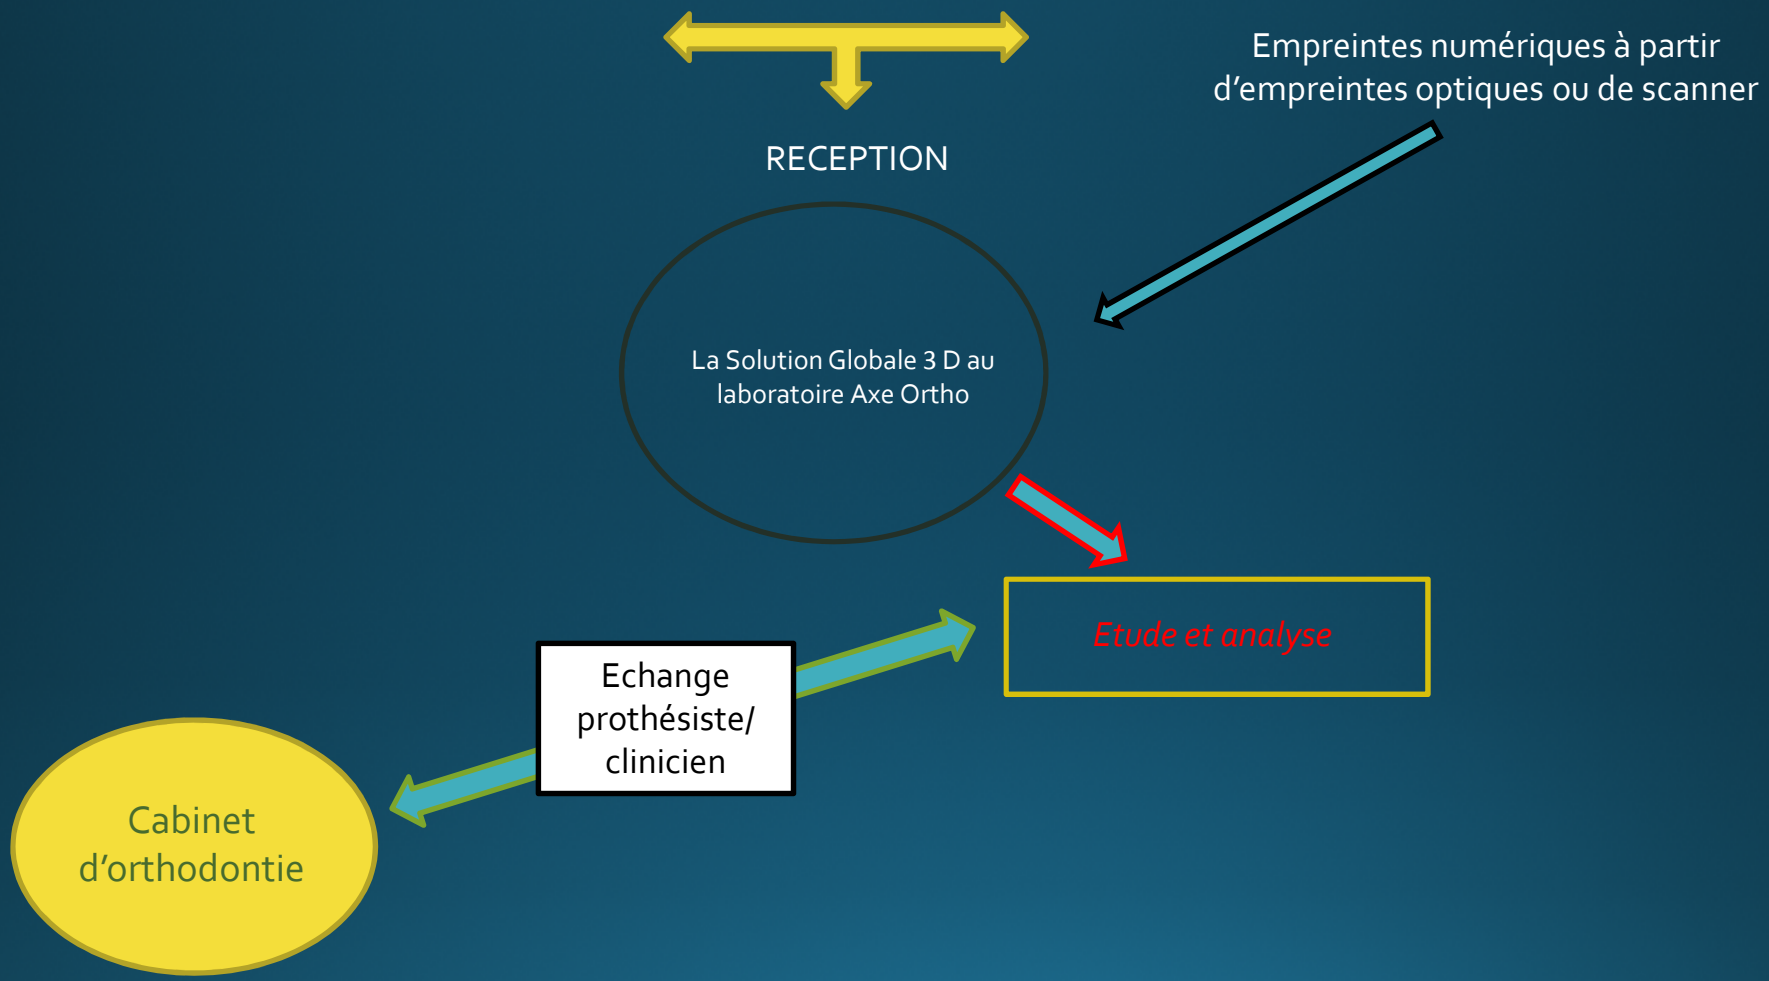
LES OUTILS NUMERIQUES EN ORTHODONTIE

ORTHOANALYZER 3SHAPE

LES OUTILS NUMERIQUES EN ORTHODONTIE

ORTHOANALYZER 3SHAPE




RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D au laboratoire Axe Ortho
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie



RECEPTION

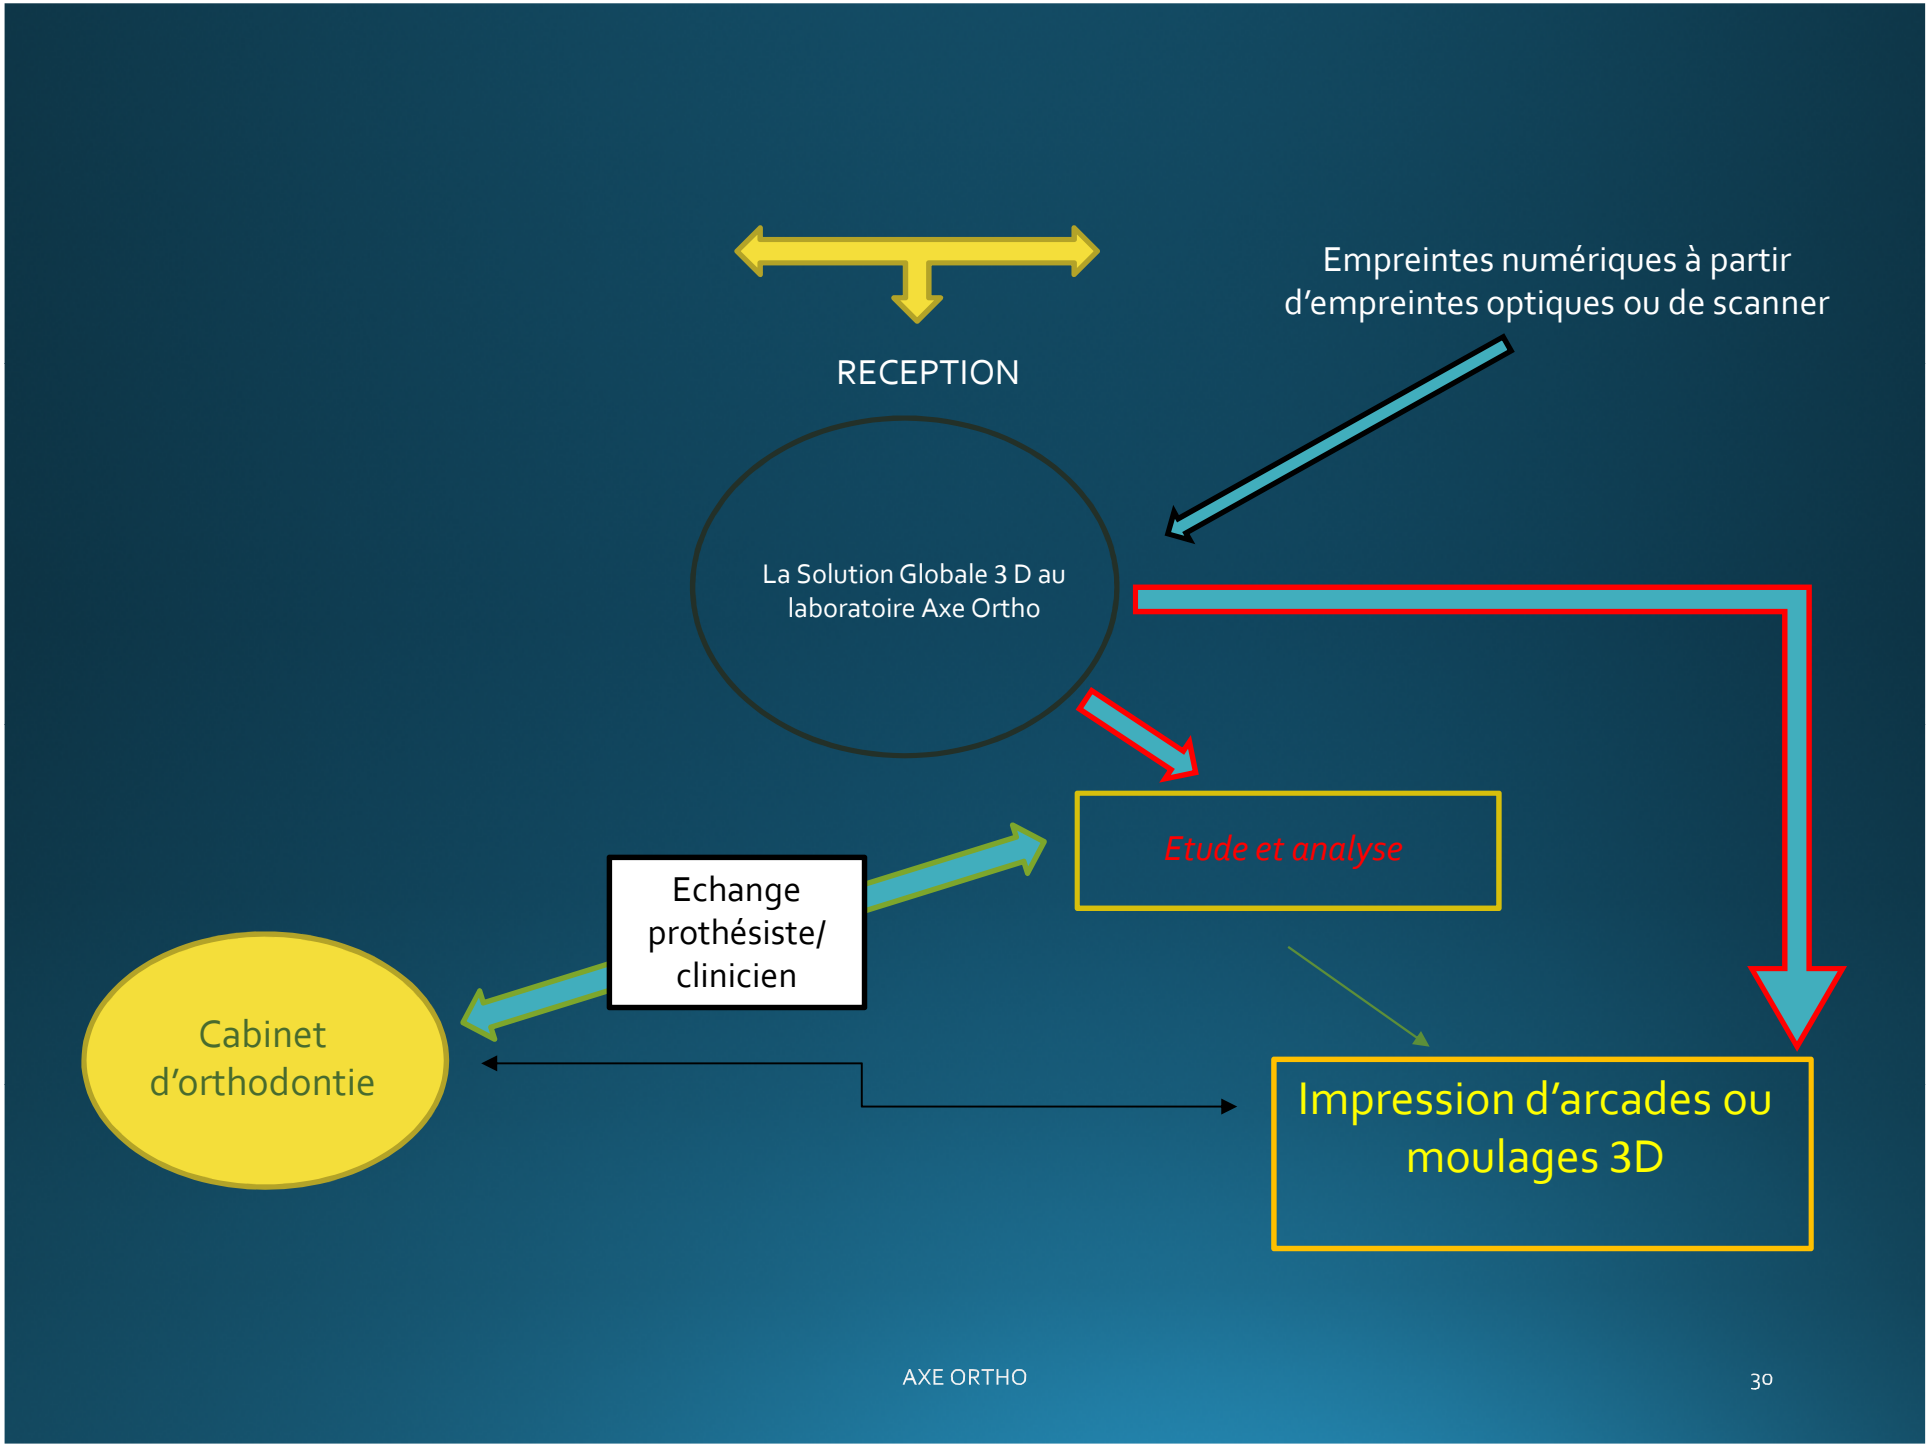
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner

La Solution Globale 3 D au laboratoire Axe Ortho

Etude et analyse

Echange prothésiste/ clinicien

Cabinet d'orthodontie


RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D au laboratoire Axe Ortho
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie
Impression d'arcades ou moulages 3D



RECEPTION

Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner

La Solution Globale 3 D au laboratoire Axe Ortho

Etude et analyse

Echange prothésiste/ clinicien

Cabinet d'orthodontie

Impression d'arcades ou moulages 3D



RECEPTION

Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner

La Solution Globale 3 D au laboratoire Axe Ortho

Etude et analyse

Echange prothésiste/ clinicien

Cabinet d'orthodontie

Impression d'arcades ou moulages 3D

AXE ORTHO CONCEPTION



RECEPTION

Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner

La Solution Globale 3 D au laboratoire Axe Ortho

Etude et analyse

Echange prothésiste/ clinicien

Cabinet d'orthodontie

CFAO

Impression d'arcades ou moulages 3D



RECEPTION

Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner

La Solution Globale 3 D

Etude et analyse

Echange prothésiste/ clinicien

Cabinet d'orthodontie

Impression d'arcades ou moulages 3D

CFAO

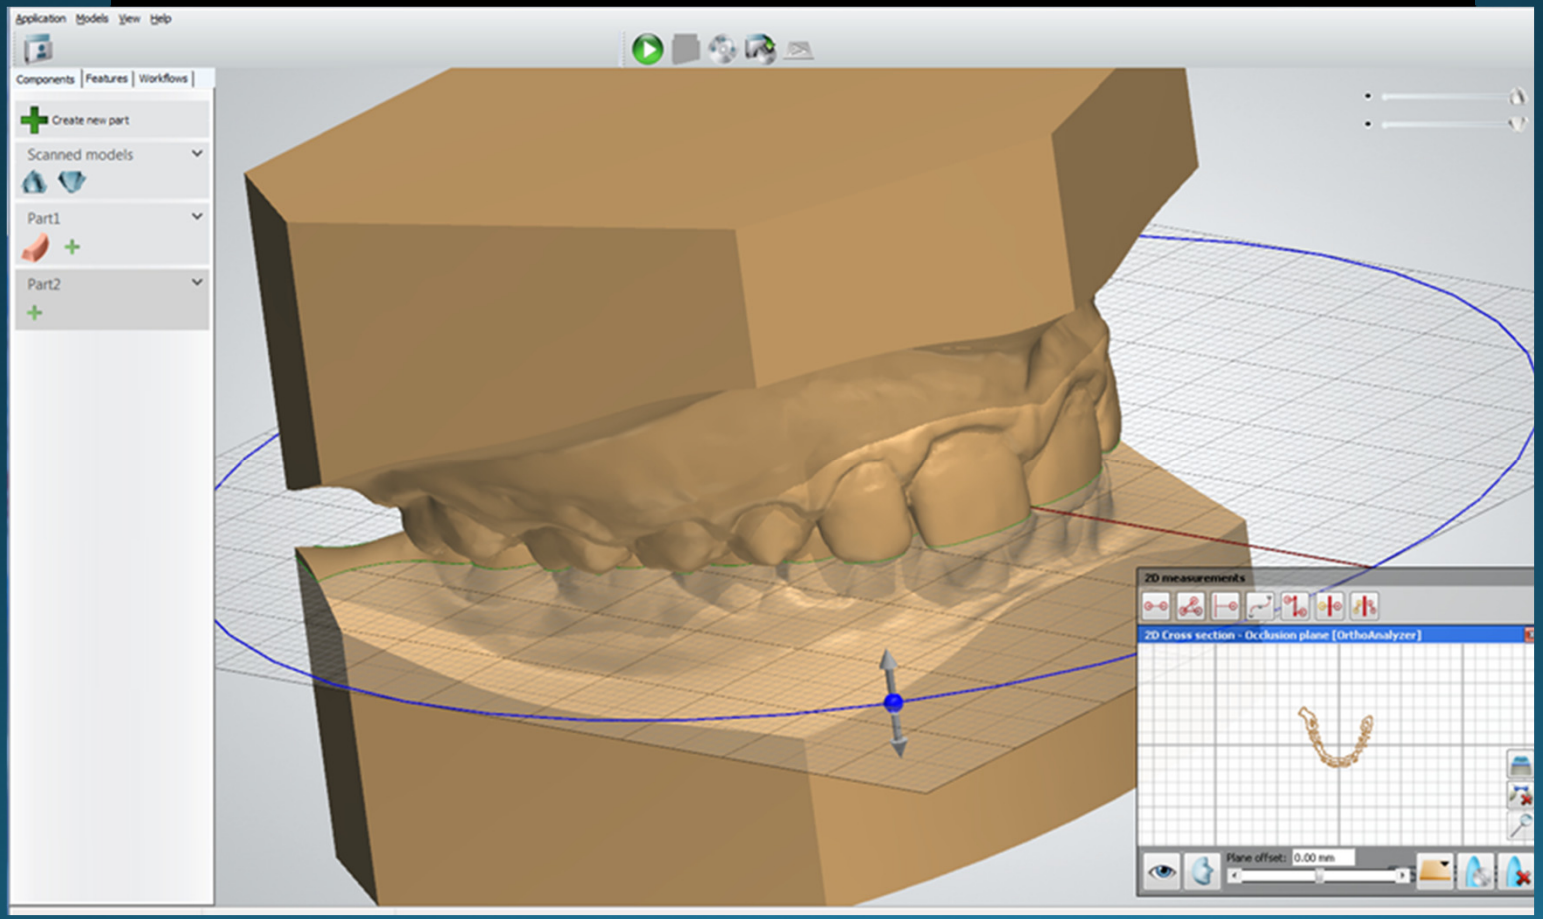
APPLIANCE DESIGNER

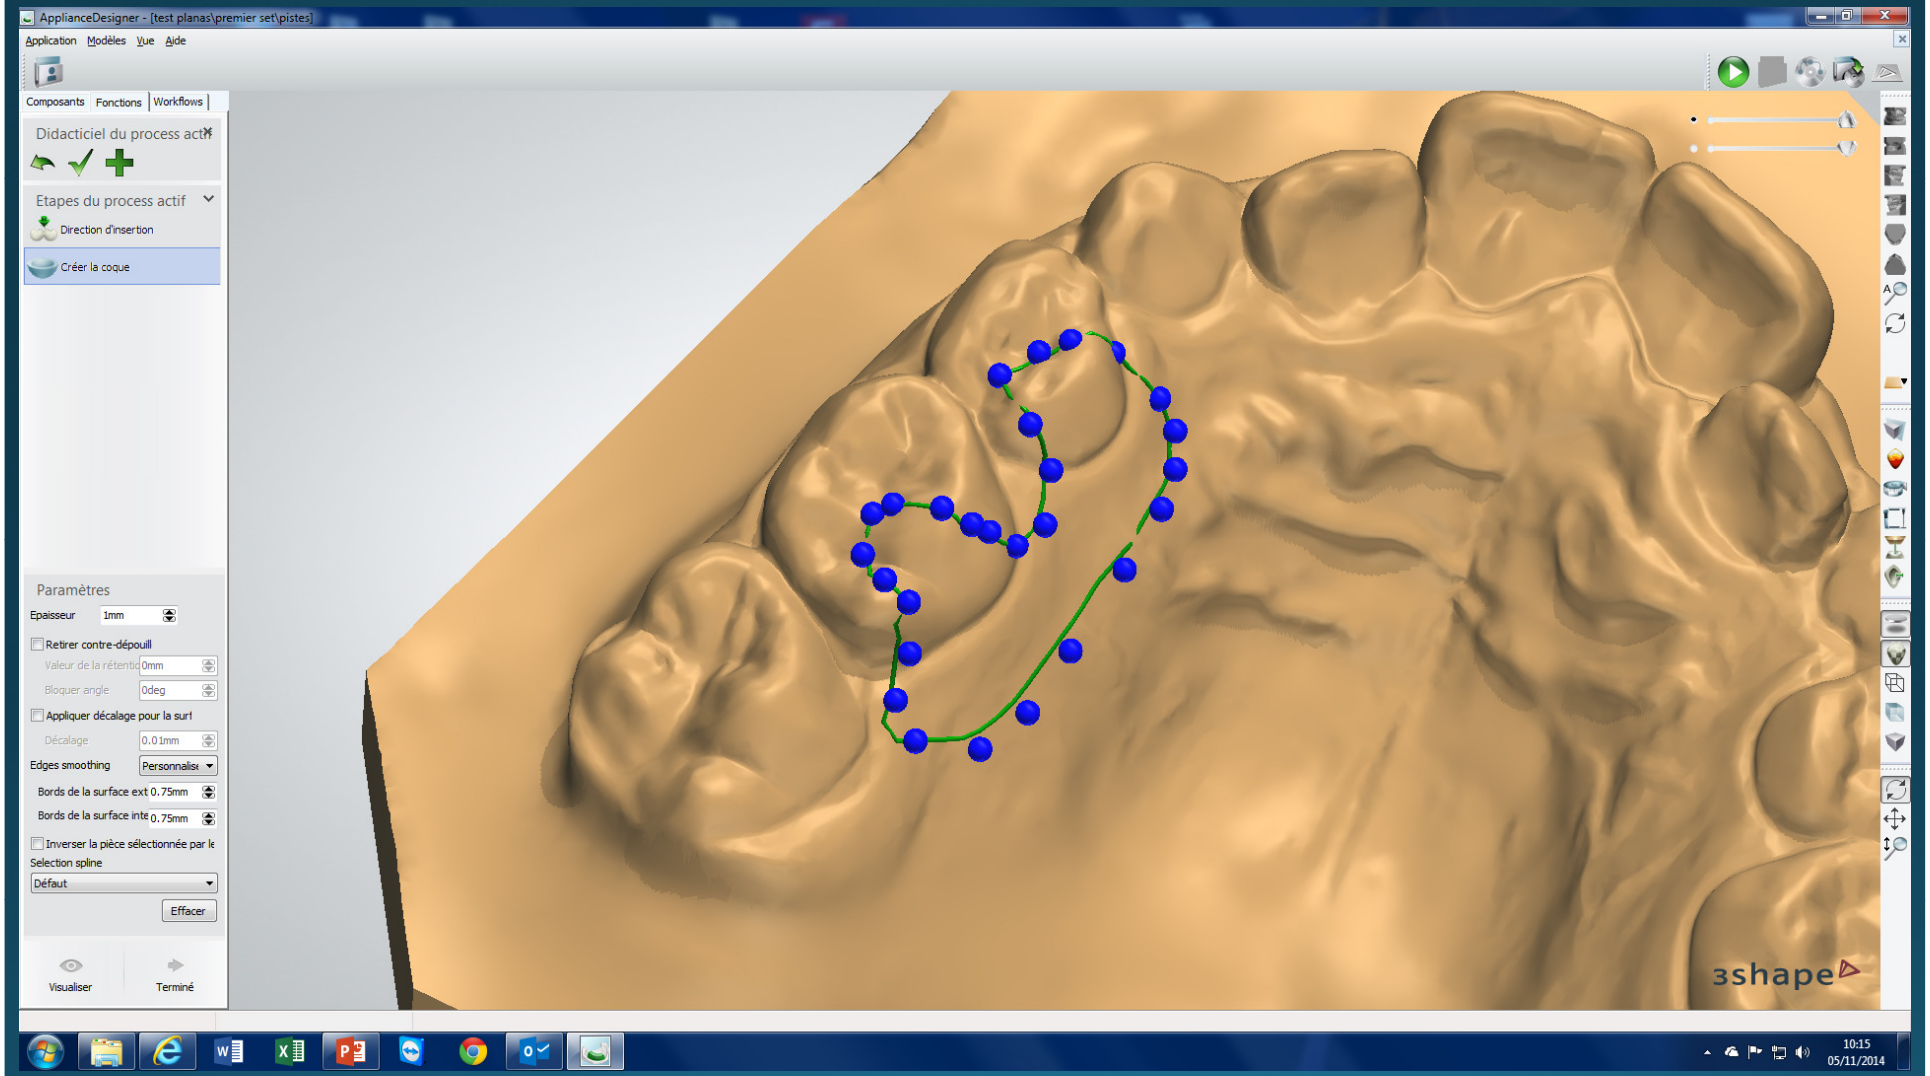
LES OUTILS NUMERIQUES EN ORTHODONTIE

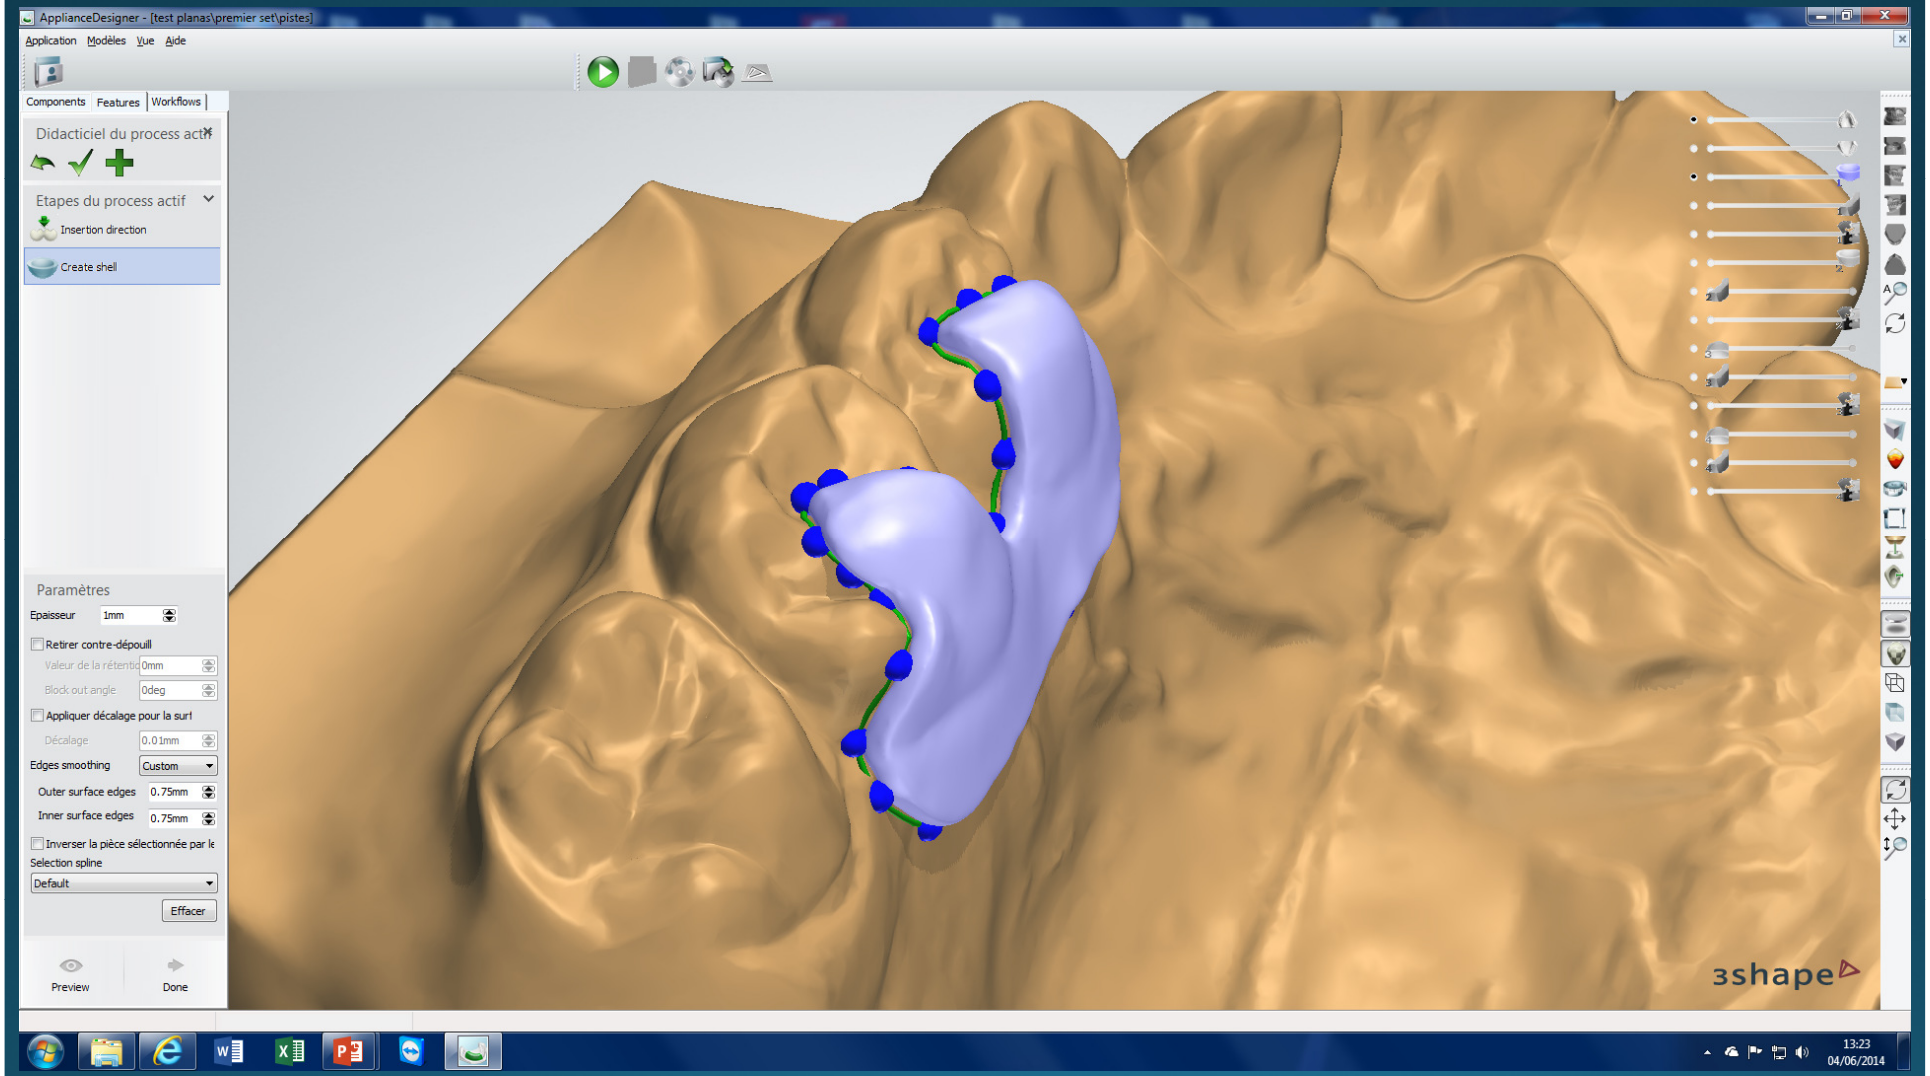
APPLIANCE DESIGNER 3SHAPE

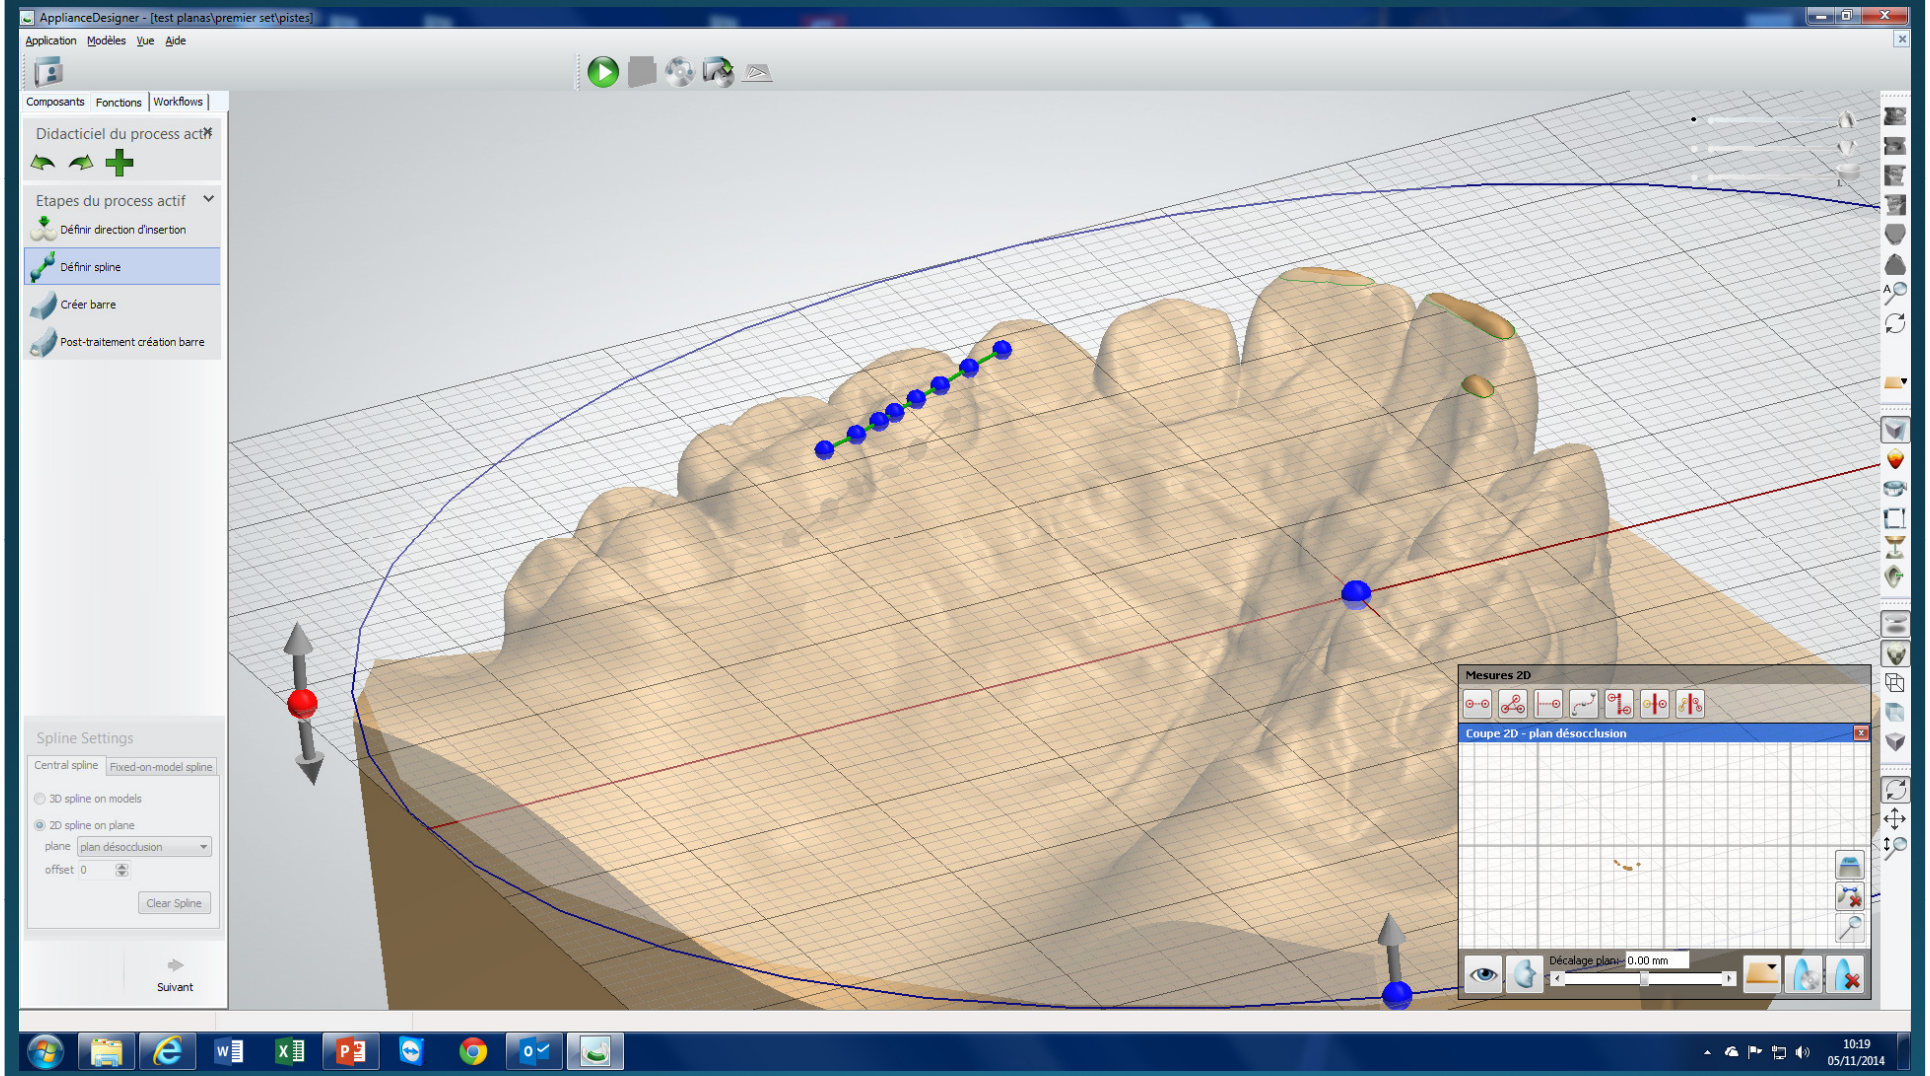
LES OUTILS NUMERIQUES EN ORTHODONTIE

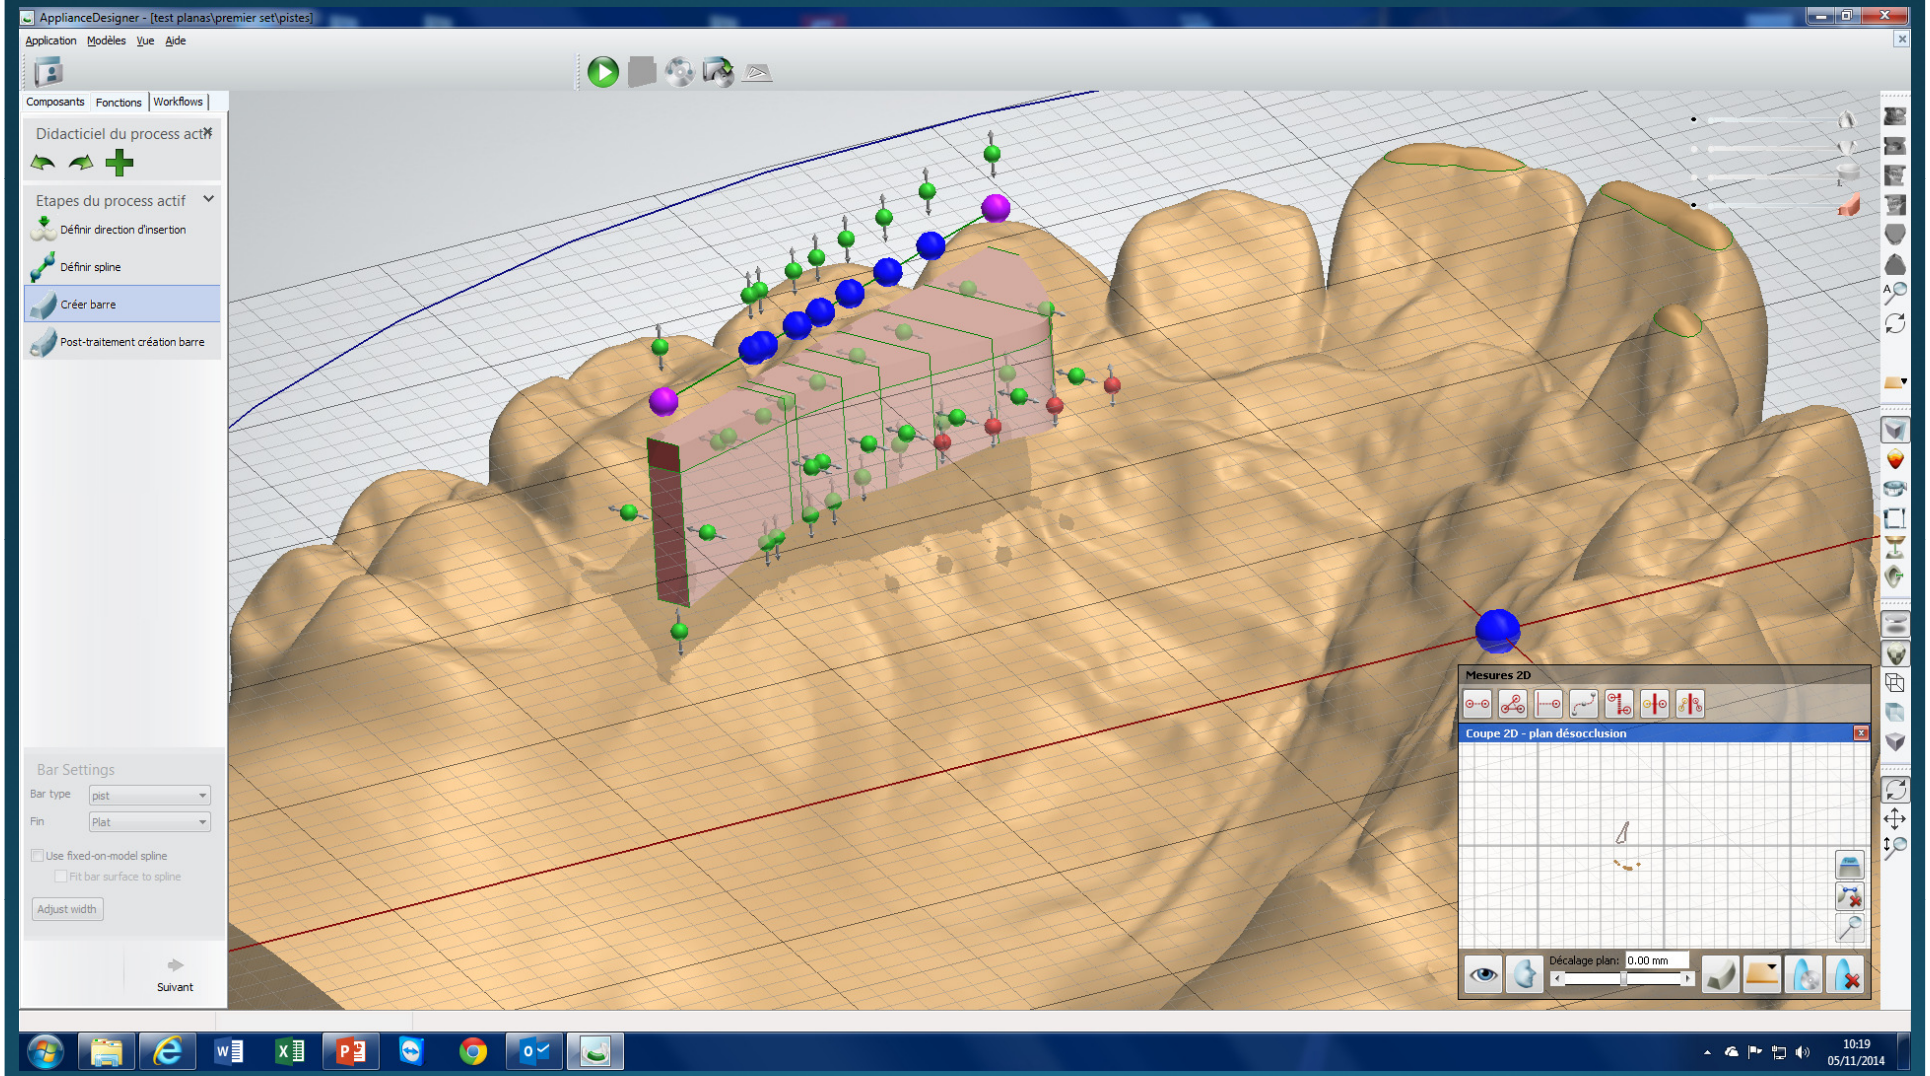
APPLIANCE DESIGNER 3SHAPE

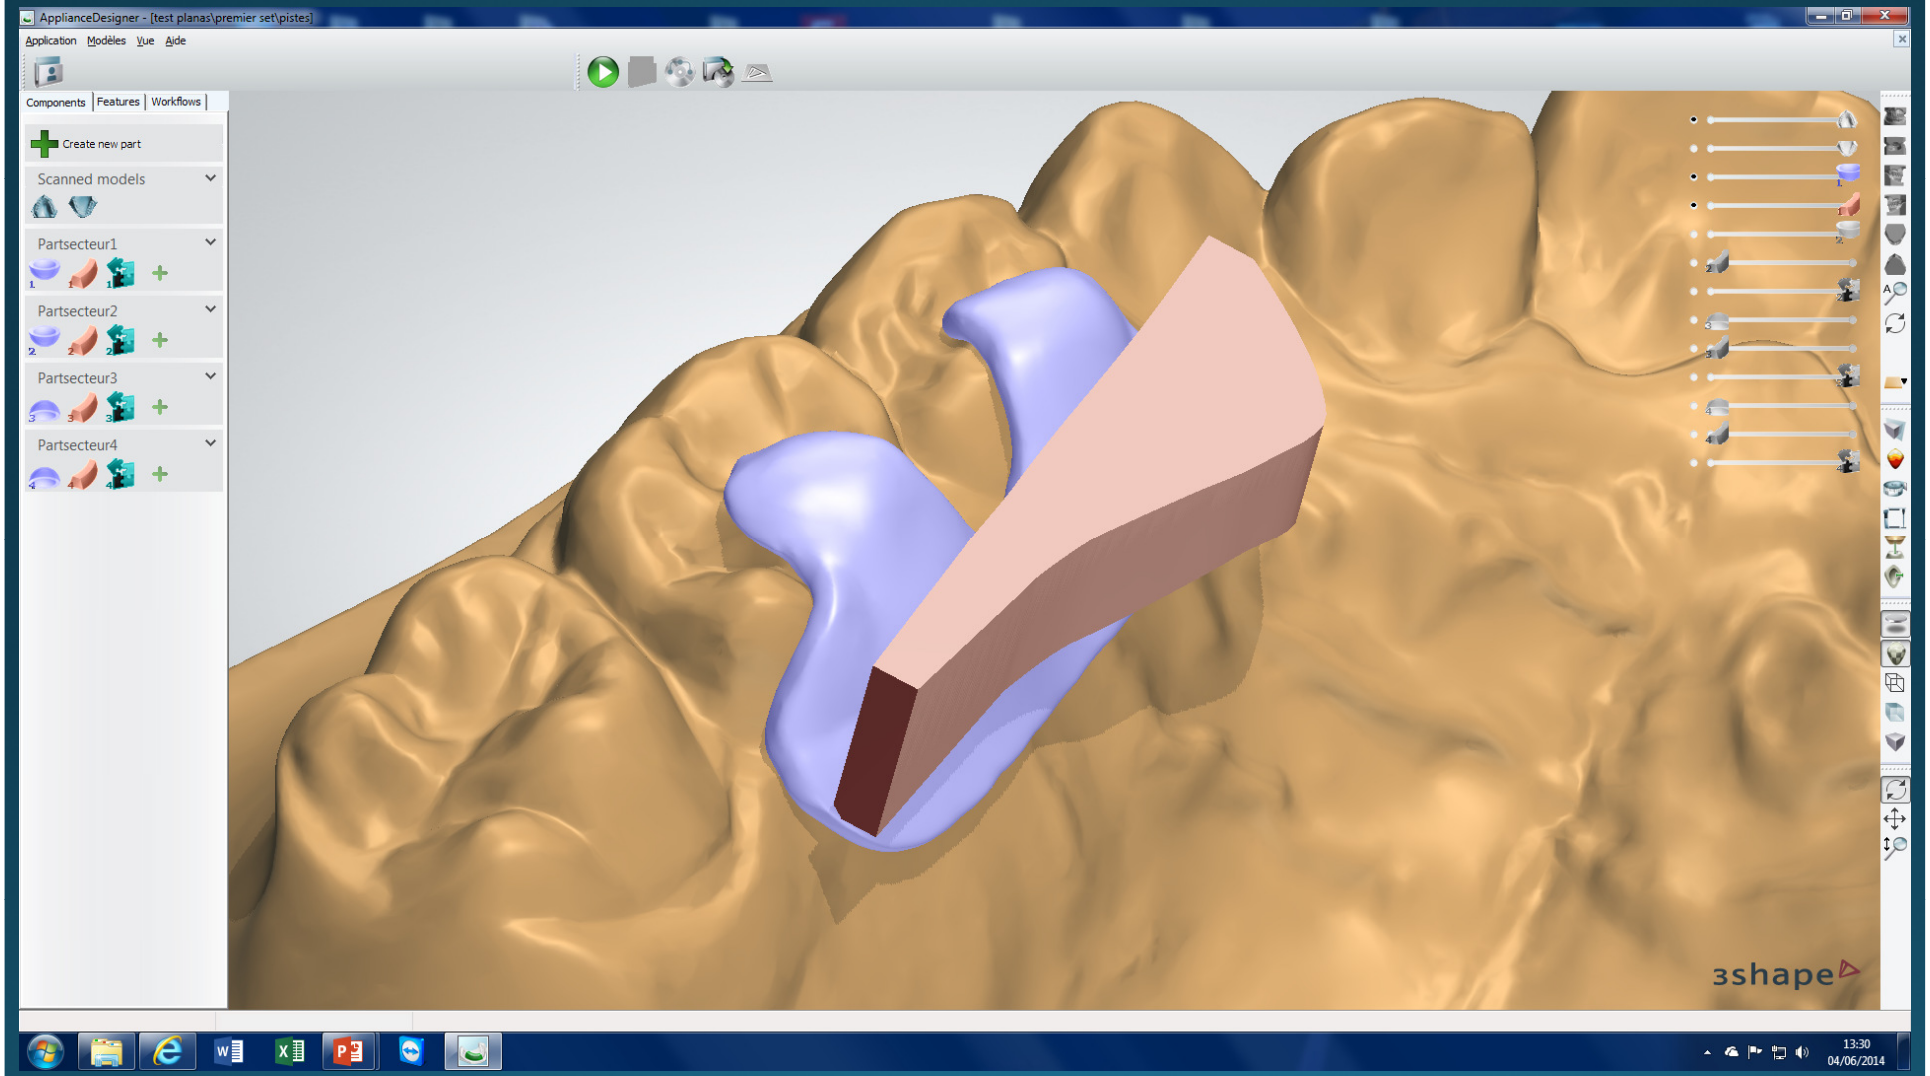


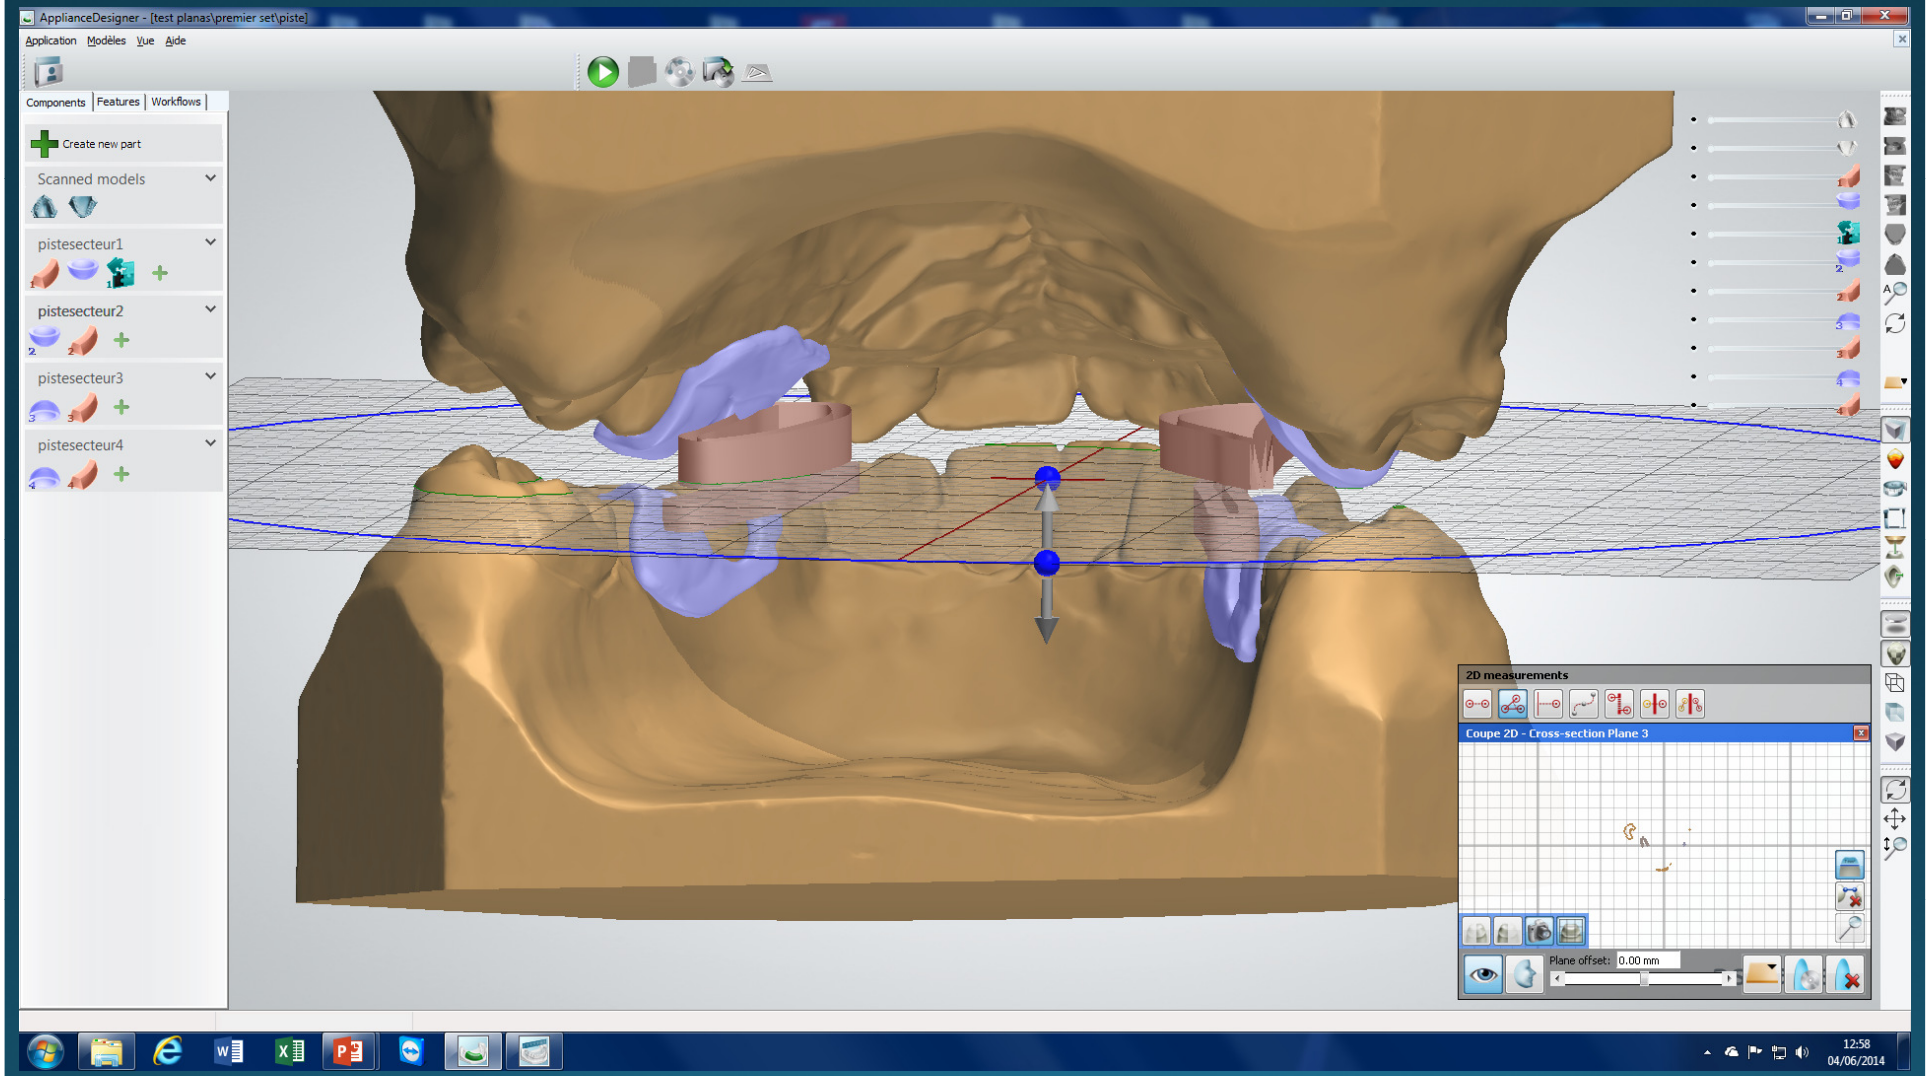

ApplianceDesigner - [test planas\premier set\pistes]
Application Modèles Vue Aide
Composants Fonctions Workflows
Didacticiel du process act
Etapes du process actif
Direction d'insertion
Créer la coque
Paramètres
Epaisseur 1mm
Retirer contre-dépouill
Valeur de la rétentio 0mm
Bloquer angle 0deg
Appliquer décalage pour la surf
Décalage 0.01mm
Edges smoothing Personnalis
Bords de la surface ext 0.75mm
Bords de la surface inte 0.75mm
Inverser la pièce sélectionnée par le
Selection spline
Défaut
Effacer
Visualiser
Terminé
3shape
10:15
05/11/2014

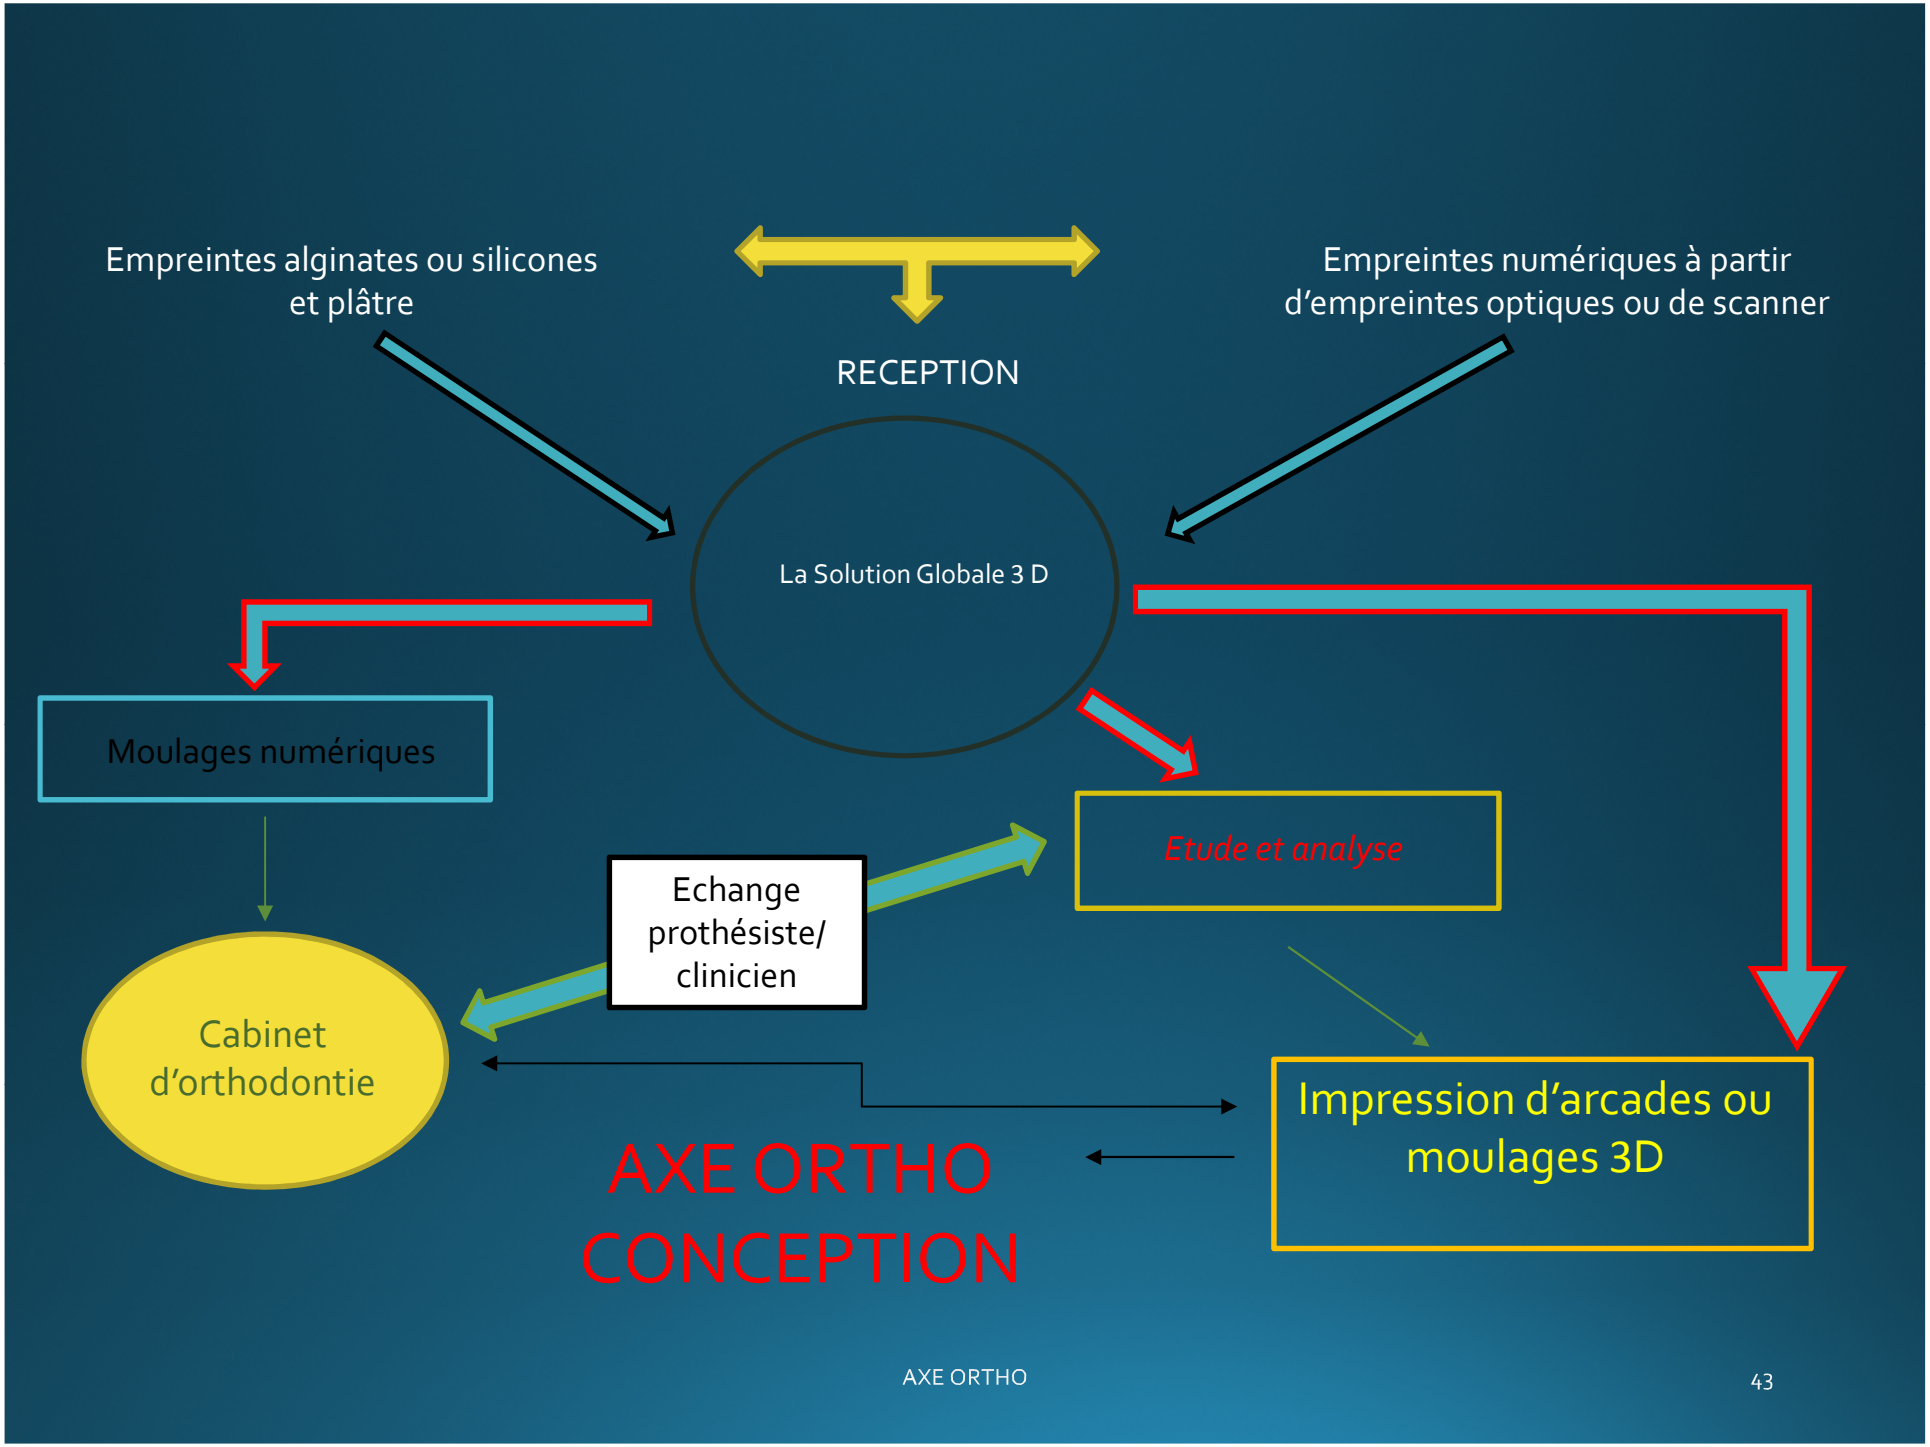

ApplianceDesigner - [test planas\premier set\pistes]
Application Modèles Vue Aide
Components Features Workflows
Didacticiel du process actif
Etapes du process actif
Insertion direction
Create shell
Paramètres
Epaisseur 1mm
Retirer contre-dépouill
Valeur de la rétentio 0mm
Block out angle 0deg
Appliquer décalage pour la surf
Décalage 0.01mm
Edges smoothing Custom
Outer surface edges 0.75mm
Inner surface edges 0.75mm
Inverser la pièce sélectionnée par le
Selection spline
Default
Effacer
Preview
Done
3shape
13:23
04/06/2014

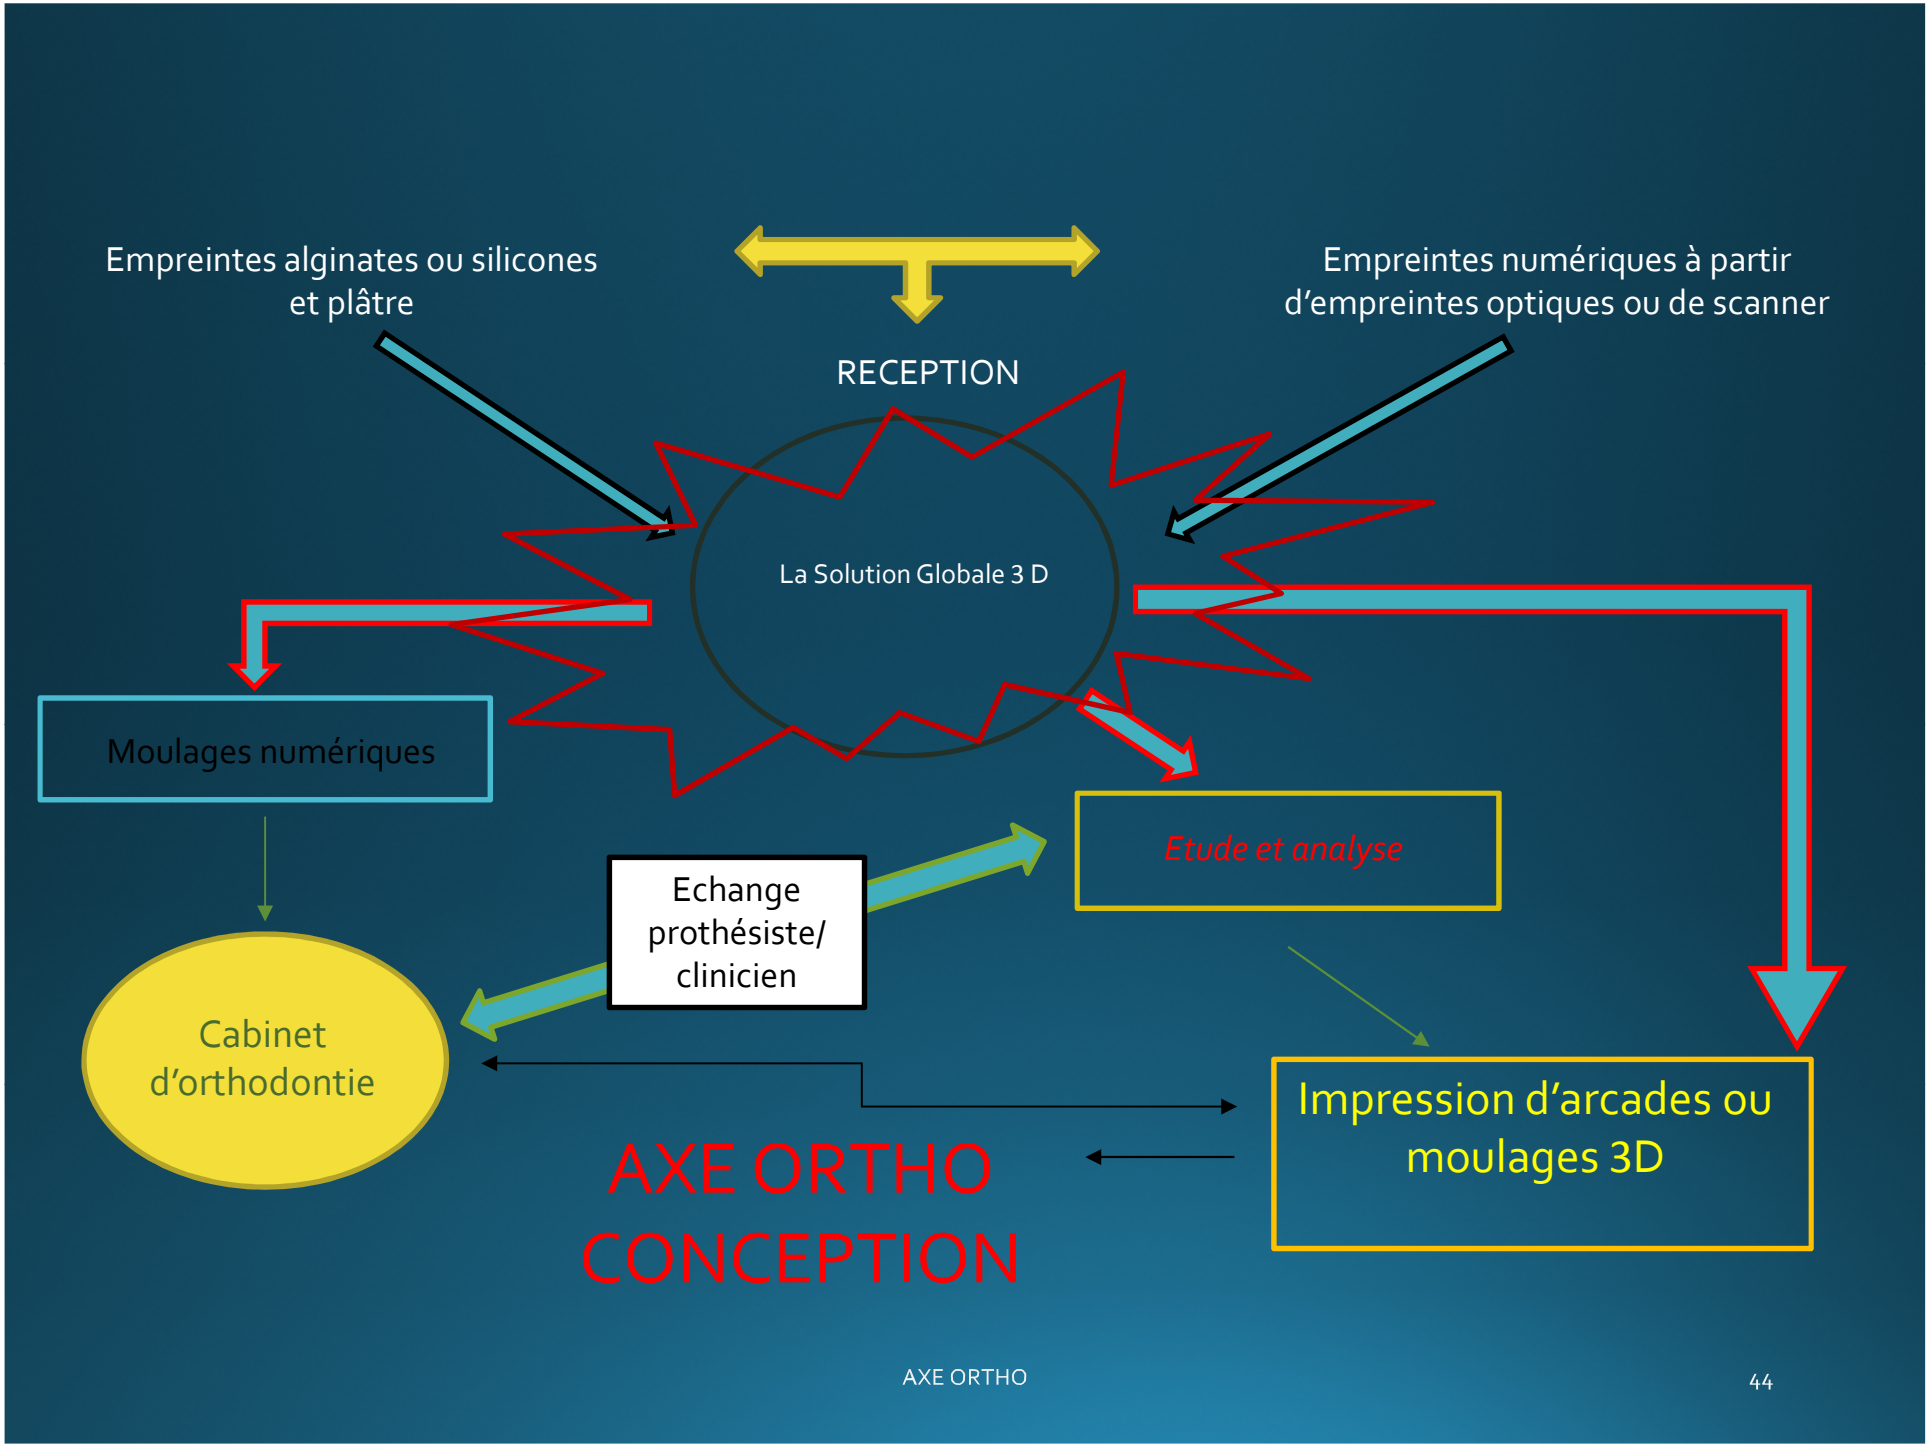

ApplianceDesigner - [test planas\premier set\pistes]
Application Modèles Vue Aide
Composants Fonctions Workflows
Didacticiel du process act
Etapes du process actif
Définir direction d'insertion
Définir spline
Créer barre
Post-traitement création barre
Spline Settings
Central spline
Fixed-on-model spline
3D spline on models
2D spline on plane
plane
plan désocclusion
offset
Clear Spline
Suivant
Mesures 2D
Coupe 2D - plan désocclusion
Décalage plan
0.00 mm
10:19
05/11/2014


ApplianceDesigner - [test planas\premier set\pistes]
Application Modèles Vue Aide
Composants Fonctions Workflows
Didacticiel du process act
Etapes du process actif
Définir direction d'insertion
Définir spline
Créer barre
Post-traitement création barre
Bar Settings
Bar type pist
Fin Plat
Use fixed-on-model spline
Fit bar surface to spline
Adjust width
Suivant
Mesures 2D
Coupe 2D - plan désocclusion
Décalage plan: 0.00 mm
10:19
05/11/2014


ApplianceDesigner - [test planas\premier set\pistes]
Application Modèles Vue Aide
Components Features Workflows
Create new part
Scanned models
Partsecteur1
Partsecteur2
Partsecteur3
Partsecteur4
3shape
13:30
04/06/2014


ApplianceDesigner - [test planas\premier set\piste]
Application Modèles Vue Aide
Components Features Workflows
Create new part
Scanned models
pistesecteur1
pistesecteur2
pistesecteur3
pistesecteur4
2D measurements
Coupe 2D - Cross-section Plane 3
Plane offset: 0.00 mm
12:58
04/06/2014


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie
Impression d'arcades ou moulages 3D
AXE ORTHO CONCEPTION


Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Moulages numériques
Etude et analyse
Echange prothésiste/ clinicien
Cabinet d'orthodontie
Impression d'arcades ou moulages 3D
AXE ORTHO CONCEPTION

LA SOLUTION GLOBALE 3D

QUELS OBJECTIFS?

LA SOLUTION GLOBALE 3D

QUELS OBJECTIFS?

MOULAGES NUMERIQUES?

LA SOLUTION GLOBALE 3D

QUELS OBJECTIFS?

MOULAGES NUMERIQUES?
LE SET UP NUMERIQUE?

LA SOLUTION GLOBALE 3D

QUELS OBJECTIFS?

MOULAGES NUMERIQUES?
LE SET UP NUMERIQUE?
LES ORTHESES?

LA SOLUTION GLOBALE 3D

QUELS OBJECTIFS?

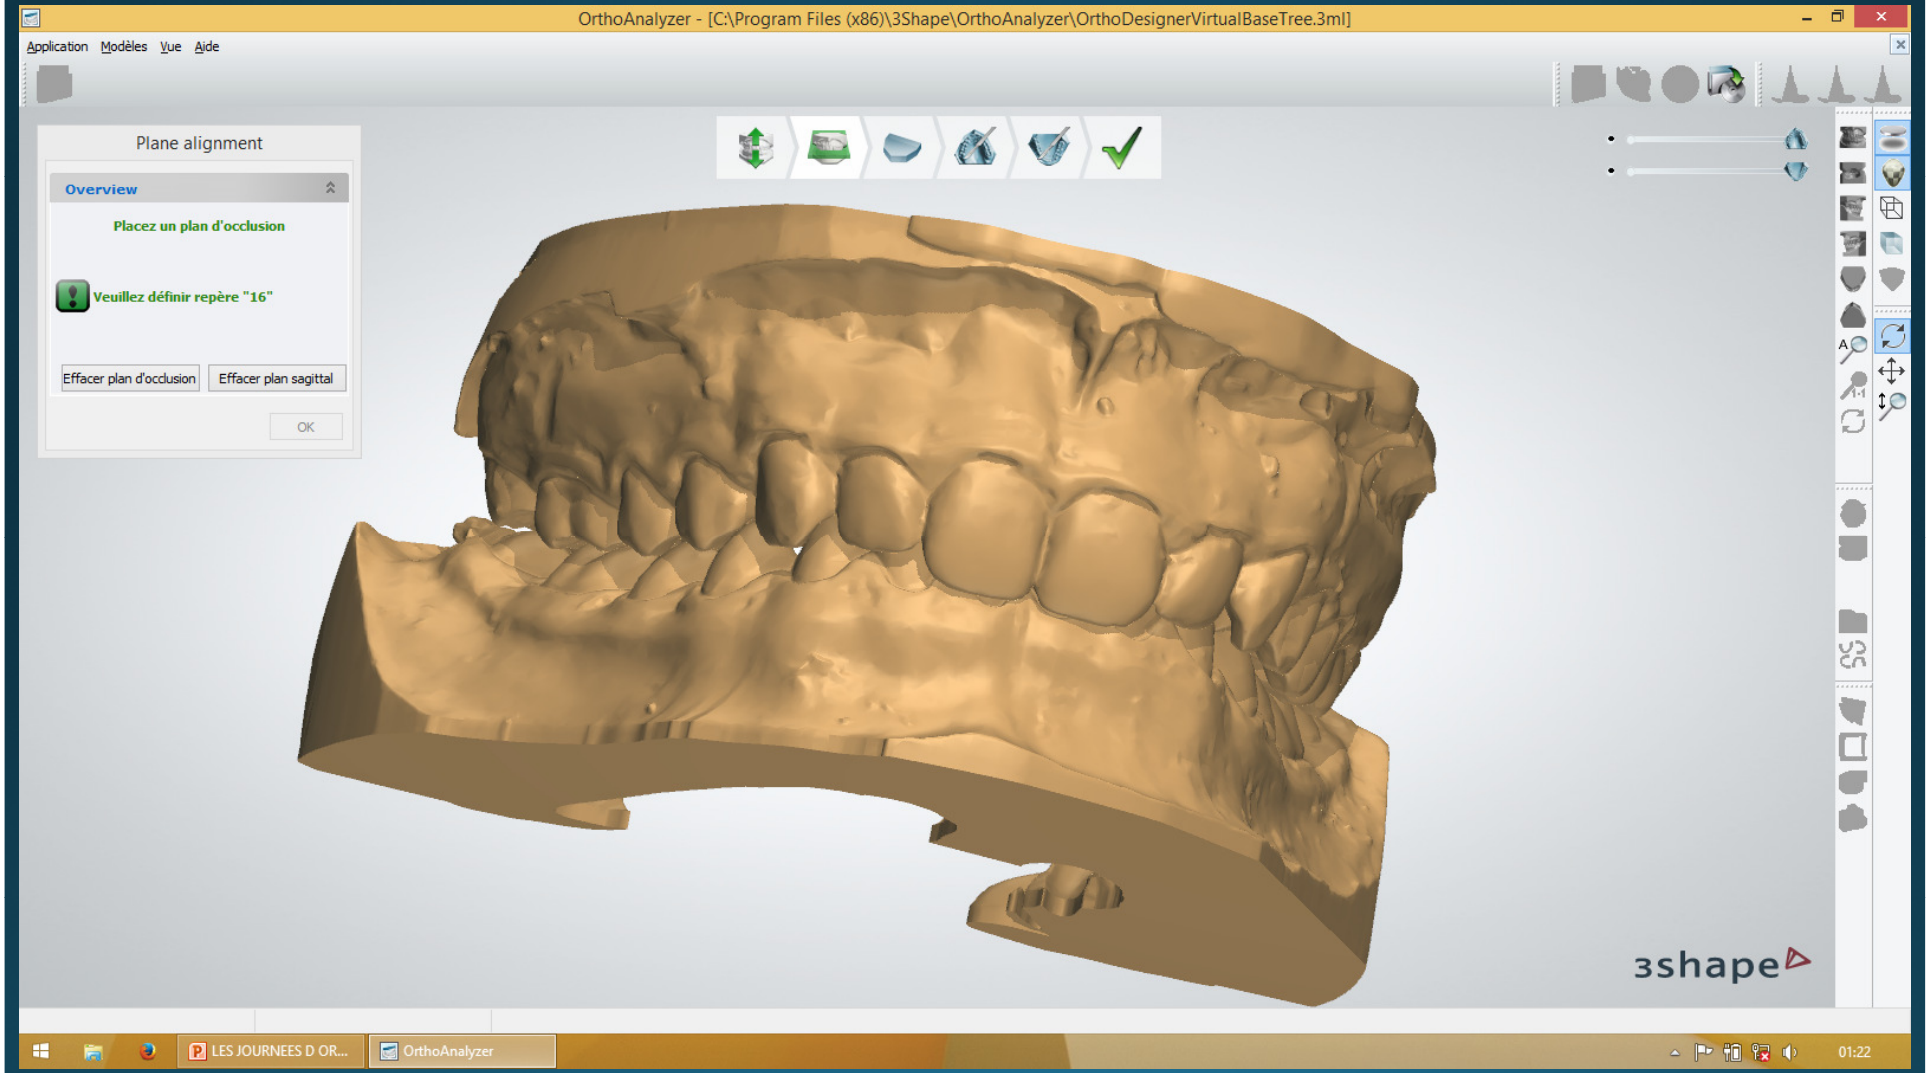
MOULAGES NUMERIQUES?
LE SET UP NUMERIQUE?
LES ORTHESES?

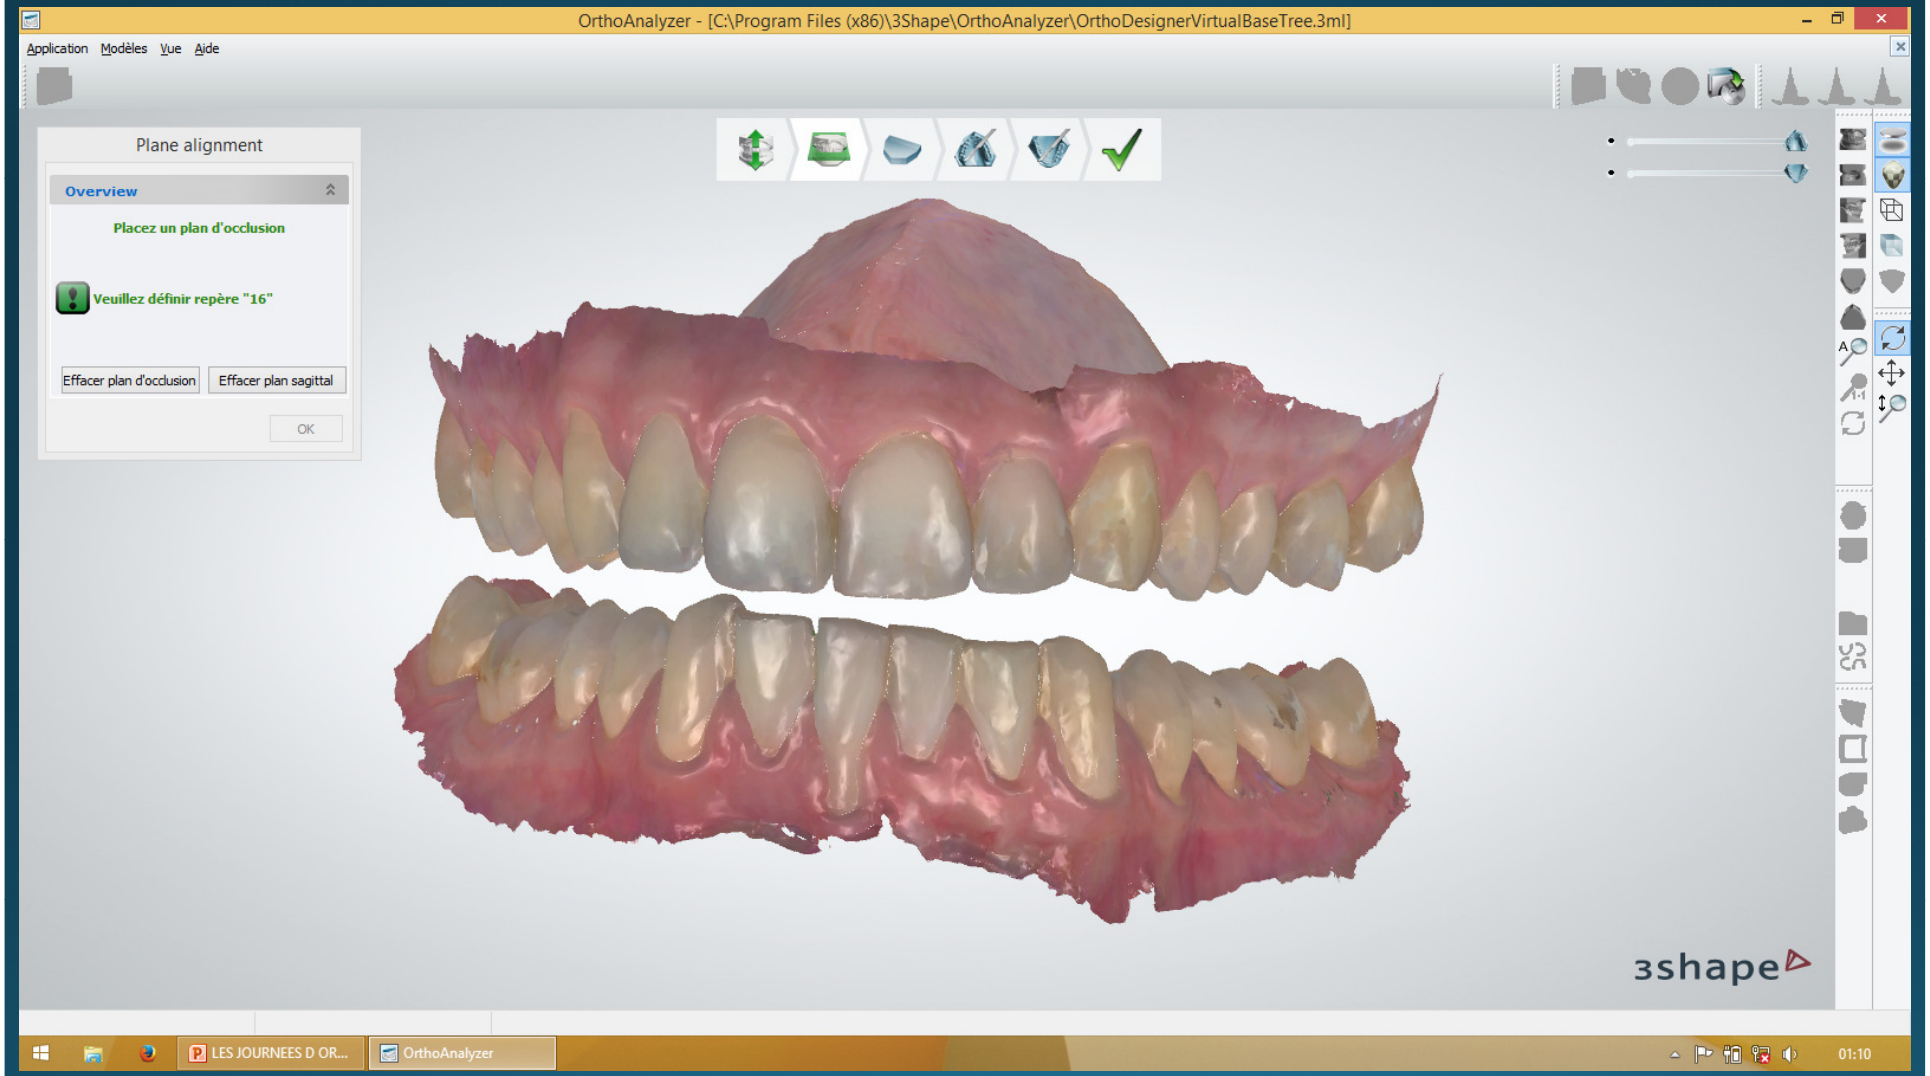
AVEC LE LOGICIEL ORTHOANALYZER

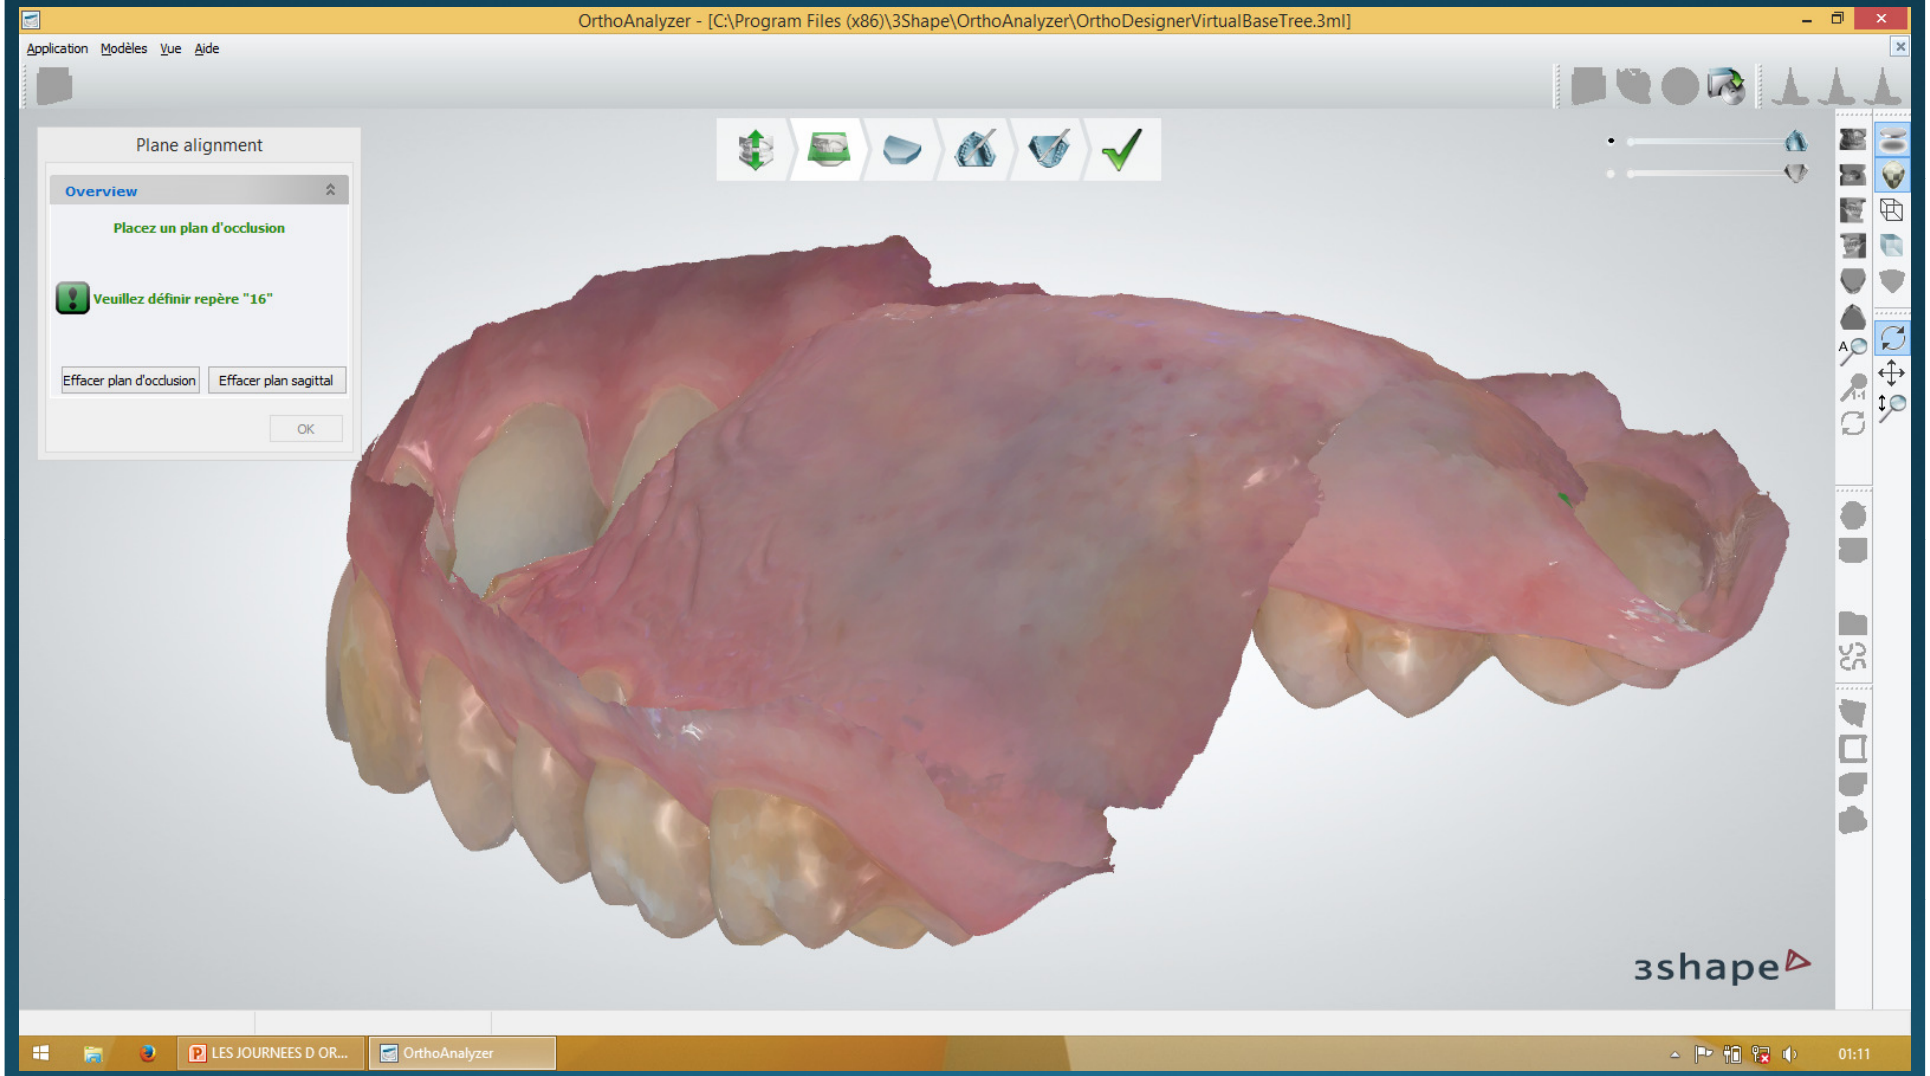
LA SOLUTION GLOBALE 3D

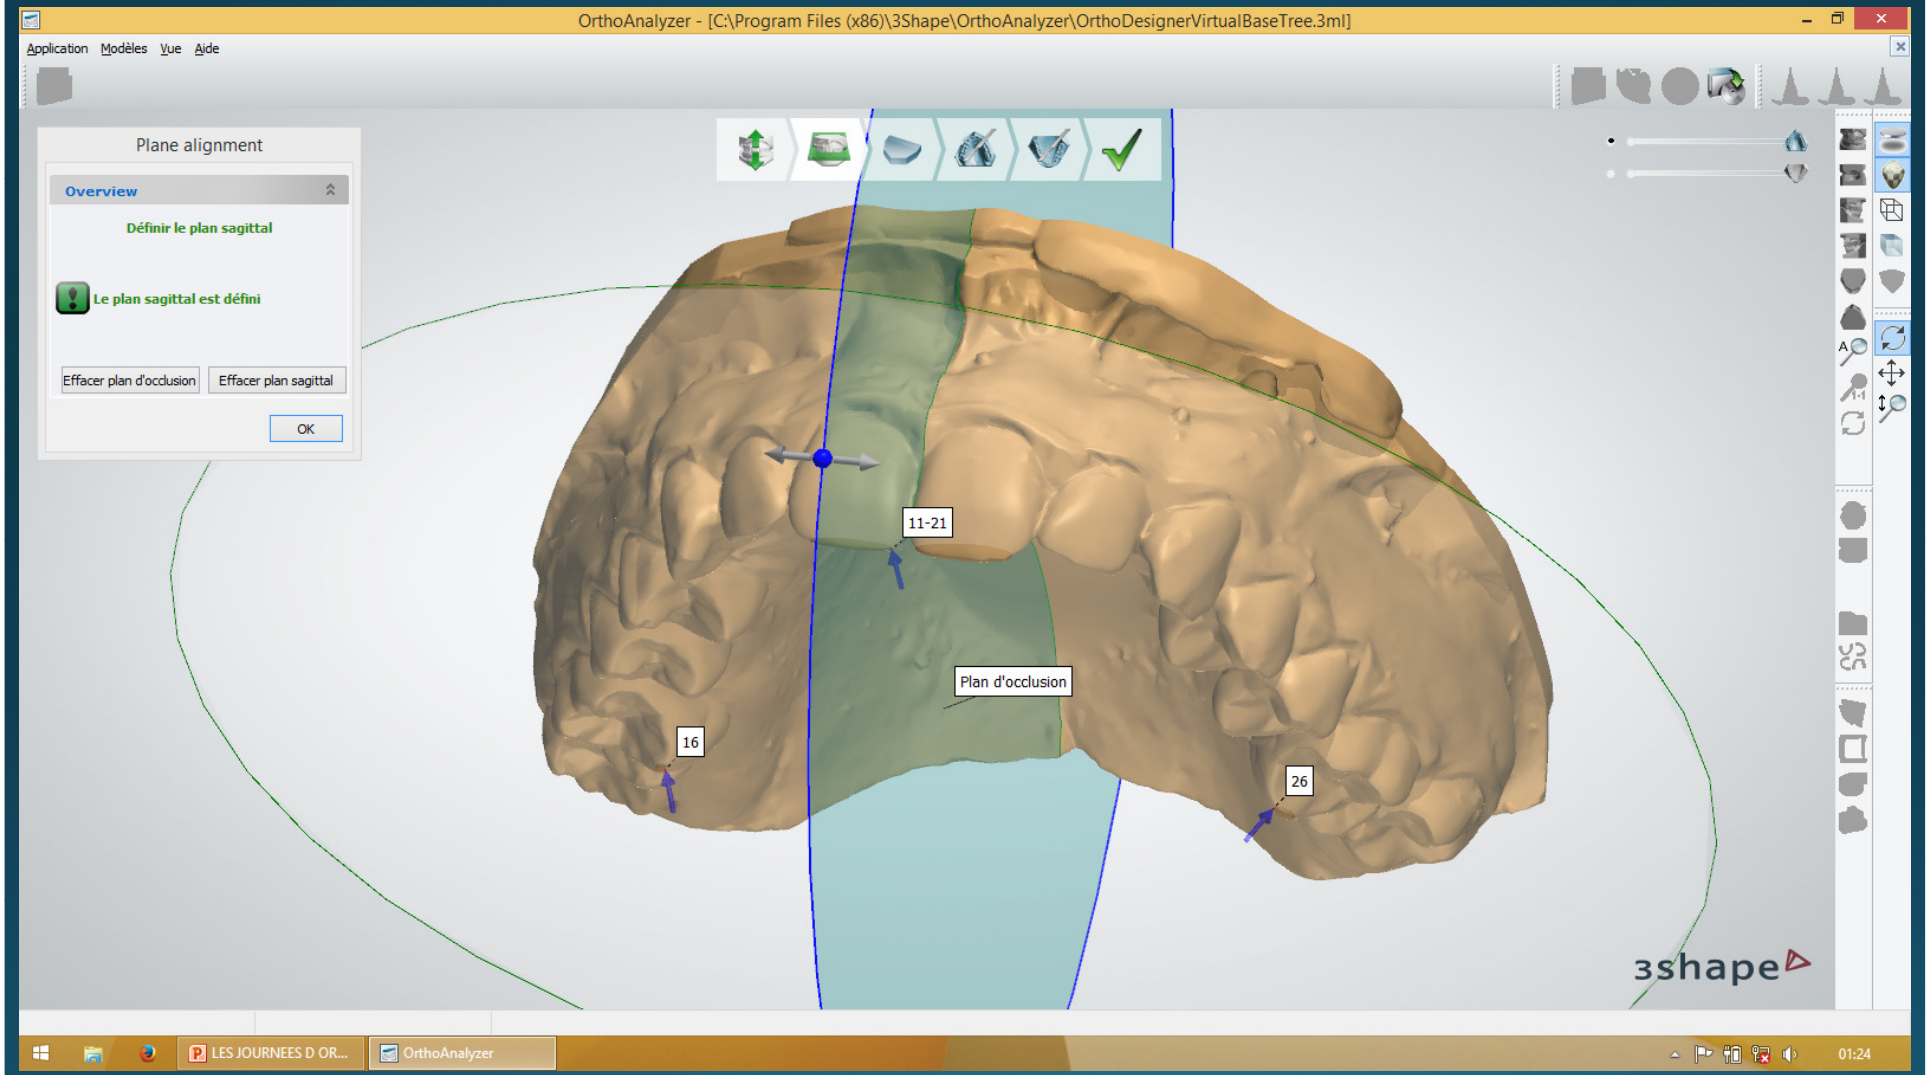
MOULAGES NUMERIQUES

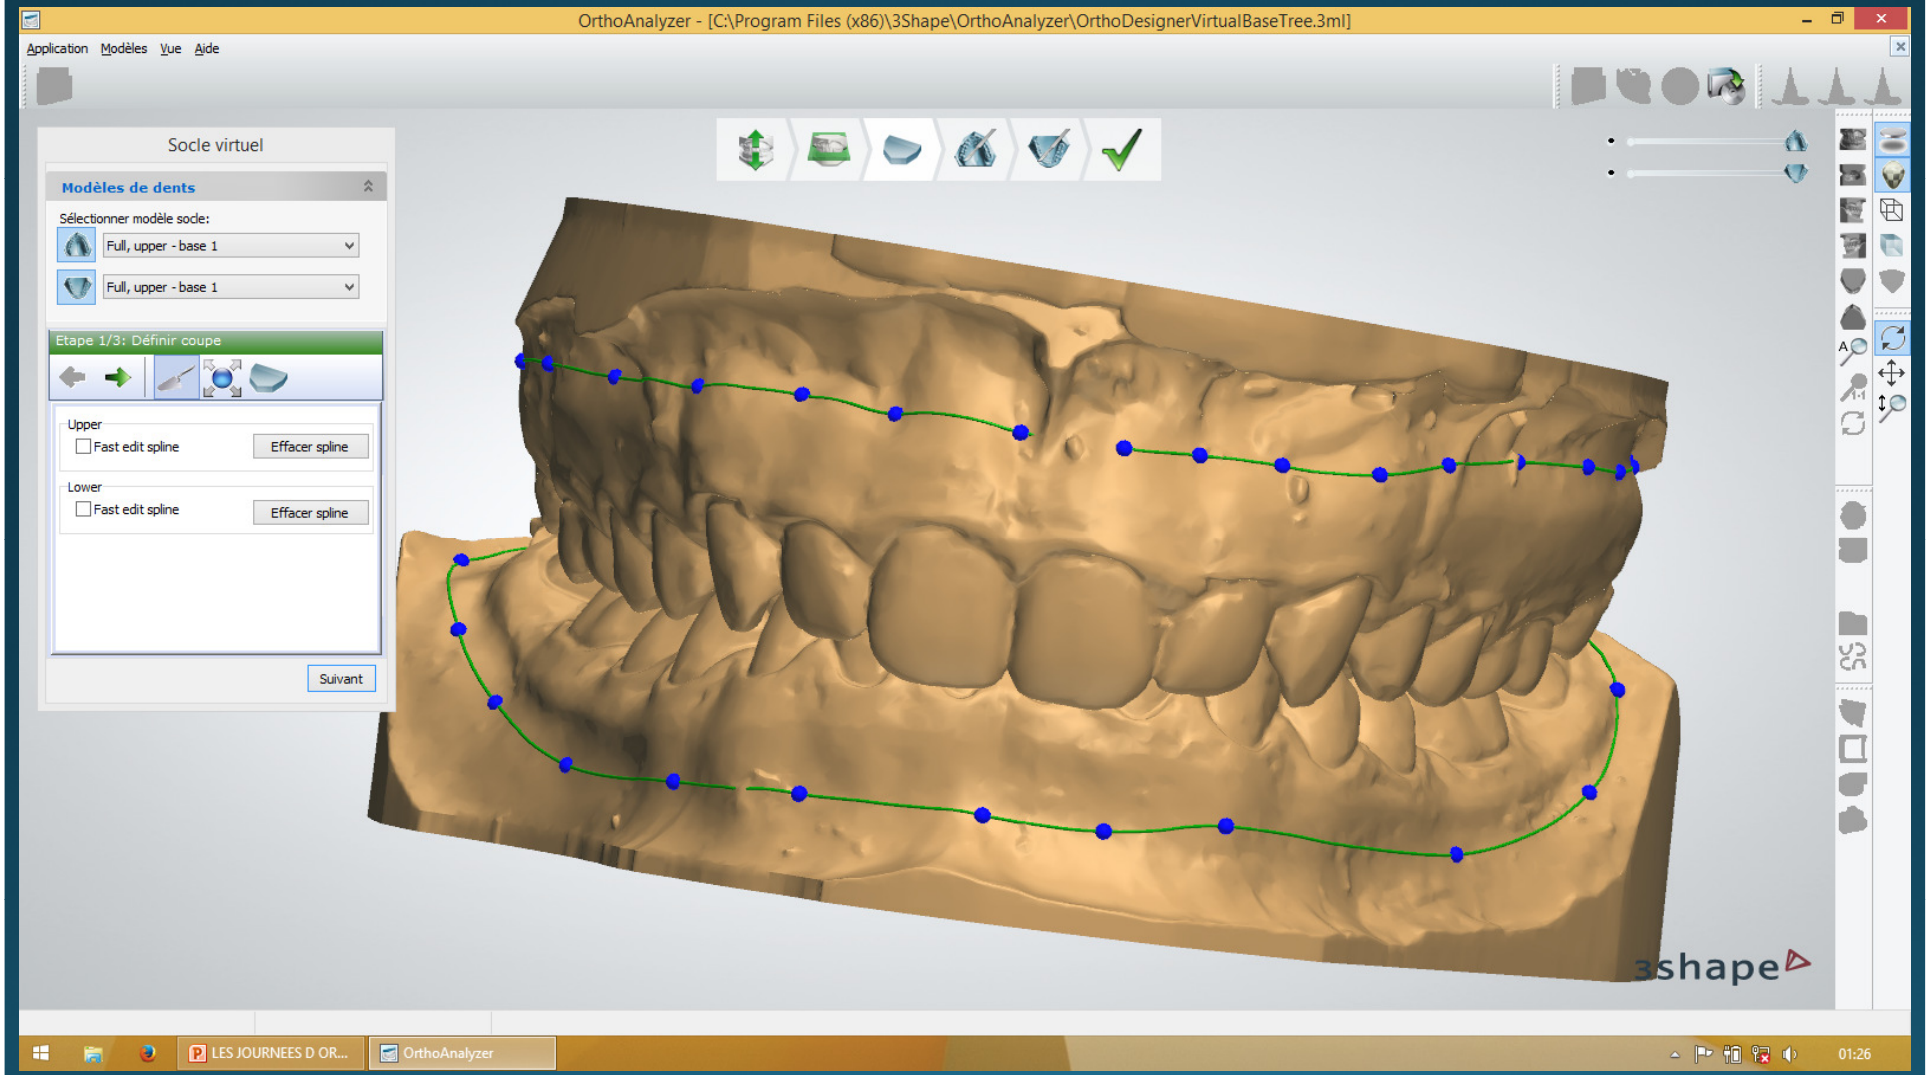
LA SOLUTION GLOBALE 3D

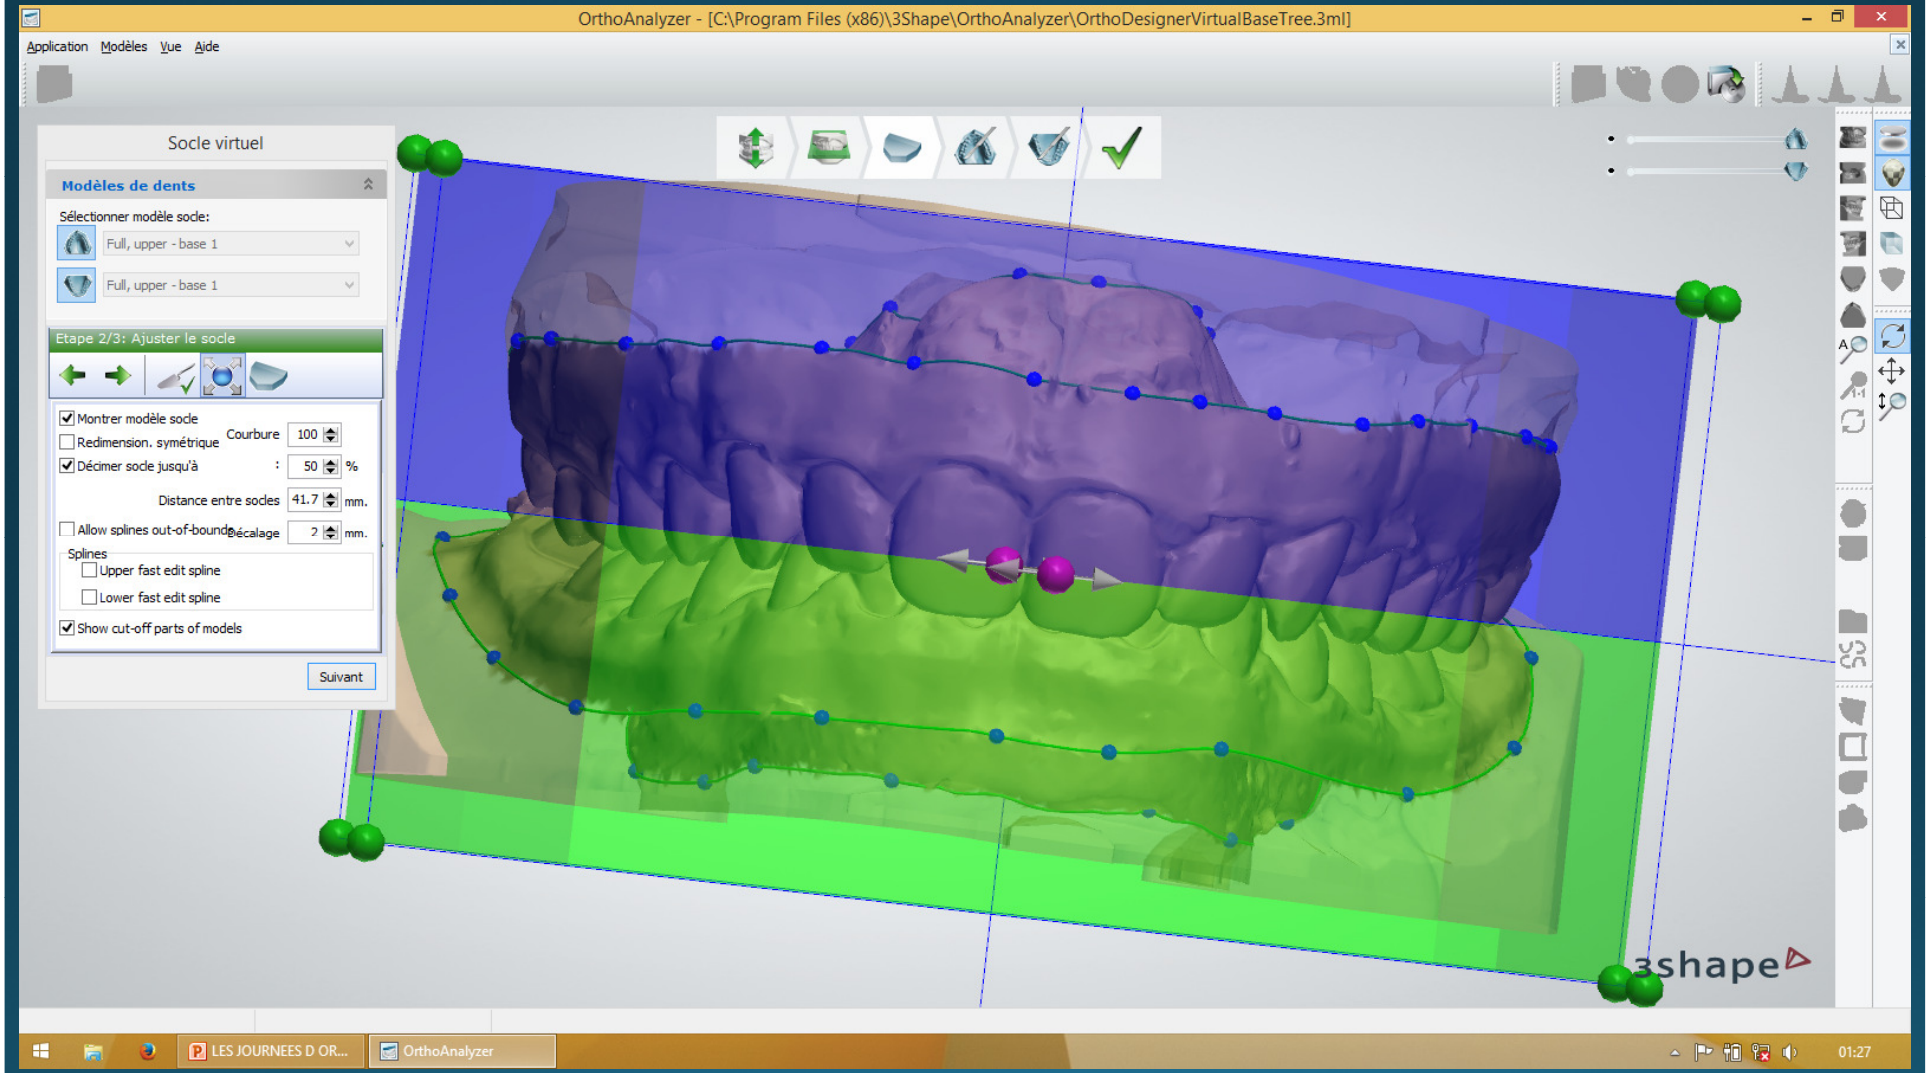

OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Plane alignment
Overview
Placez un plan d'occlusion
Veuillez définir repère "16"
Effacer plan d'occlusion
Effacer plan sagittal
OK
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:22

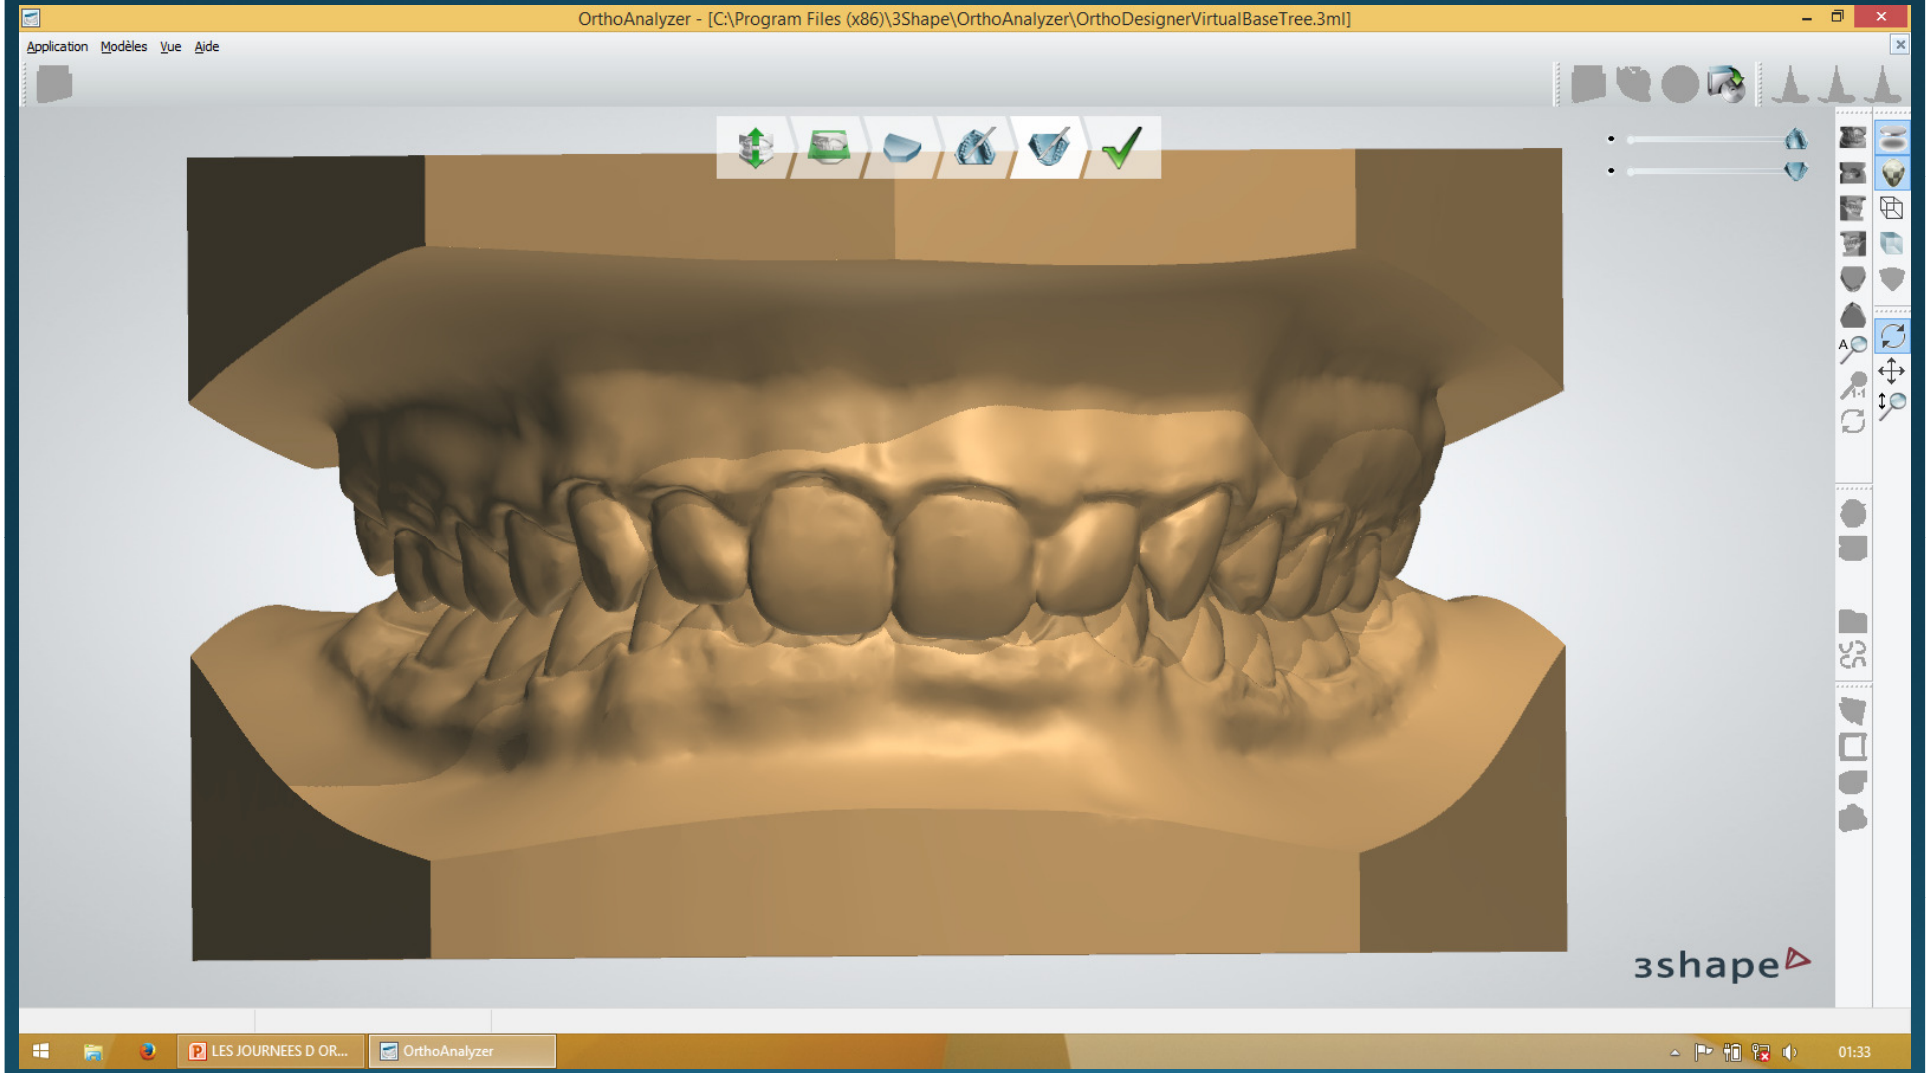

OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Plane alignment
Overview
Placez un plan d'occlusion
Veuillez définir repère "16"
Effacer plan d'occlusion
Effacer plan sagittal
OK
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:10

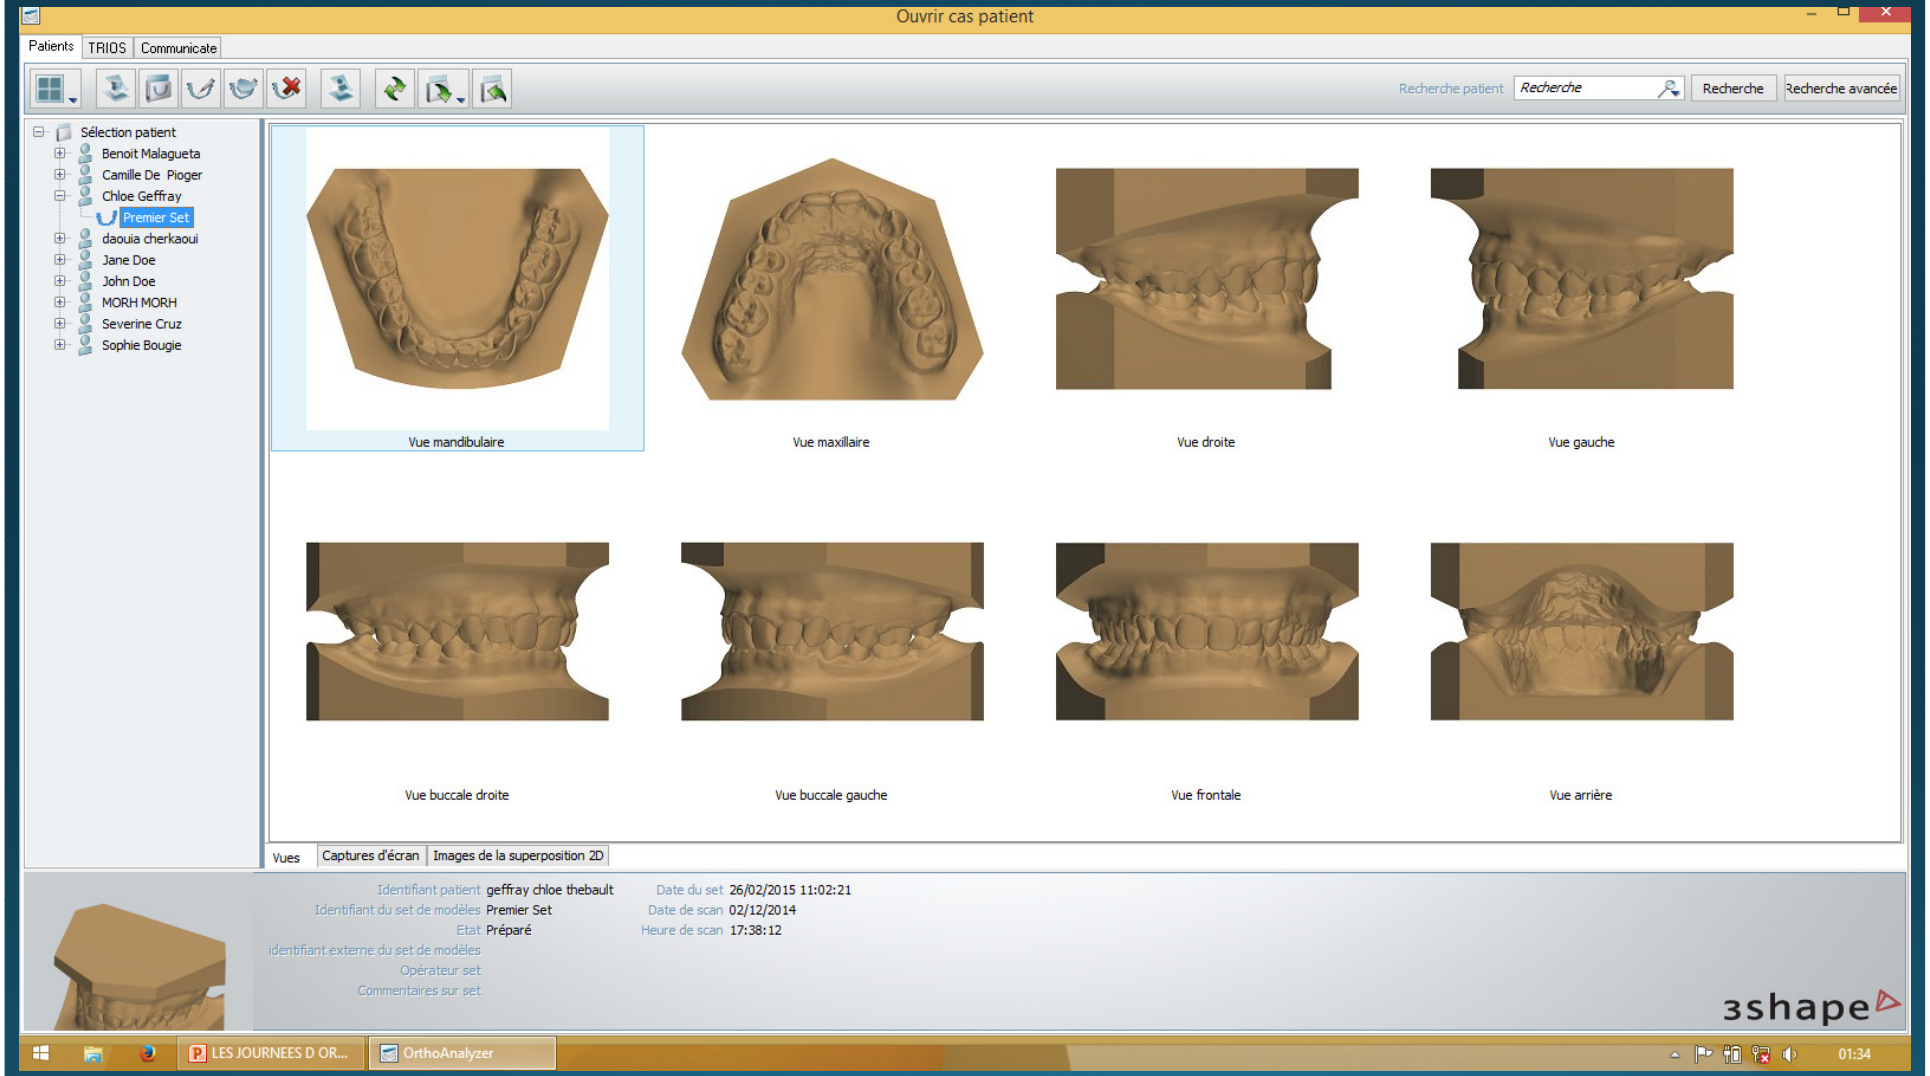

OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Plane alignment
Overview
Placez un plan d'occlusion
Veuillez définir repère "16"
Effacer plan d'occlusion
Effacer plan sagittal
OK
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:11

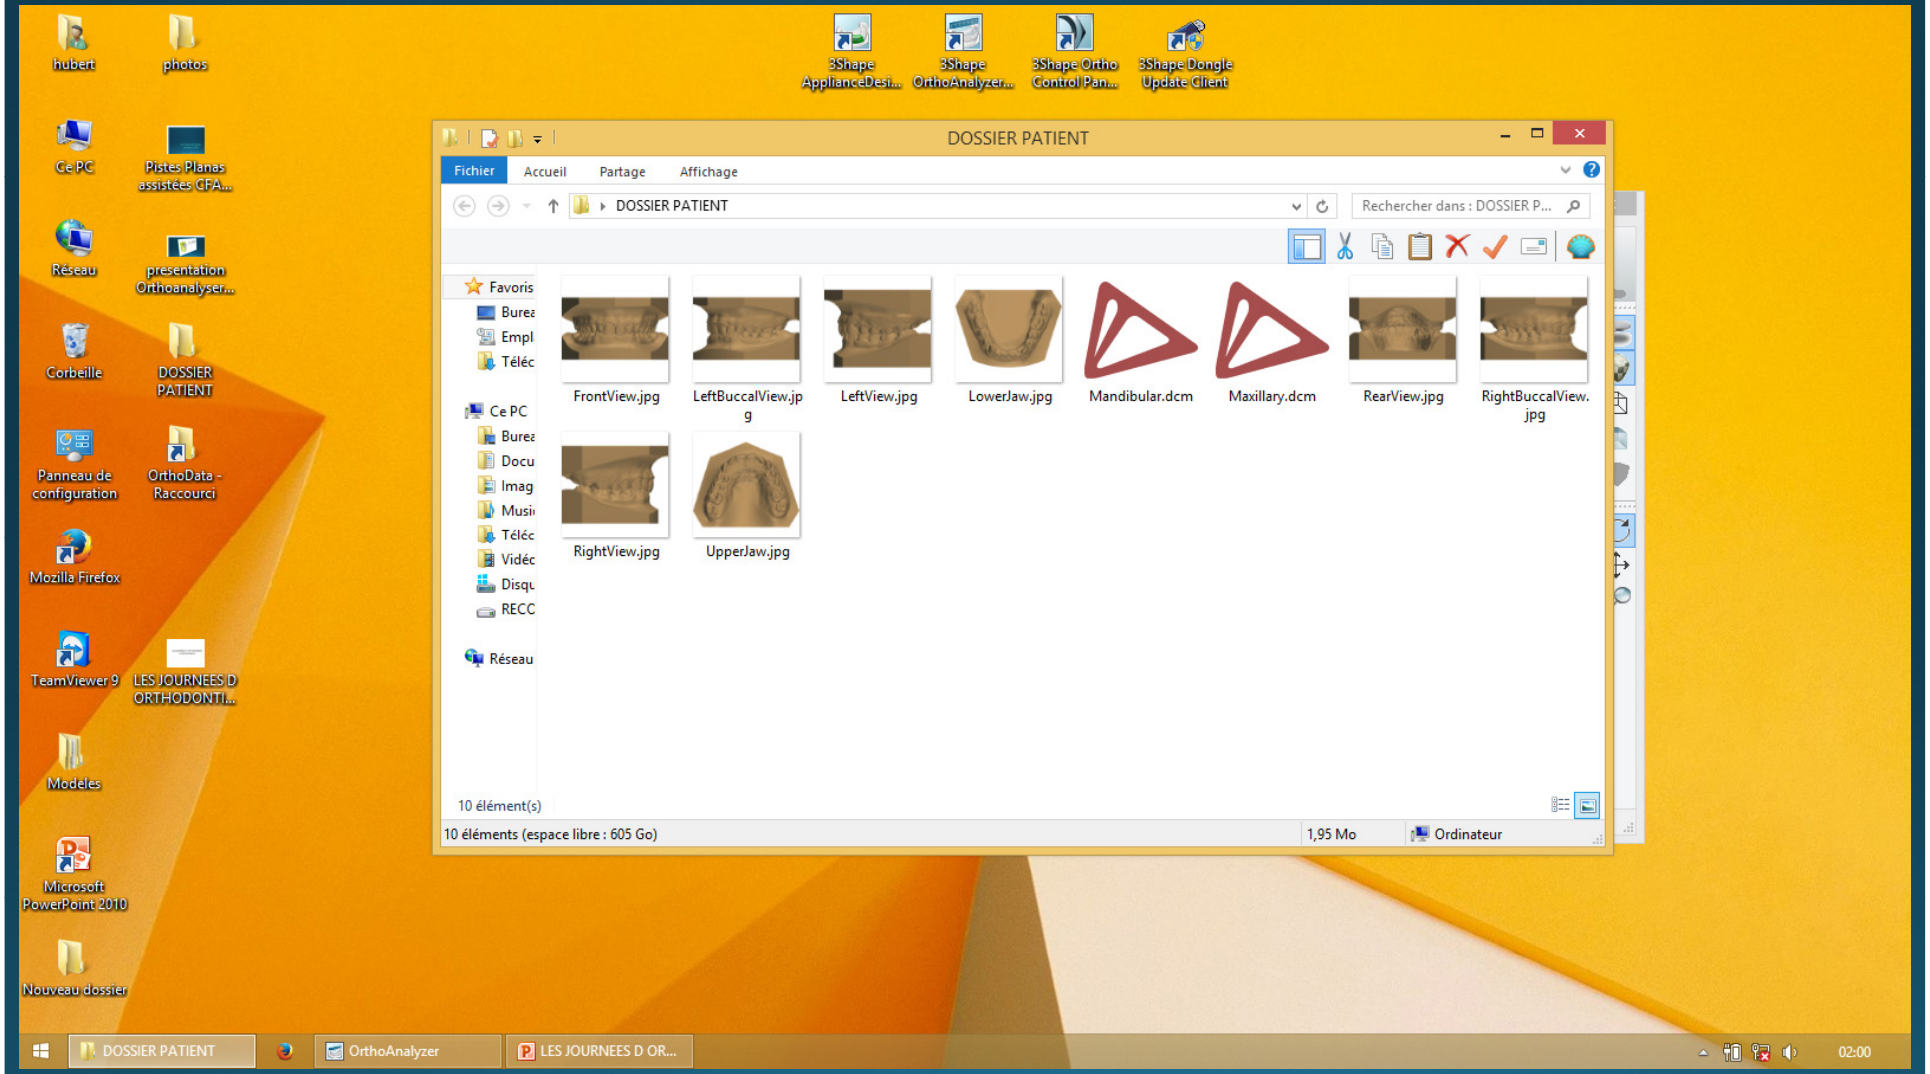

OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Plane alignment
Overview
Définir le plan sagittal
Le plan sagittal est défini
Effacer plan d'occlusion
Effacer plan sagittal
OK
11-21
Plan d'occlusion
16
26
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:24

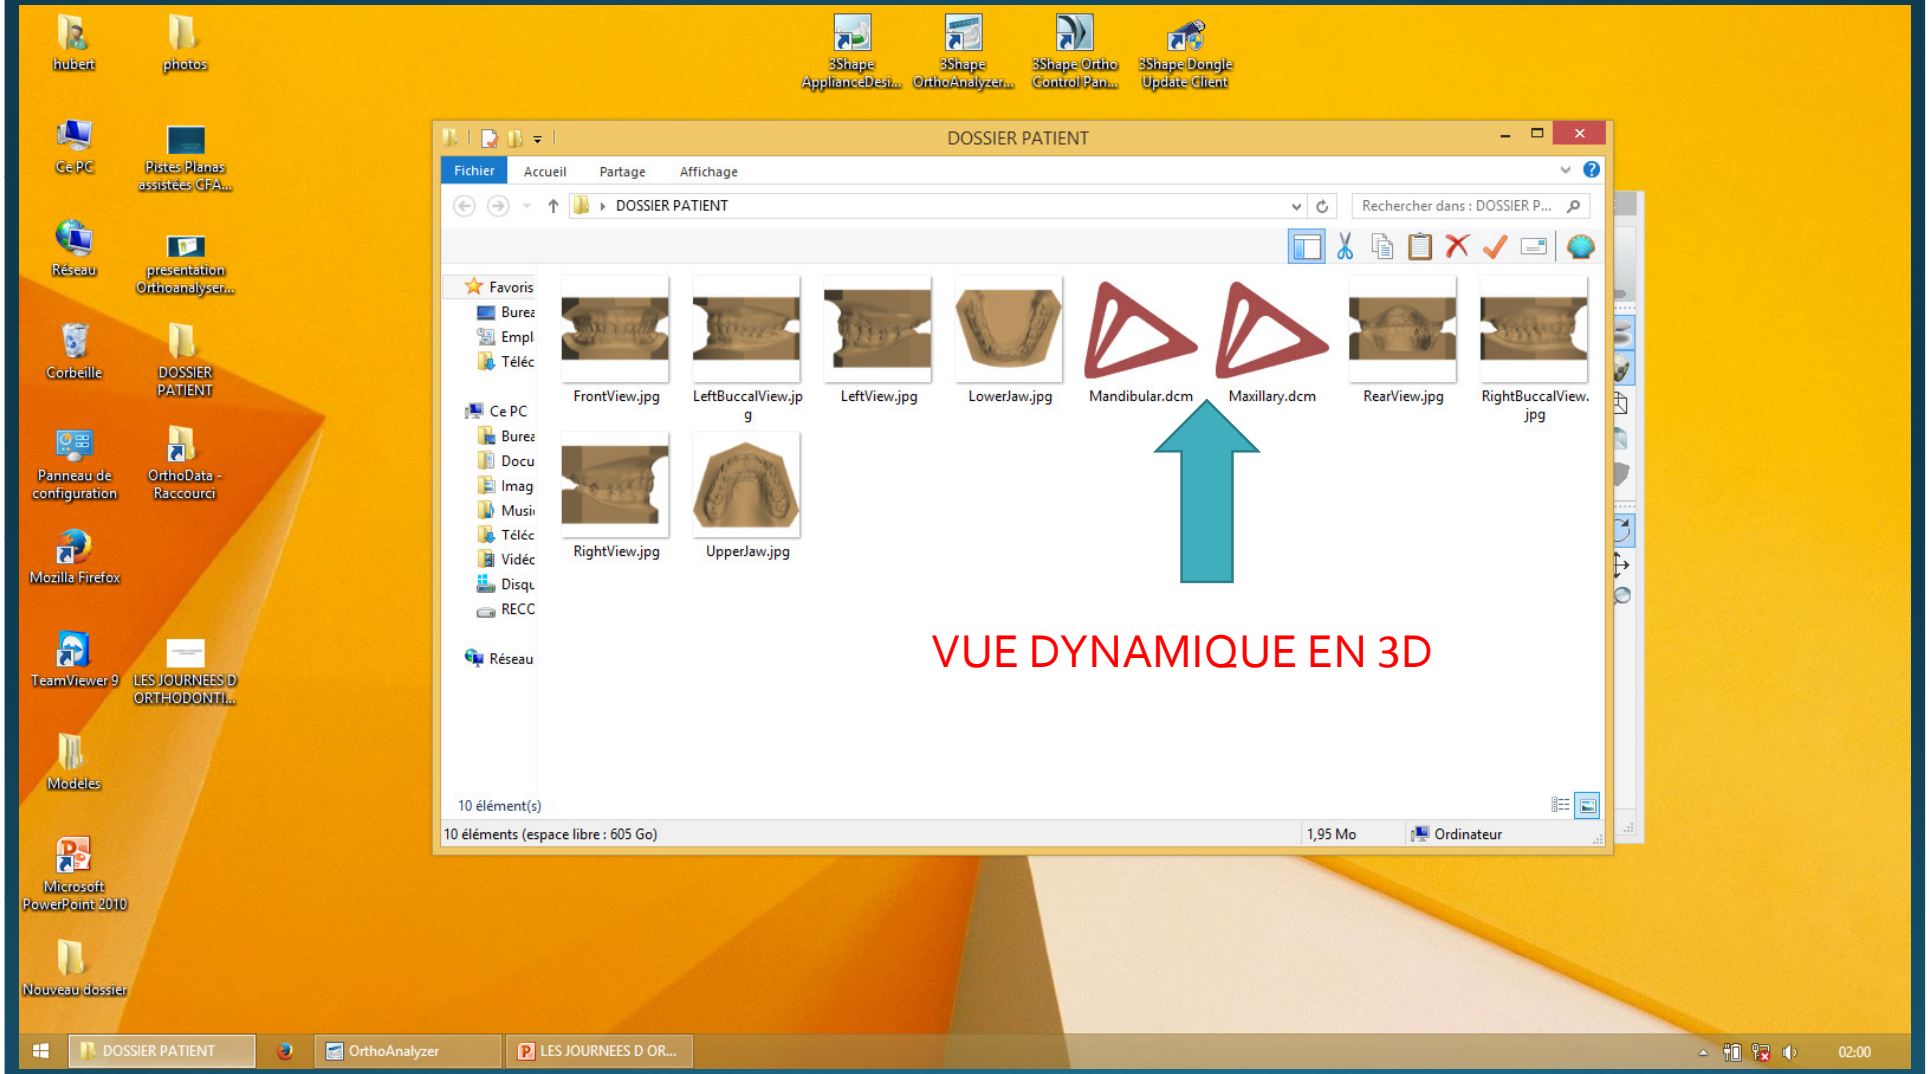

OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Socle virtuel
Modèles de dents
Sélectionner modèle socle:
Full, upper - base 1
Full, upper - base 1
Etape 1/3: Définir coupe
Upper
Fast edit spline
Effacer spline
Lower
Fast edit spline
Effacer spline
Suivant
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:26

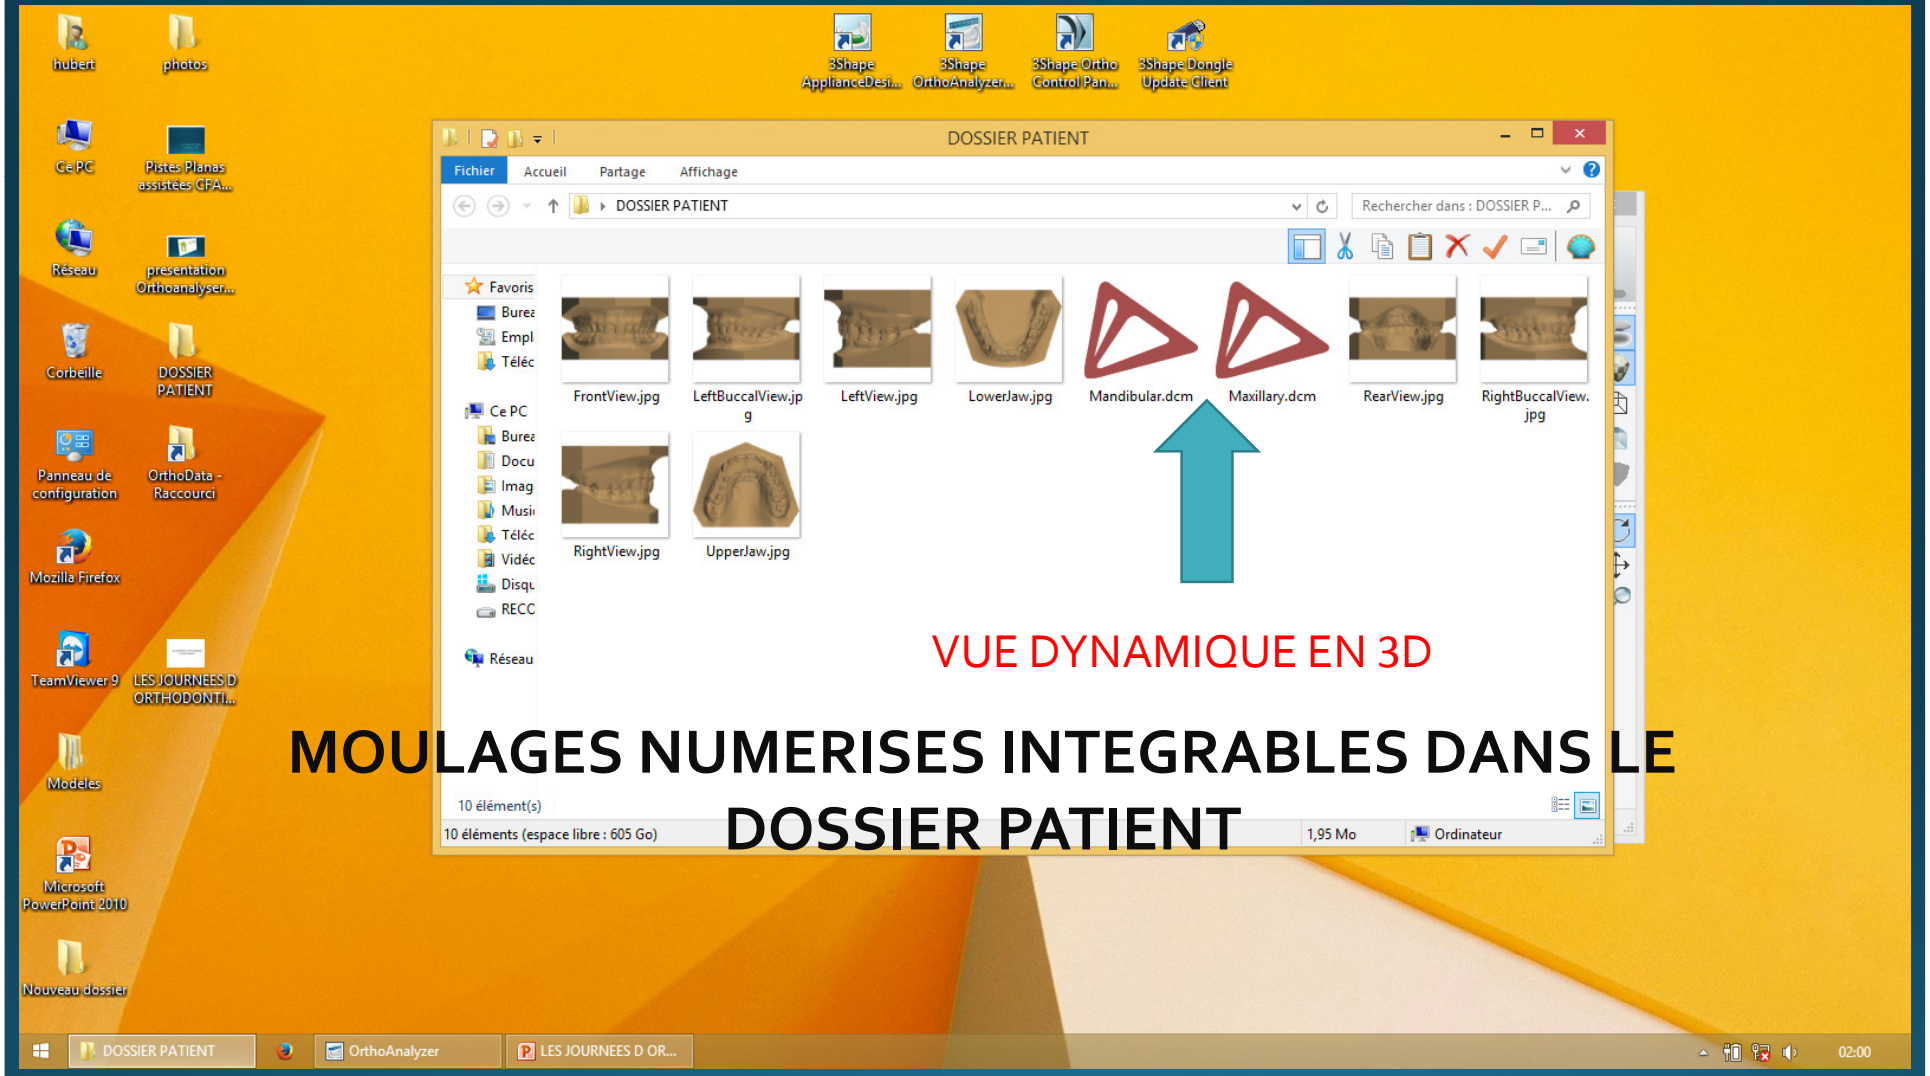

OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Socle virtuel
Modèles de dents
Sélectionner modèle socle:
Full, upper - base 1
Full, upper - base 1
Etape 2/3: Ajuster le socle
Montrer modèle socle
Redimension. symétrique
Courbure 100
Décimer socle jusqu'à : 50 %
Distance entre socles 41.7 mm.
Allow splines out-of-bounds
Décalage 2 mm.
Splines
Upper fast edit spline
Lower fast edit spline
Show cut-off parts of models
Suivant
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:27


OrthoAnalyzer - [C:\Program Files (x86)\3Shape\OrthoAnalyzer\OrthoDesignerVirtualBaseTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:33

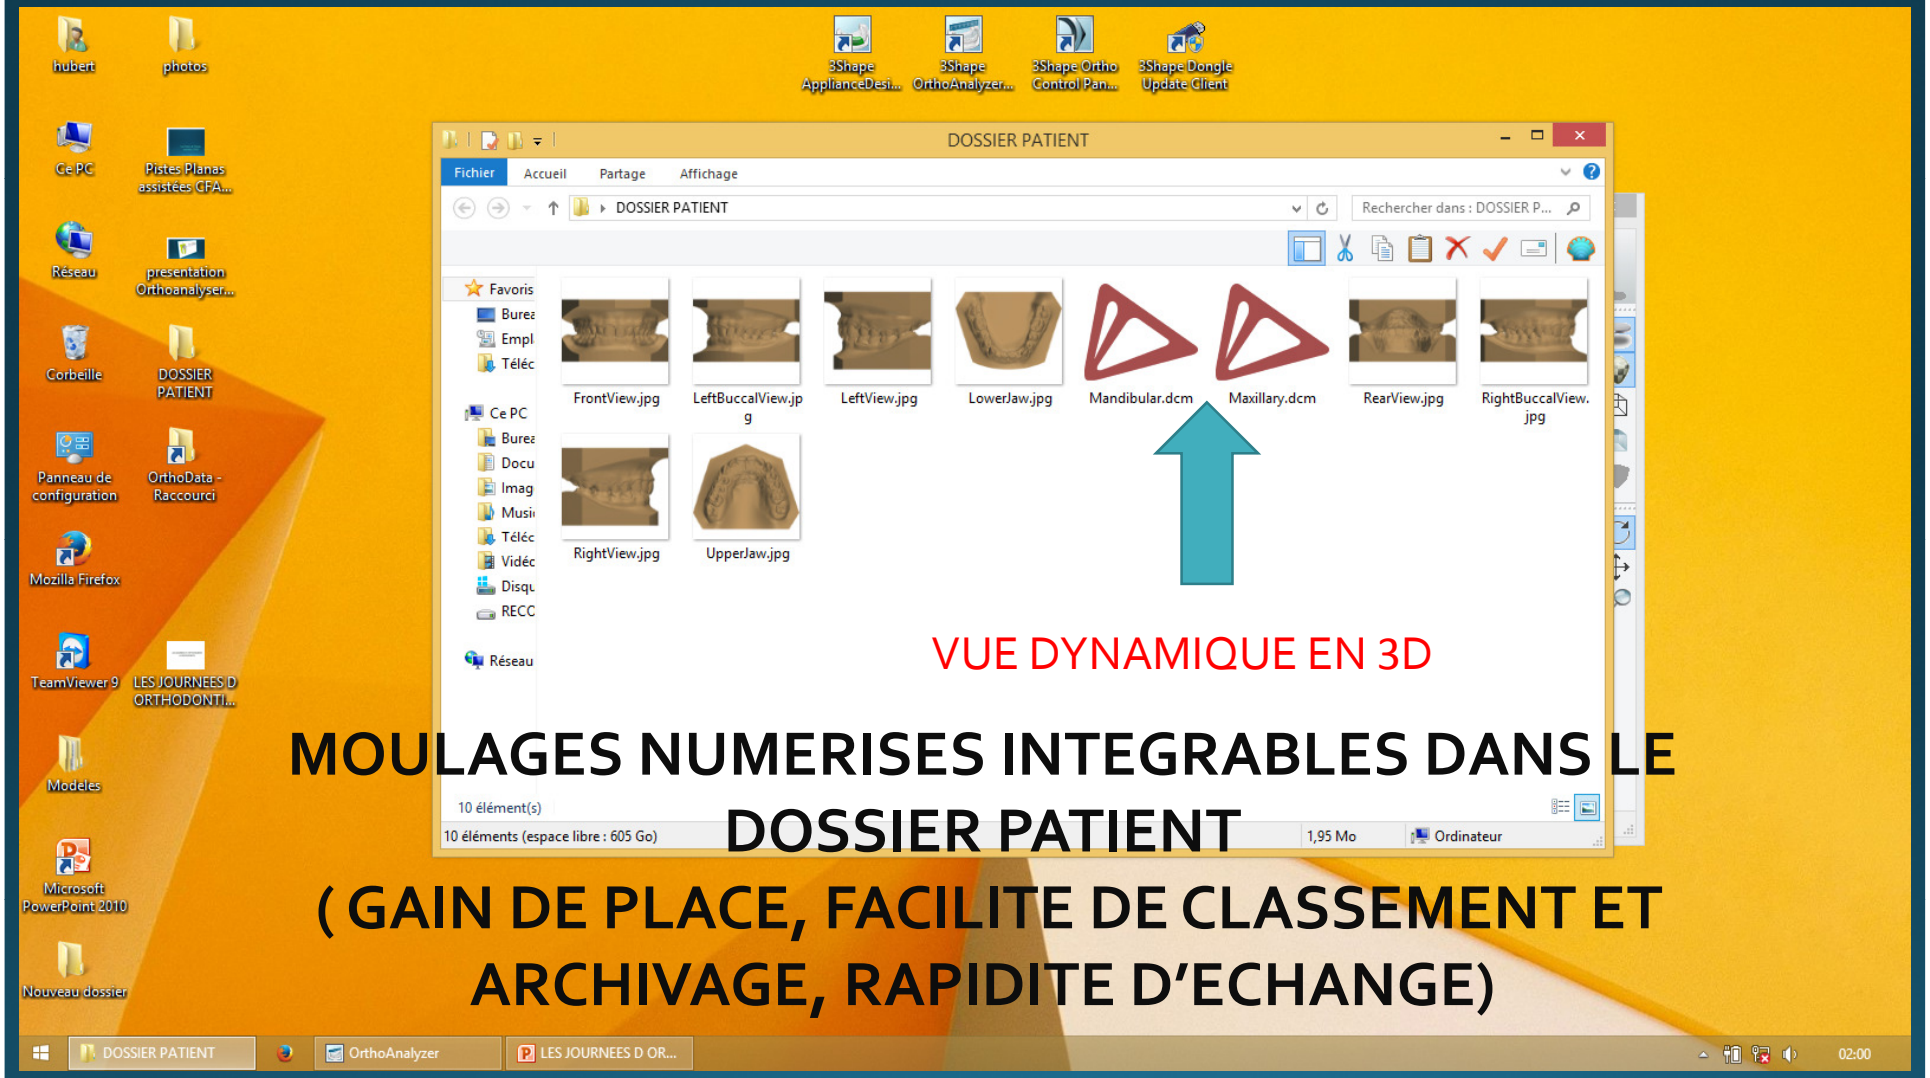

Ouvrir cas patient
Patients
TRIOS
Communicate
Recherche patient
Recherche
Recherche
Recherche avancée
Sélection patient
Benoit Malagueta
Camille De Pioger
Chloe Geffray
Premier Set
daouia cherkaoui
Jane Doe
John Doe
MORH MORH
Severine Cruz
Sophie Bougie
Vue mandibulaire
Vue maxillaire
Vue droite
Vue gauche
Vue buccale droite
Vue buccale gauche
Vue frontale
Vue arrière
Vues
Captures d'écran
Images de la superposition 2D
Identifiant patient geffray chloe thebault
Identifiant du set de modèles Premier Set
Etat Préparé
identifiant externe du set de modèles
Opérateur set
Commentaires sur set
Date du set 26/02/2015 11:02:21
Date de scan 02/12/2014
Heure de scan 17:38:12
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:34


hubert
photos
3Shape Appliance Desi...
3Shape OrthoAnalyzer...
3Shape Ortho Control Pan...
3Shape Dongle Update Client
Ce PC
Pistes Planas assistées CFA...
Réseau
presentation Orthoanalyser...
Corbeille
DOSSIER PATIENT
Panneau de configuration
OrthoData - Raccourci
Mozilla Firefox
TeamViewer 9
LES JOURNEES D ORTHODONTI...
Modèles
Microsoft PowerPoint 2010
Nouveau dossier
DOSSIER PATIENT
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Rechercher dans : DOSSIER P...
Favoris
Ce PC
Réseau
FrontView.jpg
LeftBuccalView.jpg
LeftView.jpg
LowerJaw.jpg
Mandibular.dcm
Maxillary.dcm
RearView.jpg
RightBuccalView.jpg
RightView.jpg
UpperJaw.jpg
10 élément(s)
10 éléments (espace libre : 605 Go)
1,95 Mo
Ordinateur
DOSSIER PATIENT
OrthoAnalyzer
LES JOURNEES D OR...
02:00


DOSSIER PATIENT
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
FrontView.jpg
LeftBuccalView.jpg
LeftView.jpg
LowerJaw.jpg
Mandibular.dcm
Maxillary.dcm
RearView.jpg
RightBuccalView.jpg
RightView.jpg
UpperJaw.jpg
10 élément(s)
10 éléments (espace libre : 605 Go)
1,95 Mo
Ordinateur
VUE DYNAMIQUE EN 3D



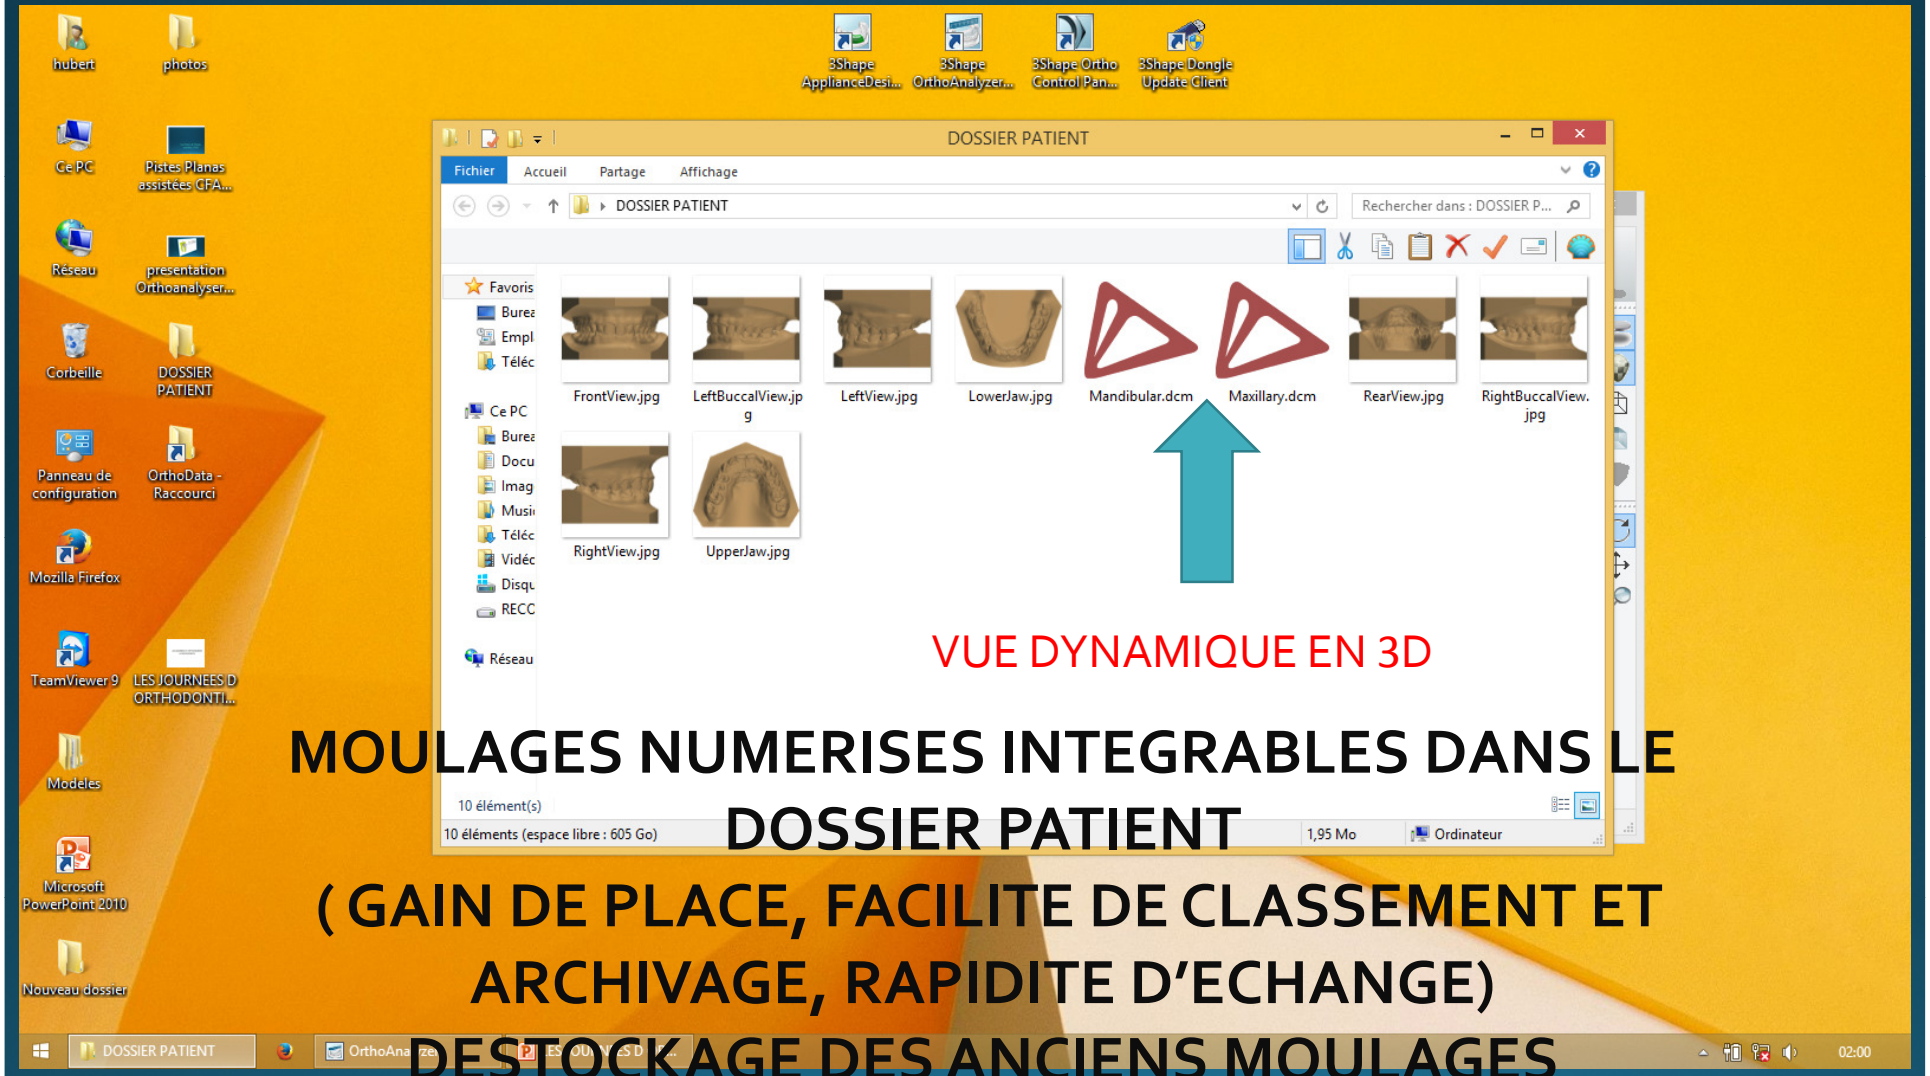
MOULAGES NUMERISES INTEGRABLES DANS LE DOSSIER PATIENT



VUE DYNAMIQUE EN 3D

MOULAGES NUMERISES INTEGRABLES DANS LE DOSSIER PATIENT

(GAIN DE PLACE, FACILITE DE CLASSEMENT ET ARCHIVAGE, RAPIDITE D'ECHANGE)



VUE DYNAMIQUE EN 3D

MOULAGES NUMERISES INTEGRABLES DANS LE DOSSIER PATIENT

(GAIN DE PLACE, FACILITE DE CLASSEMENT ET ARCHIVAGE, RAPIDITE D'ECHANGE)

DESTOCKAGE DES ANCIENS MOULAGES

LE SET UP NUMERIQUE

LA SOLUTION GLOBALE 3D

LE SET UP NUMERIQUE

UNE EVOLUTION IMPORTANTE DANS NOTRE QUOTIDIEN

LA SOLUTION GLOBALE 3D

LE SET UP NUMERIQUE

UNE EVOLUTION IMPORTANTE DANS NOTRE QUOTIDIEN
FIABILITE,

LA SOLUTION GLOBALE 3D

LE SET UP NUMERIQUE

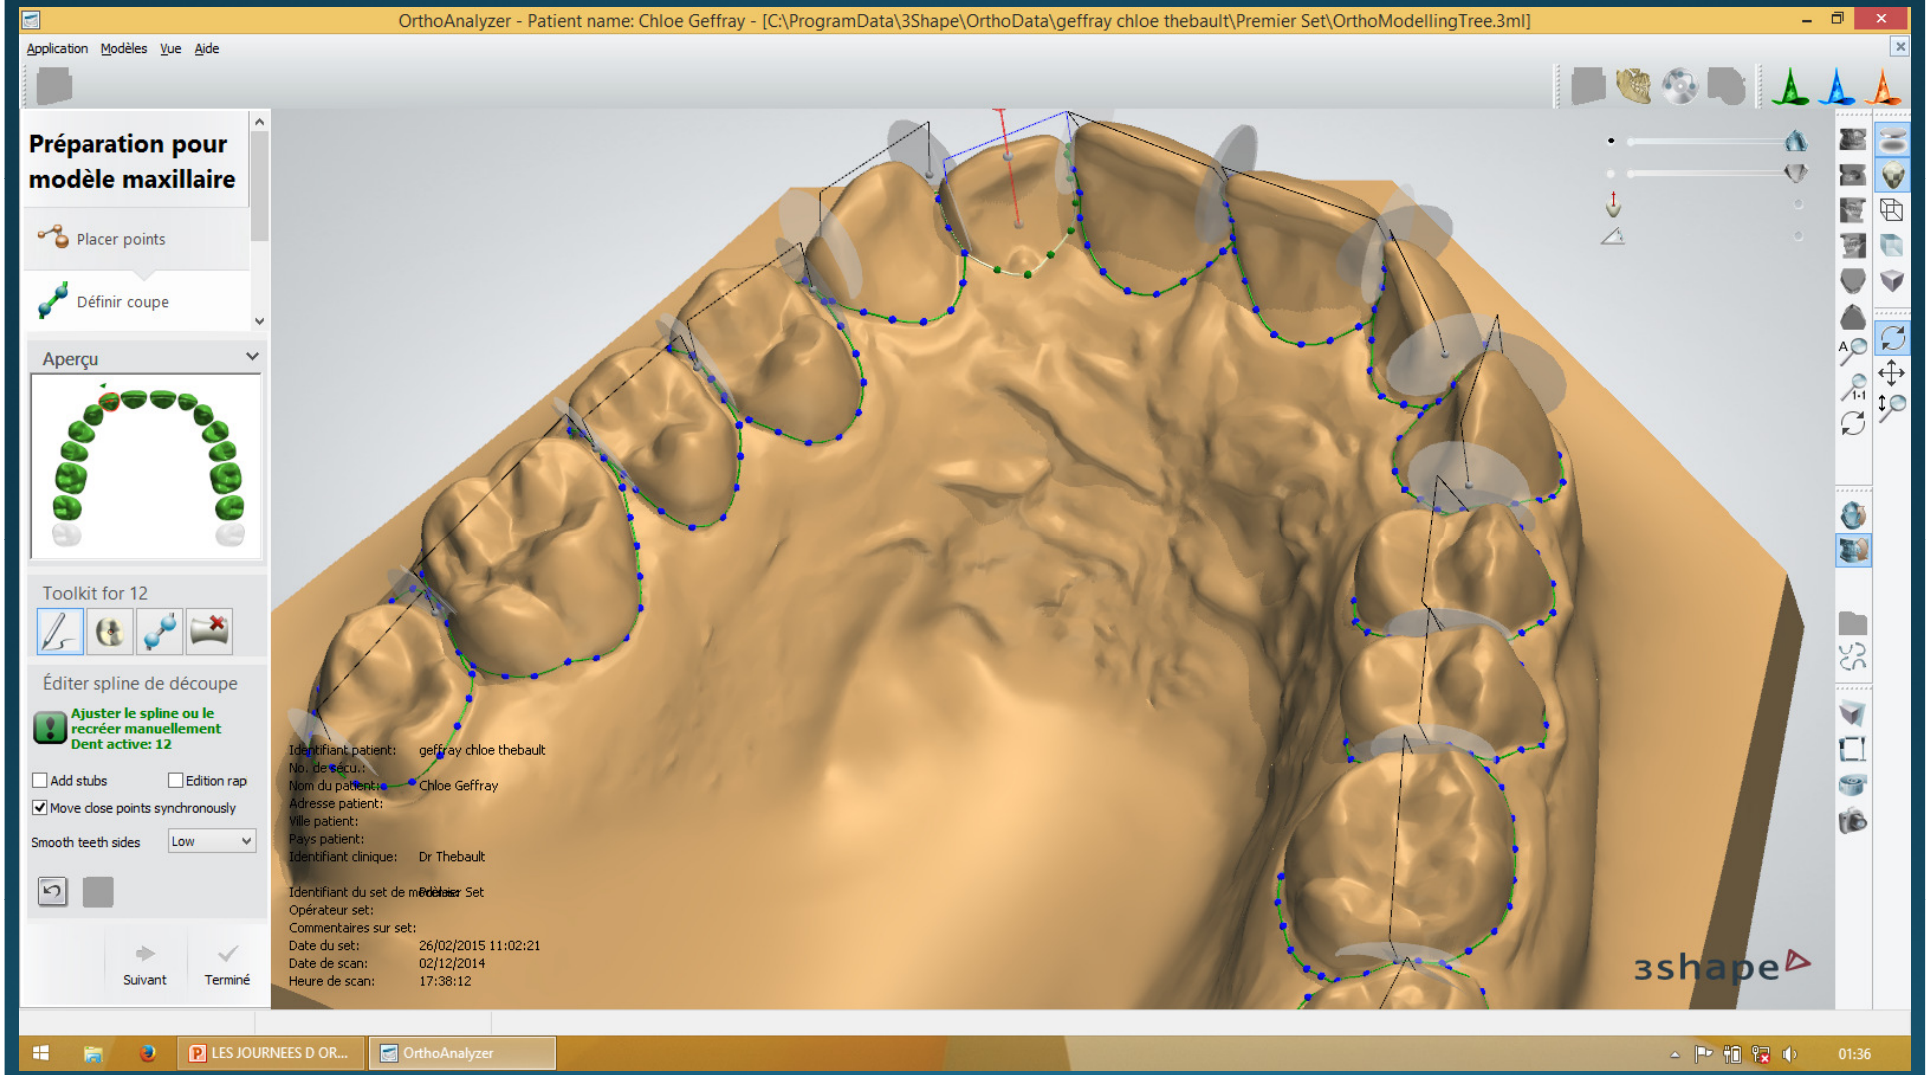
UNE EVOLUTION IMPORTANTE DANS NOTRE QUOTIDIEN
FIABILITE,
REPRODUCTIBILITE,

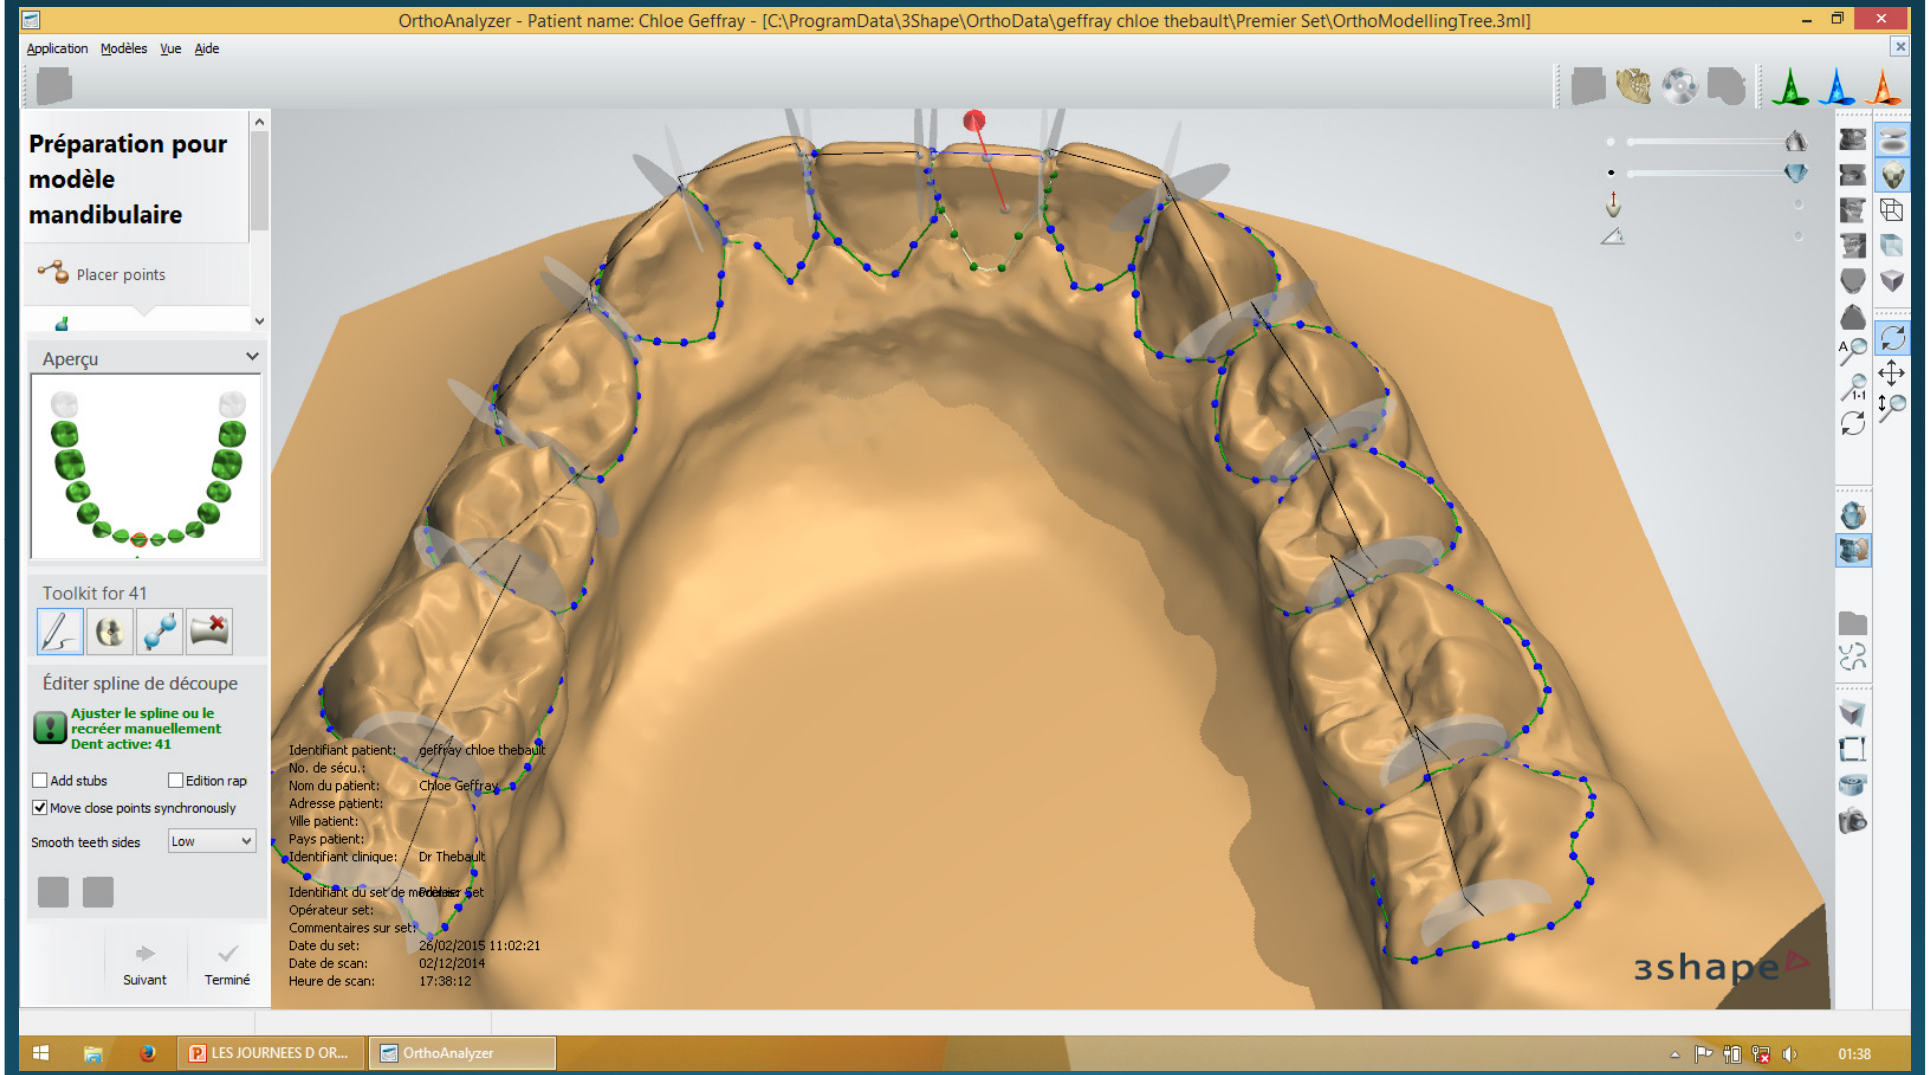
LA SOLUTION GLOBALE 3D

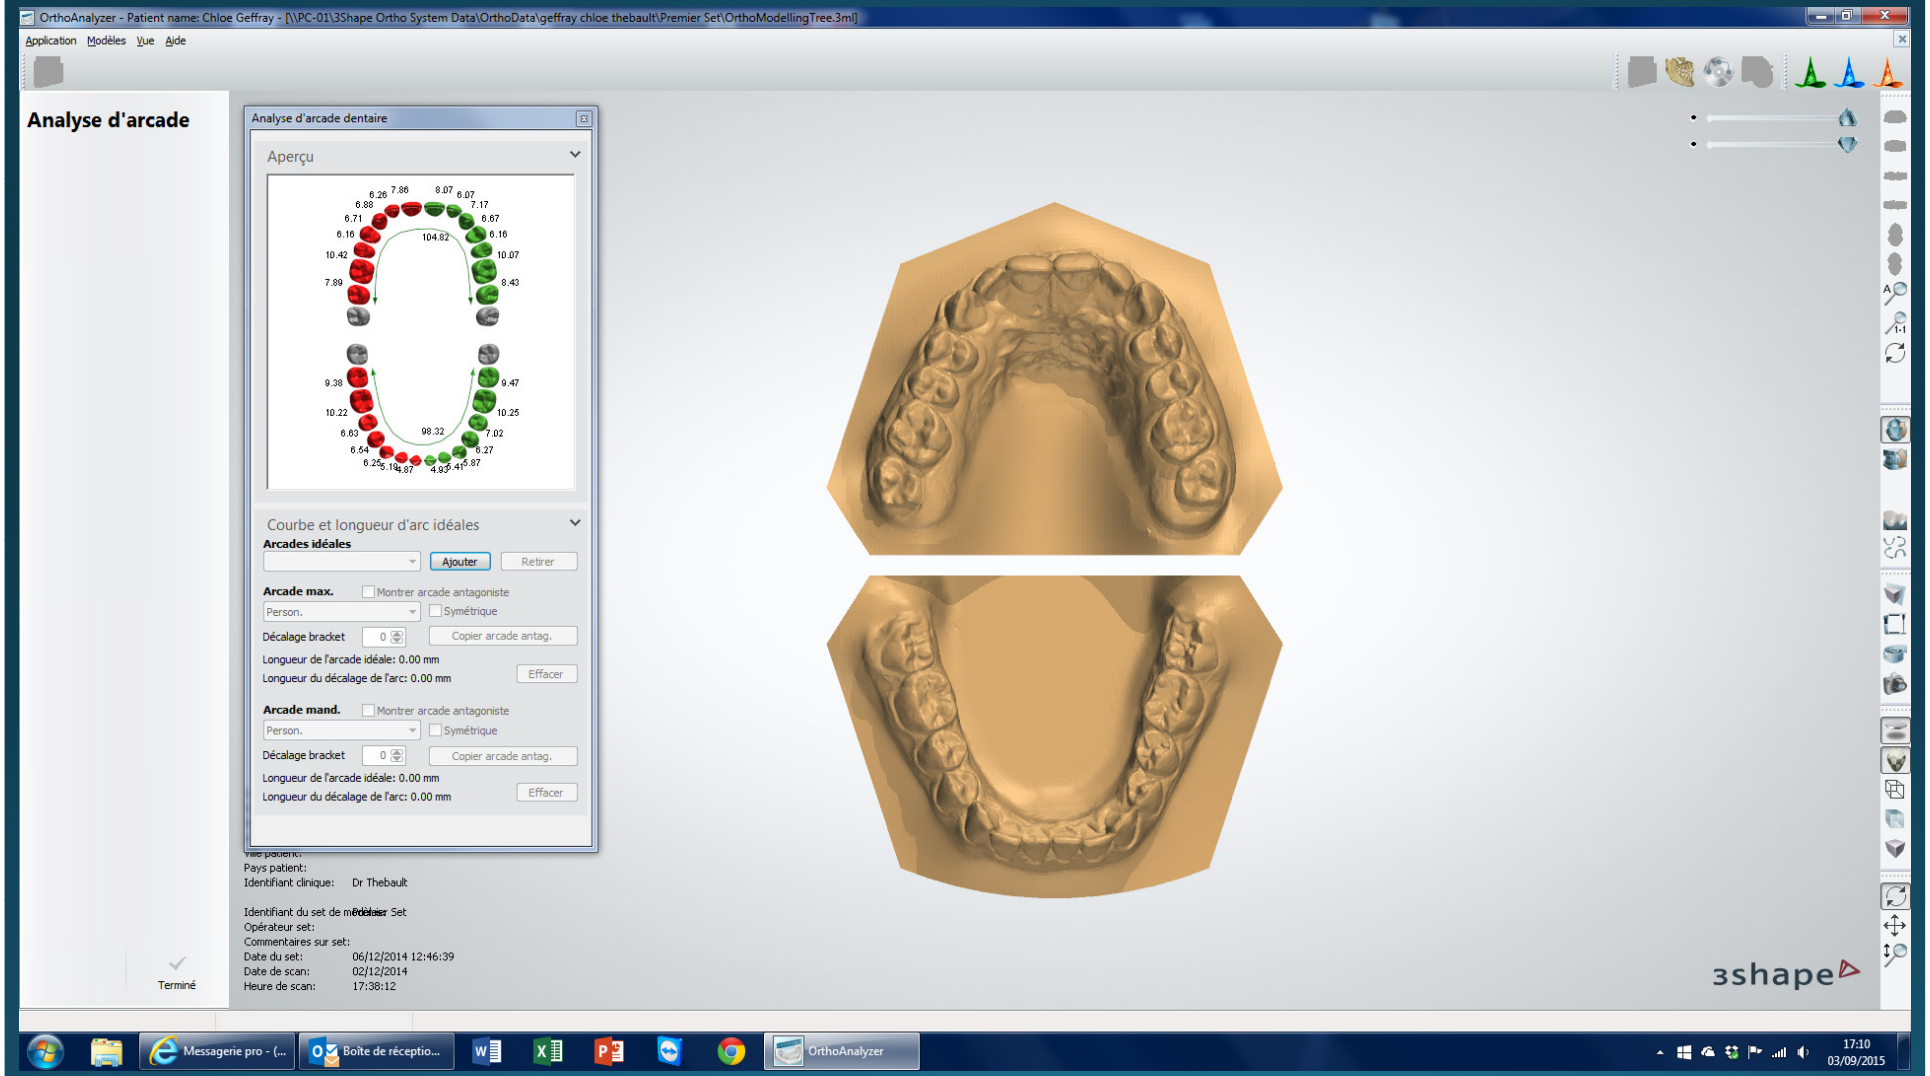
LE SET UP NUMERIQUE

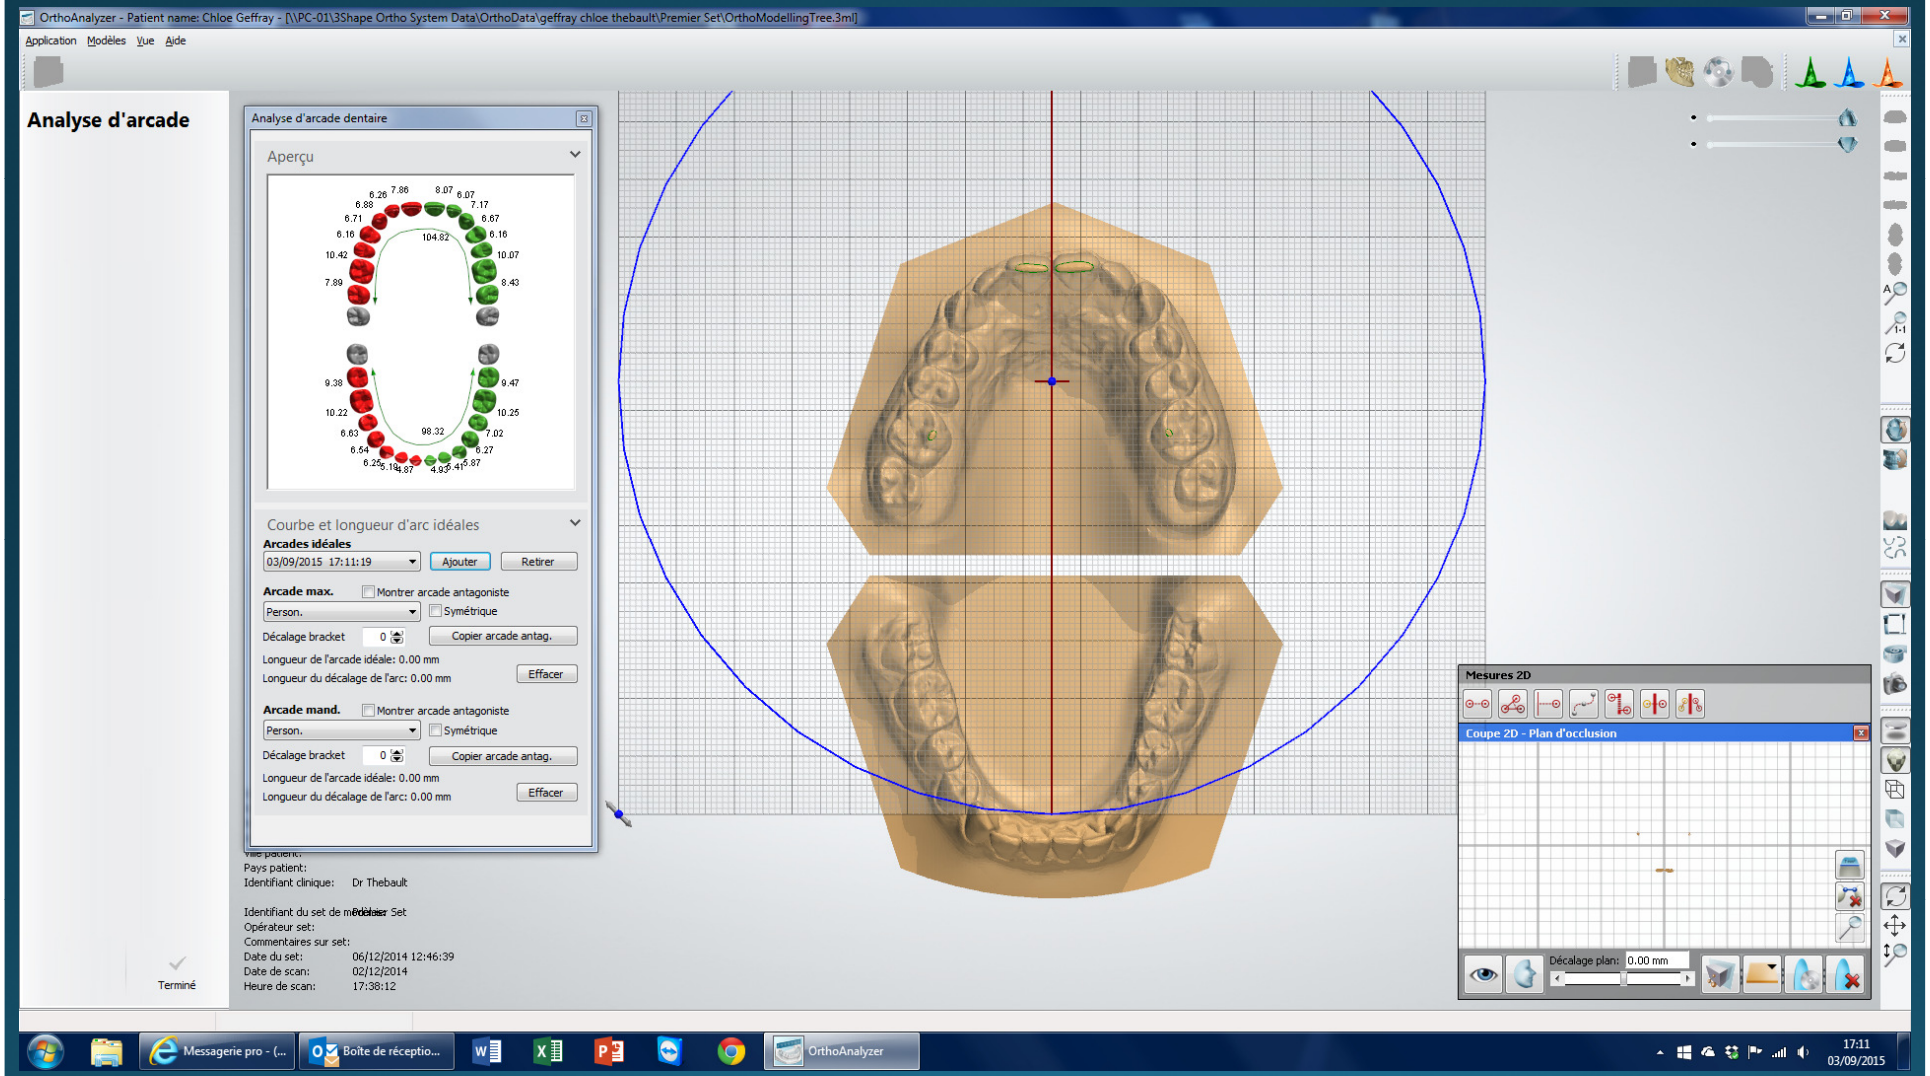
UNE EVOLUTION IMPORTANTE DANS NOTRE QUOTIDIEN
FIABILITE,
REPRODUCTIBILITE,
COLLABORATION ORTHESISTE/ORTHODONTISTE

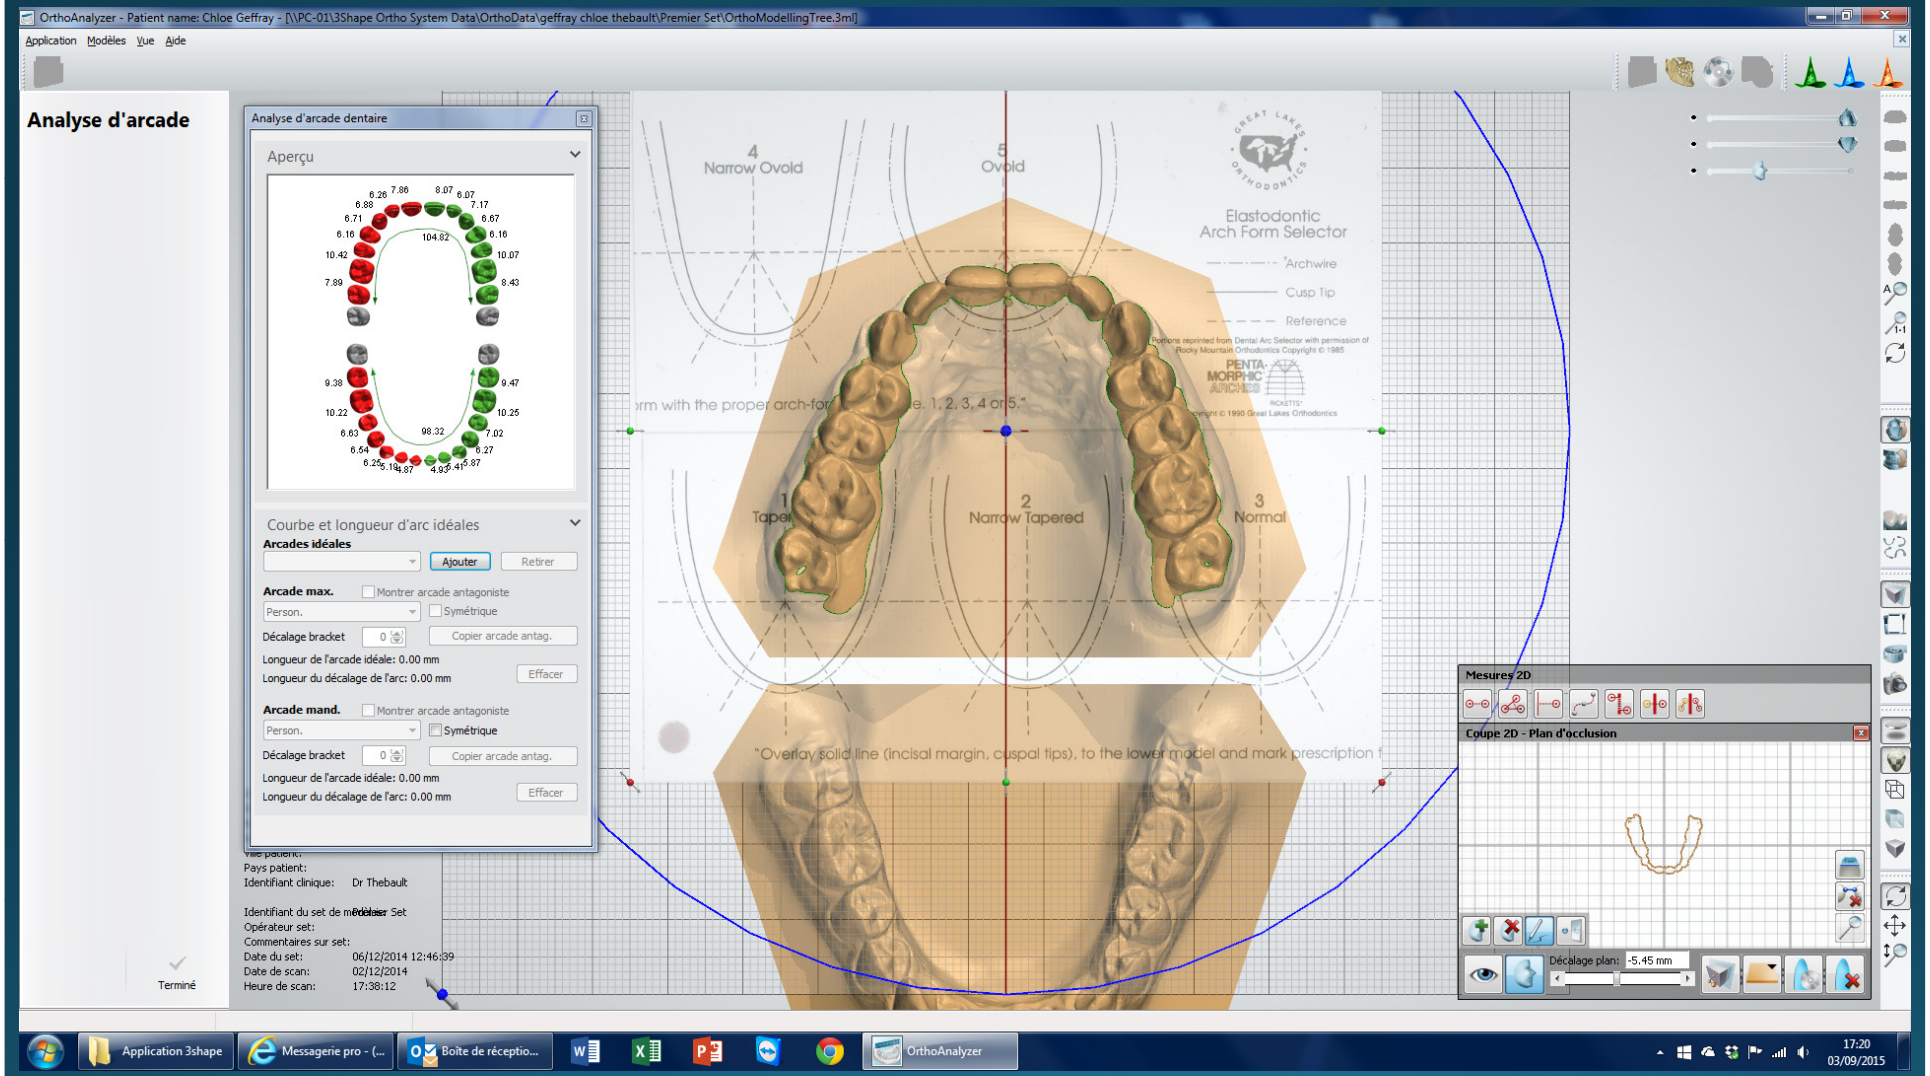
LA SOLUTION GLOBALE 3D

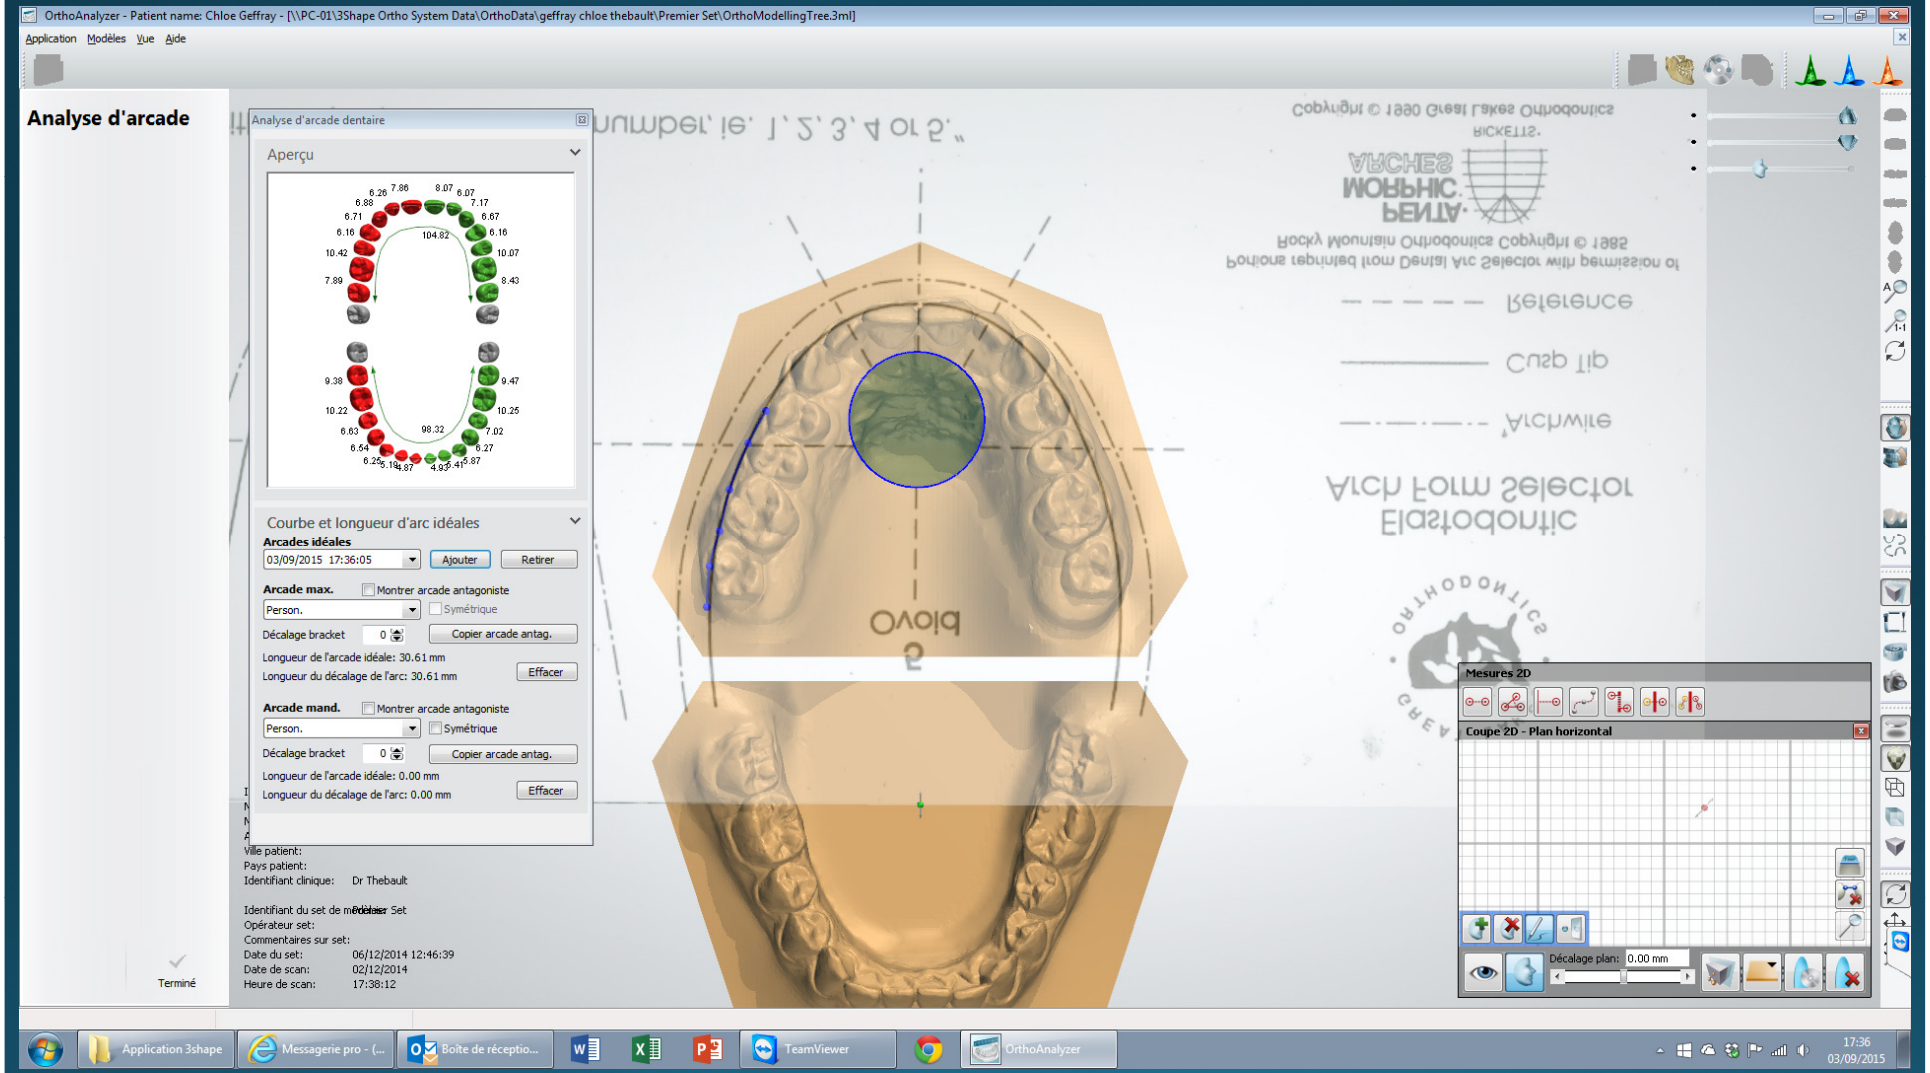

OrthoAnalyzer - Patient name: Chloe Geffray - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\geffray chloe thebault\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Préparation pour modèle maxillaire
Placer points
Définir coupe
Aperçu
Toolkit for 12
Éditer spline de découpe
Ajuster le spline ou le recréer manuellement
Dent active: 12
Add stubs
Edition rap
Move close points synchronously
Smooth teeth sides
Low
Suivant
Terminé
Identifiant patient: geffray chloe thebault
Nom du patient: Chloe Geffray
Identifiant clinique: Dr Thebault
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:02:21
Date de scan: 02/12/2014
Heure de scan: 17:38:12
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:36

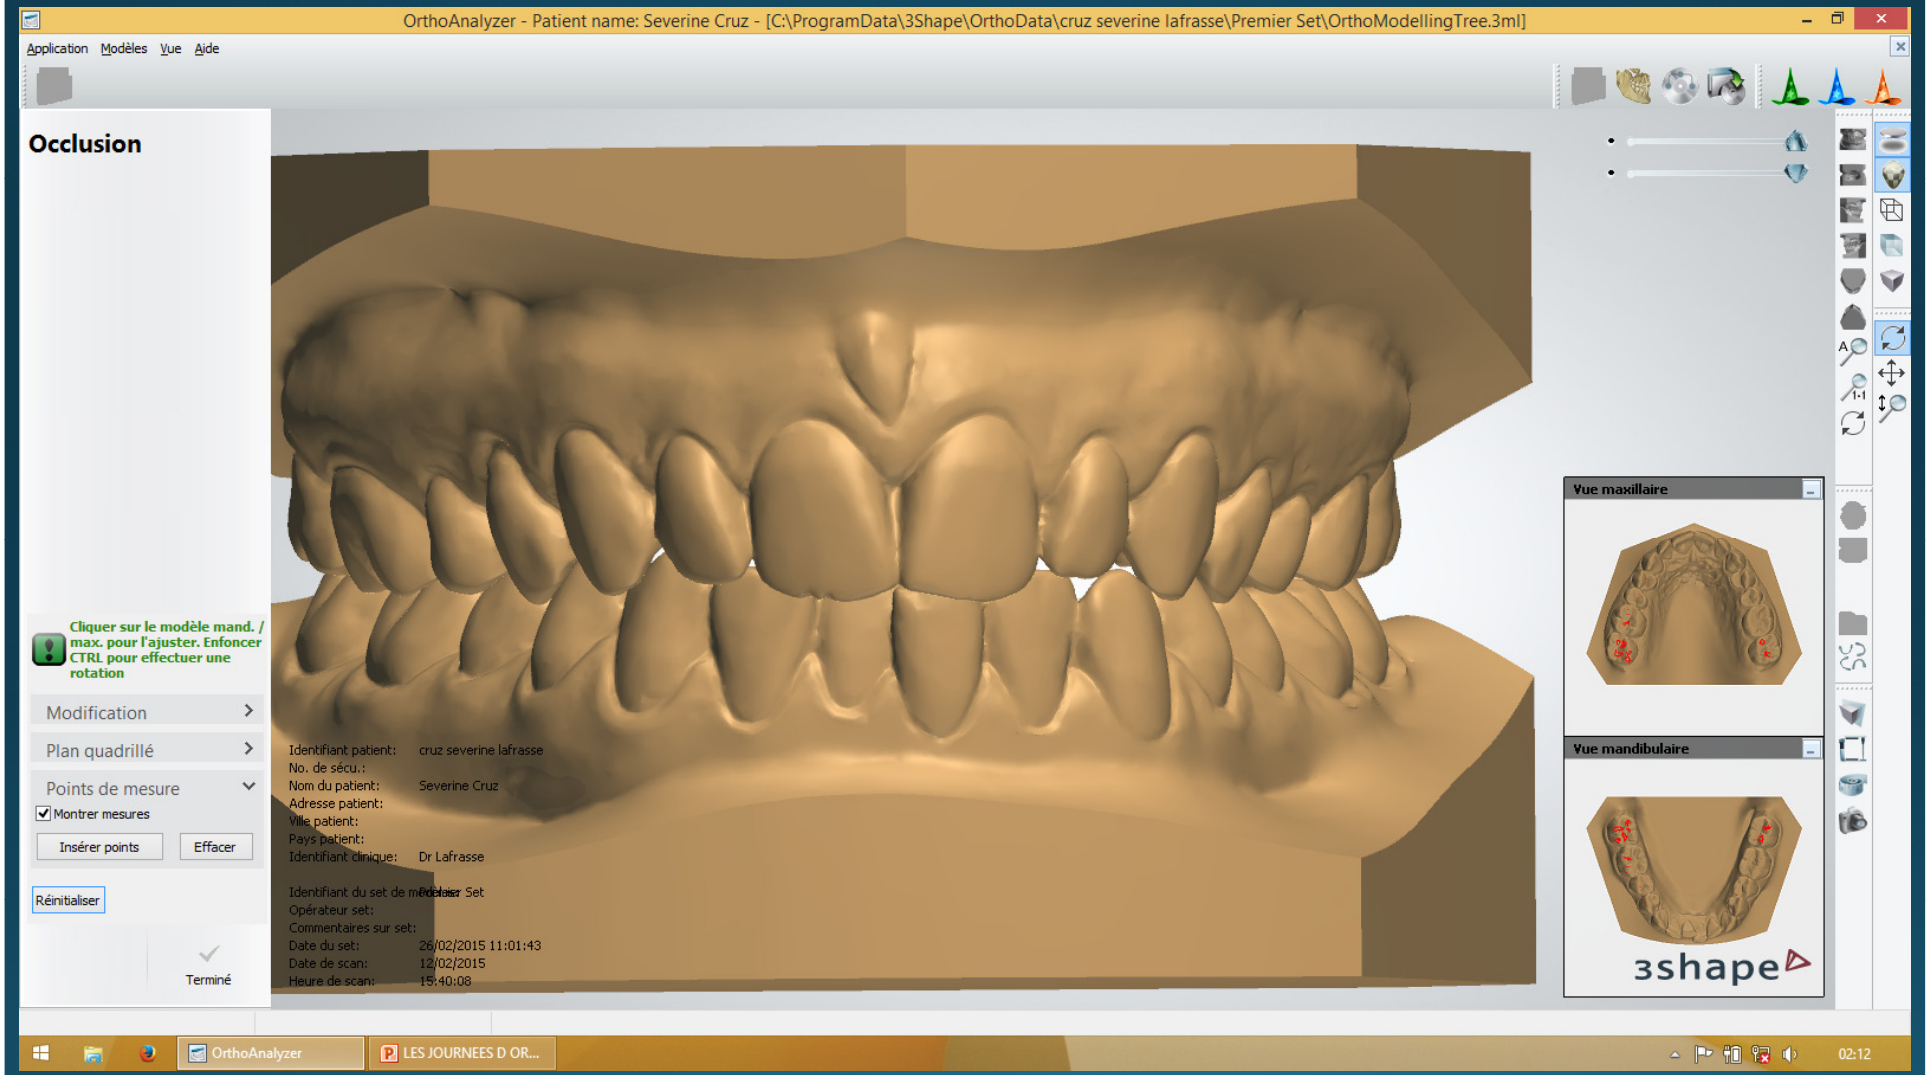

OrthoAnalyzer - Patient name: Chloe Geffray - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\geffray chloe thebault\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Préparation pour modèle mandibulaire
Placer points
Aperçu
Toolkit for 41
Éditer spline de découpe
Ajuster le spline ou le recréer manuellement
Dent active: 41
Add stubs
Edition rap
Move close points synchronously
Smooth teeth sides
Low
Suivant
Terminé
Identifiant patient: geffray chloe thebault
No. de sécu.:
Nom du patient: Chloe Geffray
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Thebault
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:02:21
Date de scan: 02/12/2014
Heure de scan: 17:38:12
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:38

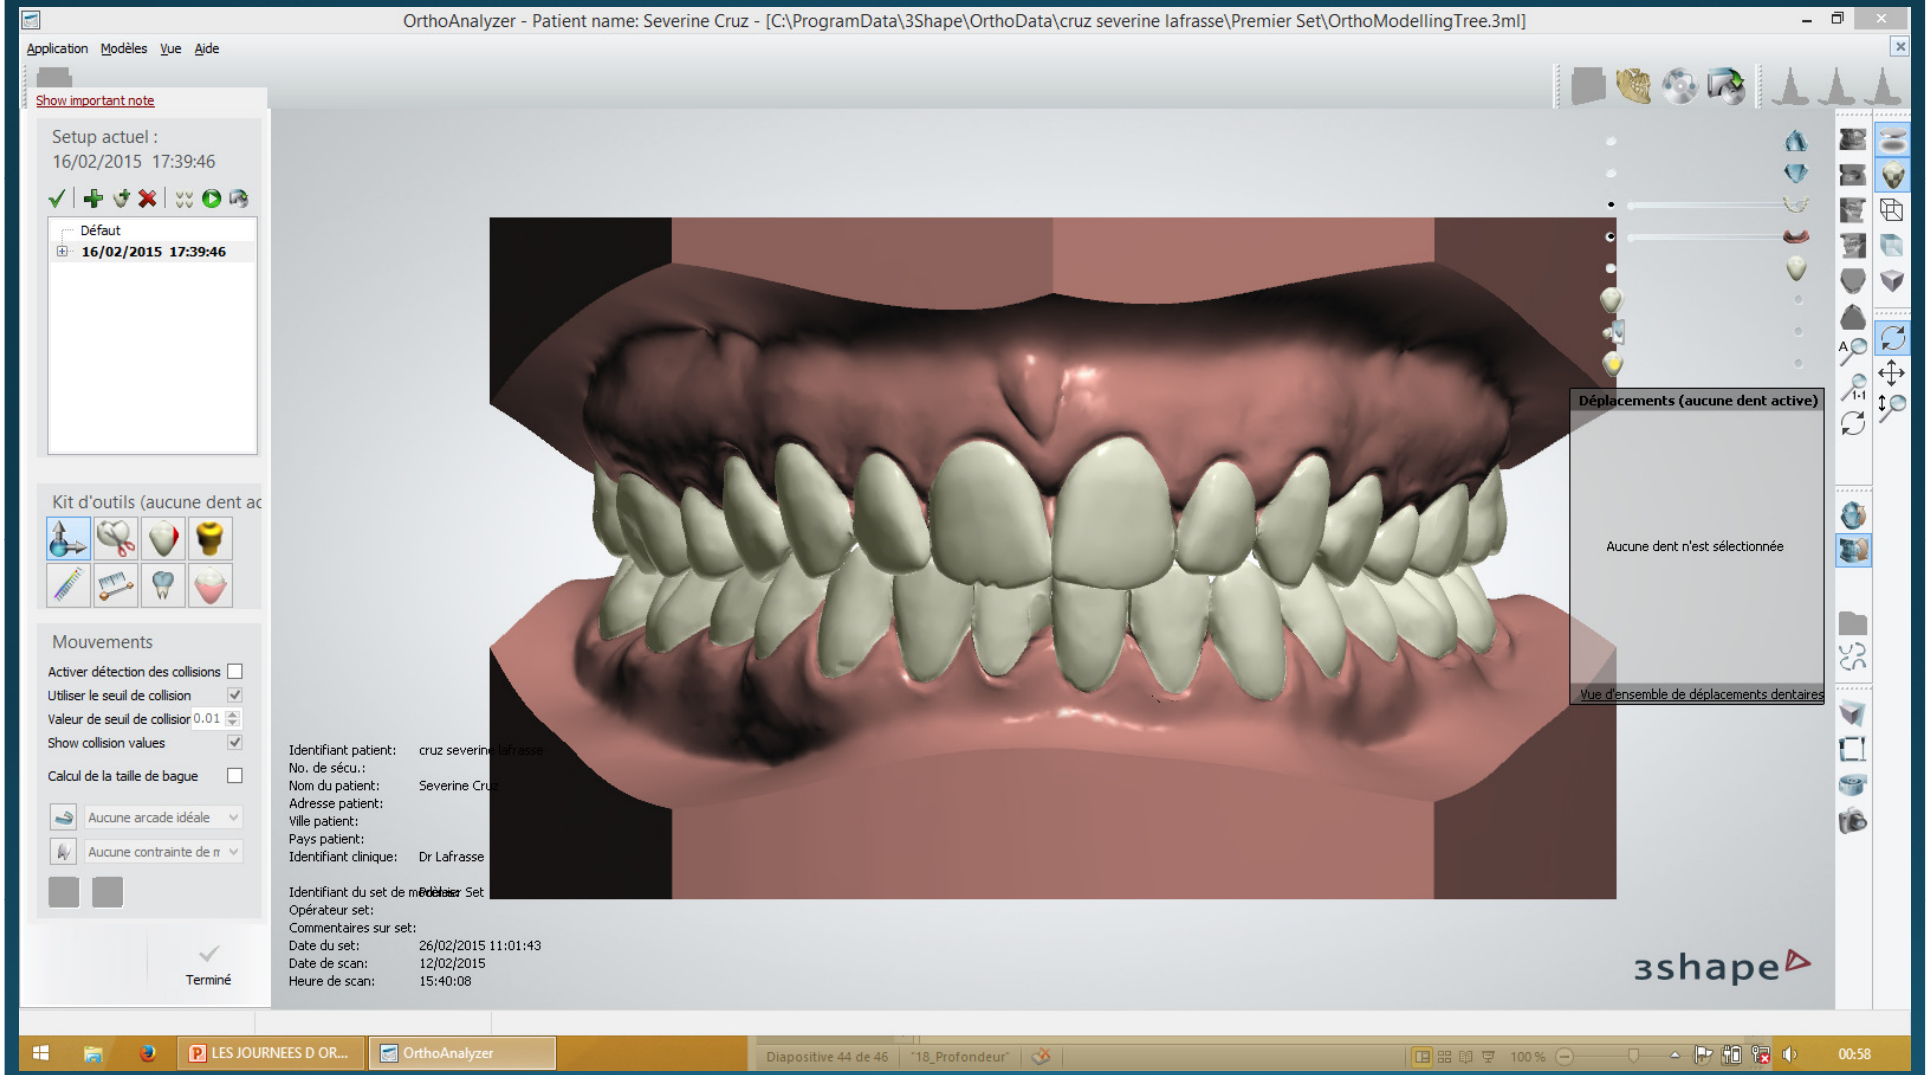

OrthoAnalyzer - Patient name: Chloe Geffray - [\\PC-01\3Shape Ortho System Data\OrthoData\geffray chloe thebault\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Analyse d'arcade
Analyse d'arcade dentaire
Aperçu
104.82
98.32
Courbe et longueur d'arc idéales
Arcades idéales
Ajouter
Retirer
Arcade max.
Montrer arcade antagoniste
Person.
Symétrique
Décalage bracket
Copier arcade antag.
Longueur de l'arcade idéale: 0.00 mm
Longueur du décalage de l'arc: 0.00 mm
Effacer
Arcade mand.
Identifiant clinique: Dr Thebault
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 06/12/2014 12:46:39
Date de scan: 02/12/2014
Heure de scan: 17:38:12
Terminé
3shape
OrthoAnalyzer
17:10
03/09/2015

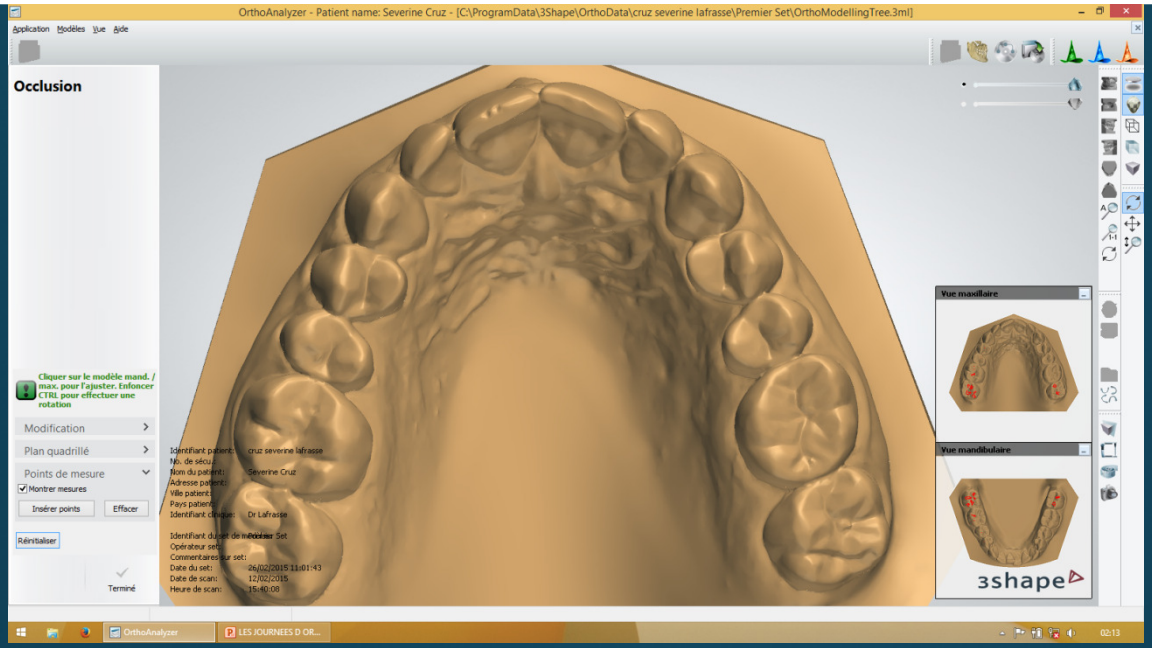

OrthoAnalyzer - Patient name: Chloe Geffray - [\\PC-01\3Shape Ortho System Data\OrthoData\geffray chloe thebault\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Analyse d'arcade
Analyse d'arcade dentaire
Aperçu
Courbe et longueur d'arc idéales
Arcades idéales
03/09/2015 17:11:19
Ajouter
Retirer
Arcade max.
Montrer arcade antagoniste
Person.
Symétrique
Décalage bracket
Copier arcade antag.
Longueur de l'arcade idéale: 0.00 mm
Longueur du décalage de l'arc: 0.00 mm
Effacer
Arcade mand.
Montrer arcade antagoniste
Person.
Symétrique
Décalage bracket
Copier arcade antag.
Longueur de l'arcade idéale: 0.00 mm
Longueur du décalage de l'arc: 0.00 mm
Effacer
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Thebault
Identifiant du set de modèles: Set
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 06/12/2014 12:46:39
Date de scan: 02/12/2014
Heure de scan: 17:38:12
Terminé
Mesures 2D
Coupe 2D - Plan d'occlusion
Décalage plan: 0.00 mm
Messagerie pro - (...
Boîte de réceptio...
OrthoAnalyzer
17:11
03/09/2015

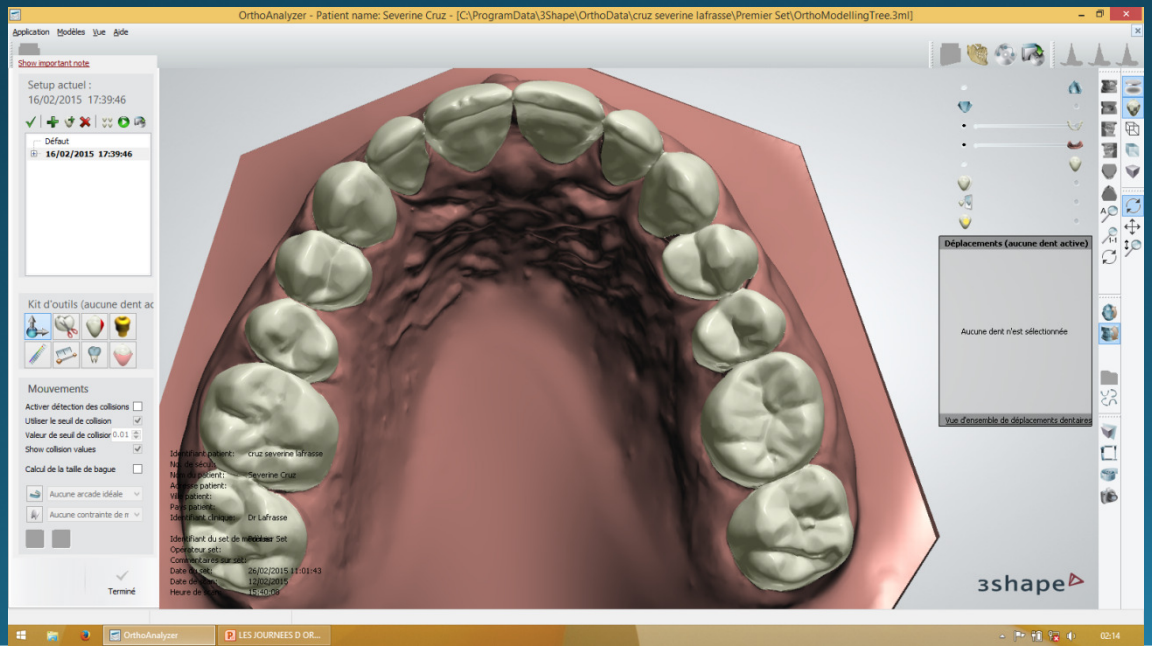

OrthoAnalyzer - Patient name: Chloe Geffray - [\\PC-01\3Shape Ortho System Data\OrthoData\geffray chloe thebault\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Analyse d'arcade
Analyse d'arcade dentaire
Aperçu
Courbe et longueur d'arc idéales
Arcades idéales
Ajouter
Retirer
Arcade max.
Montrer arcade antagoniste
Symétrique
Décalage bracket
Copier arcade antag.
Longueur de l'arcade idéale: 0.00 mm
Longueur du décalage de l'arc: 0.00 mm
Effacer
Arcade mand.
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Thebault
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 06/12/2014 12:46:39
Date de scan: 02/12/2014
Heure de scan: 17:38:12
Terminé
4 Narrow Ovoid
5 Ovoid
1 Tapered
2 Narrow Tapered
3 Normal
Elastodontic Arch Form Selector
Archwire
Cusp Tip
Reference
Overlay solid line (incisal margin, cuspal tips), to the lower model and mark prescription f
Mesures 2D
Coupe 2D - Plan d'occlusion
Décalage plan: -5.45 mm
Application 3shape
Messagerie pro - (...
Boîte de réceptio...
OrthoAnalyzer
17:20
03/09/2015

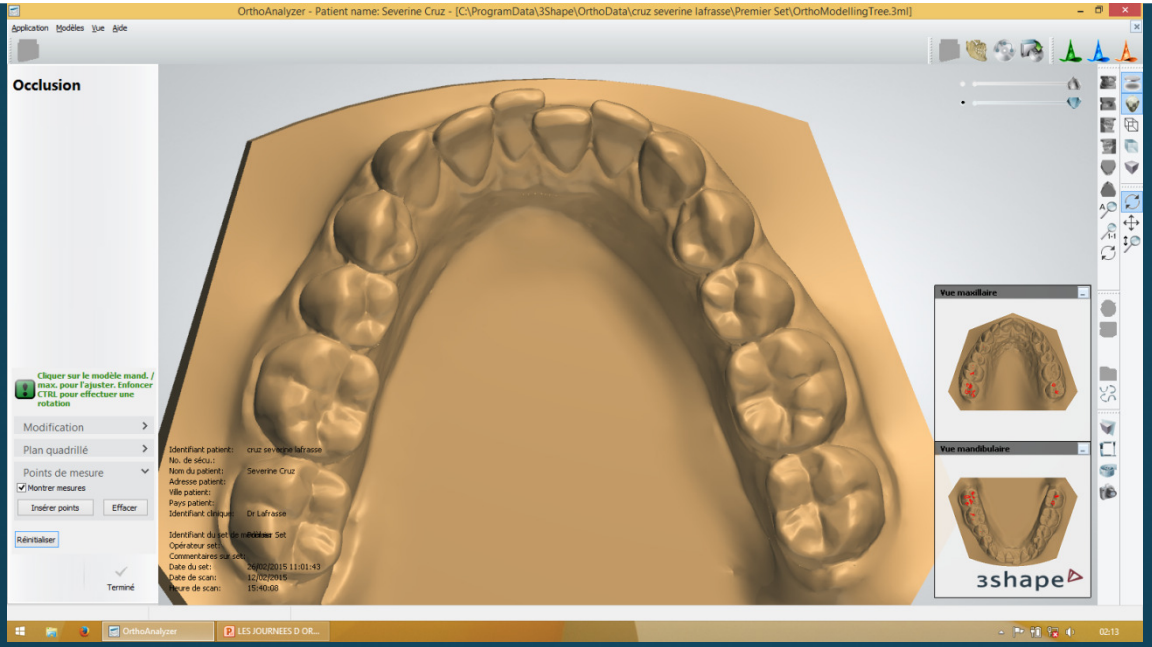

OrthoAnalyzer - Patient name: Chloe Geffray - [\\PC-01\3Shape Ortho System Data\OrthoData\geffray chloe thebault\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Analyse d'arcade
Analyse d'arcade dentaire
Aperçu
Courbe et longueur d'arc idéales
Arcades idéales
03/09/2015 17:36:05
Ajouter
Retirer
Arcade max.
Montrer arcade antagoniste
Person.
Symétrique
Décalage bracket
Copier arcade antag.
Longueur de l'arcade idéale: 30.61 mm
Longueur du décalage de l'arc: 30.61 mm
Effacer
Arcade mand.
Longueur de l'arcade idéale: 0.00 mm
Longueur du décalage de l'arc: 0.00 mm
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Thebault
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 06/12/2014 12:46:39
Date de scan: 02/12/2014
Heure de scan: 17:38:12
Terminé
Mesures 2D
Coupe 2D - Plan horizontal
Décalage plan: 0.00 mm
Application 3shape
Messagerie pro - (...
Boîte de réceptio...
TeamViewer
OrthoAnalyzer
17:36
03/09/2015

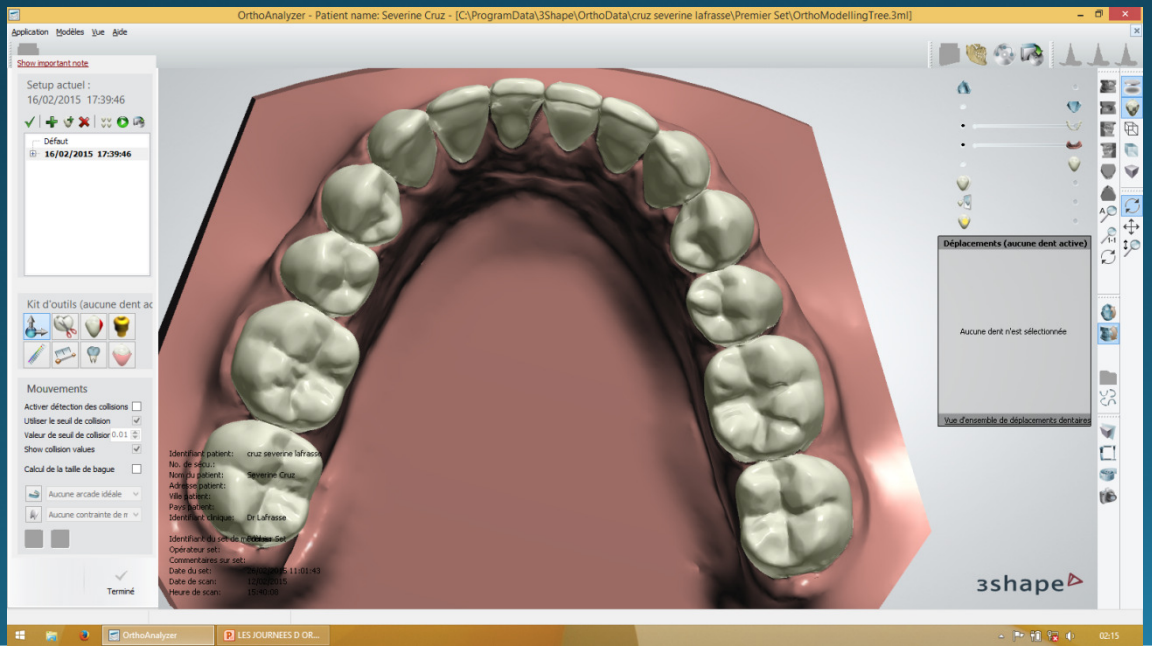

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cruz
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
Vue maxillaire
Vue mandibulaire
3shape
OrthoAnalyzer
LES JOURNEES D OR...
02:12

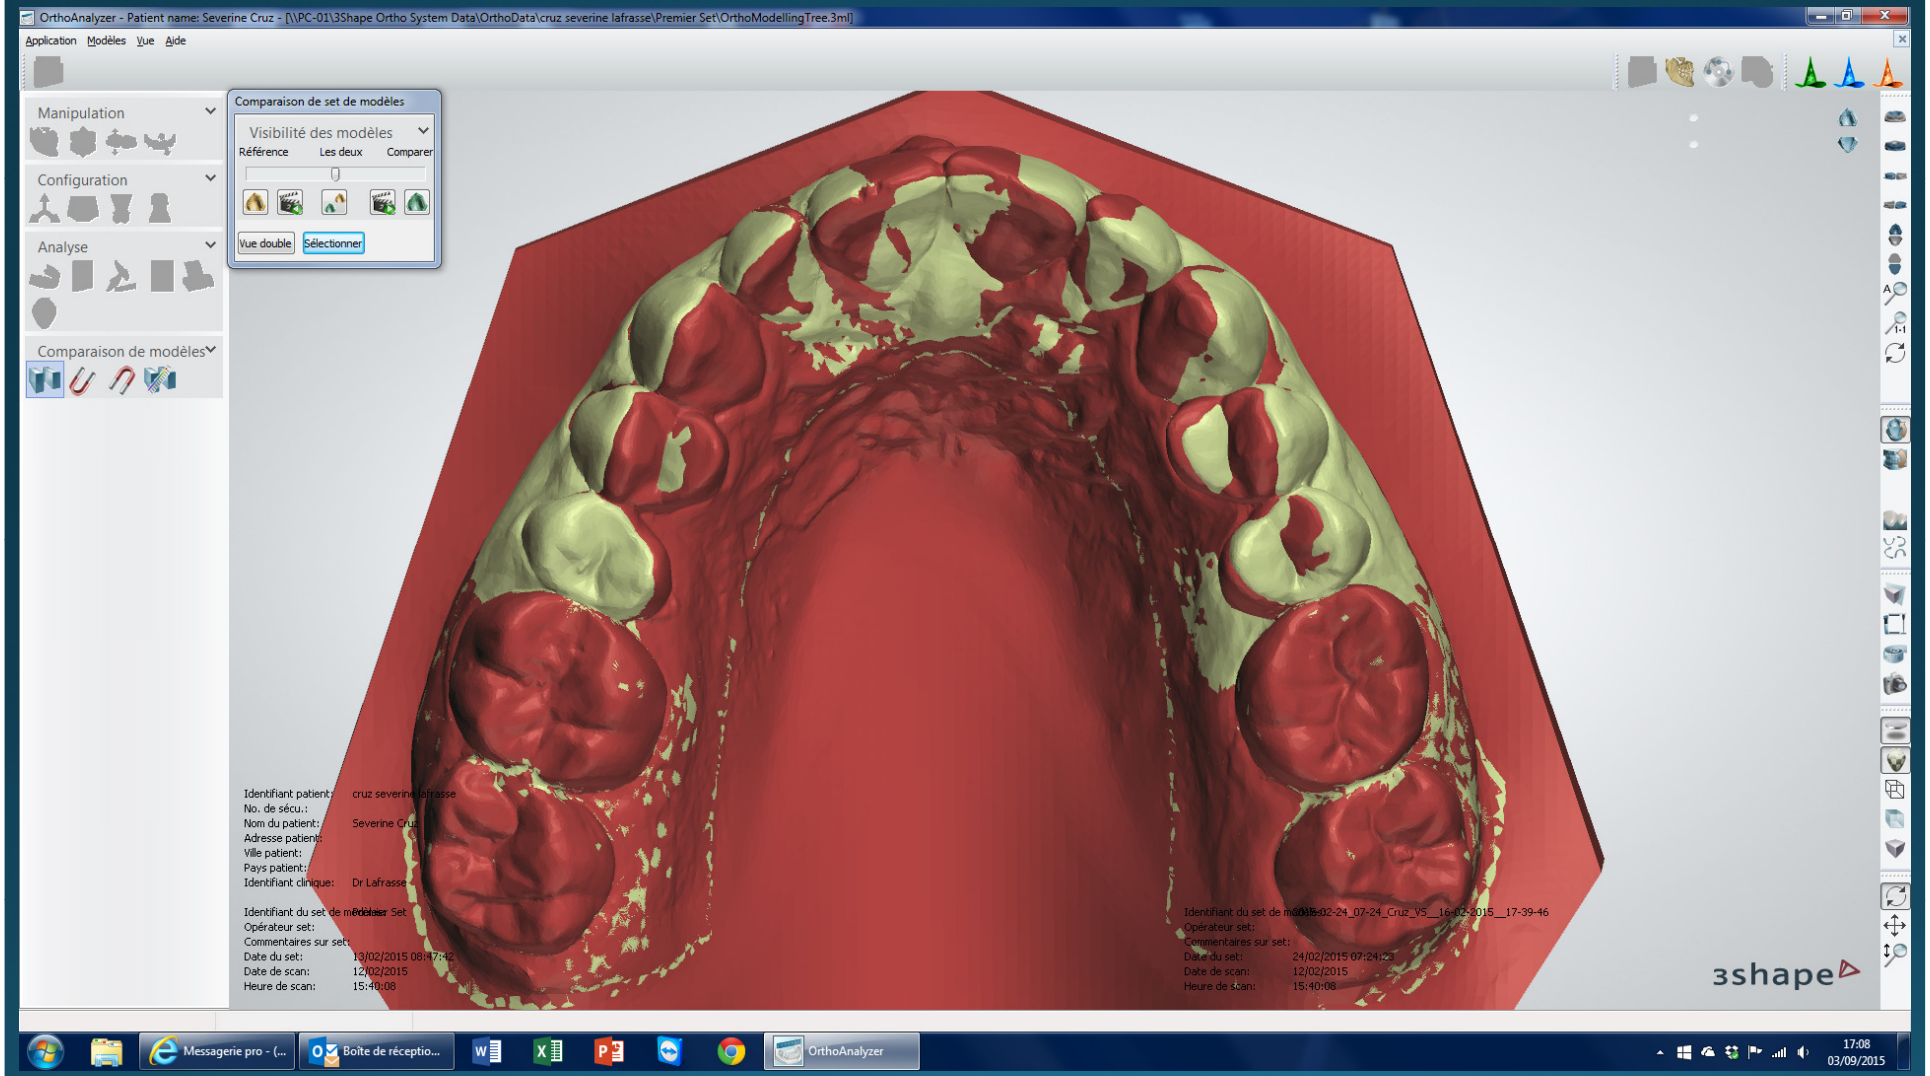

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cru
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Identifiant du set de modèles: Premier Set
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
Diapositive 44 de 46
'18_Profondeur'
100 %
00:58

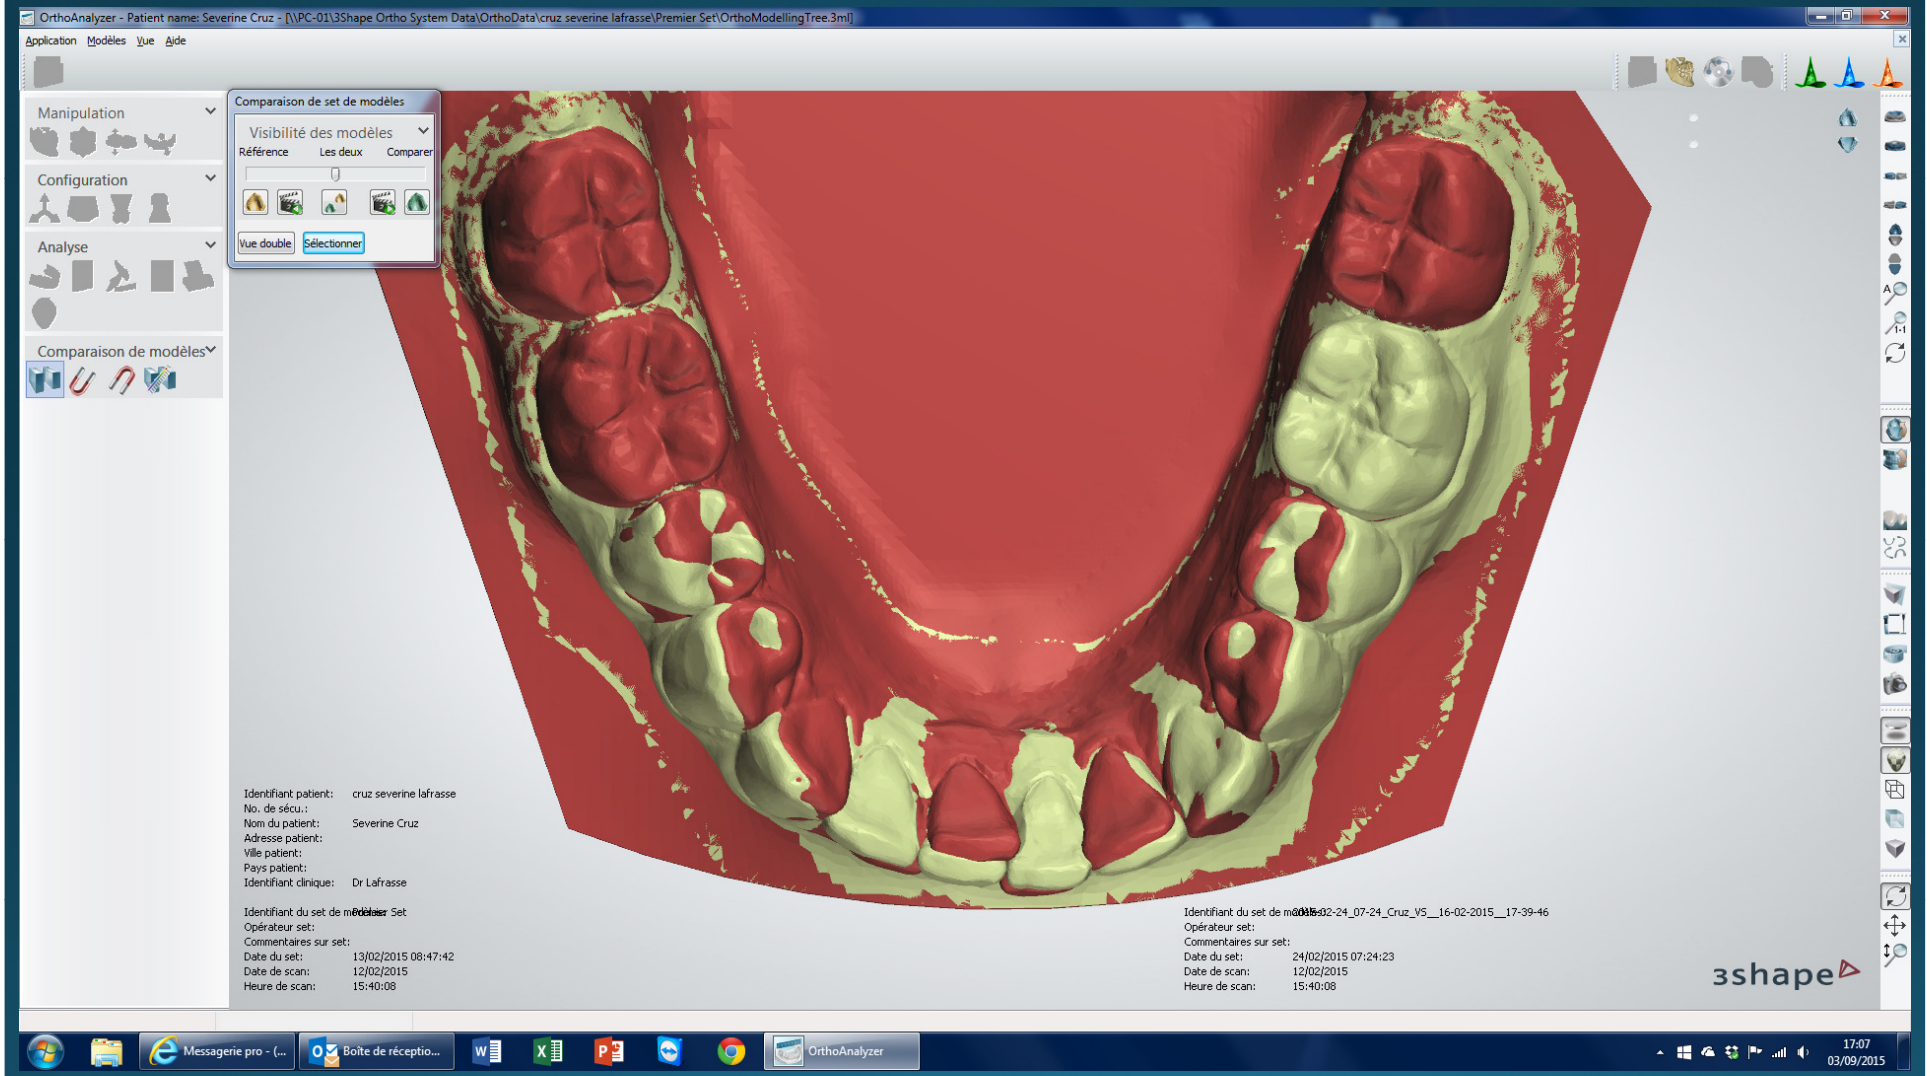

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Vue maxillaire
Vue mandibulaire
3shape

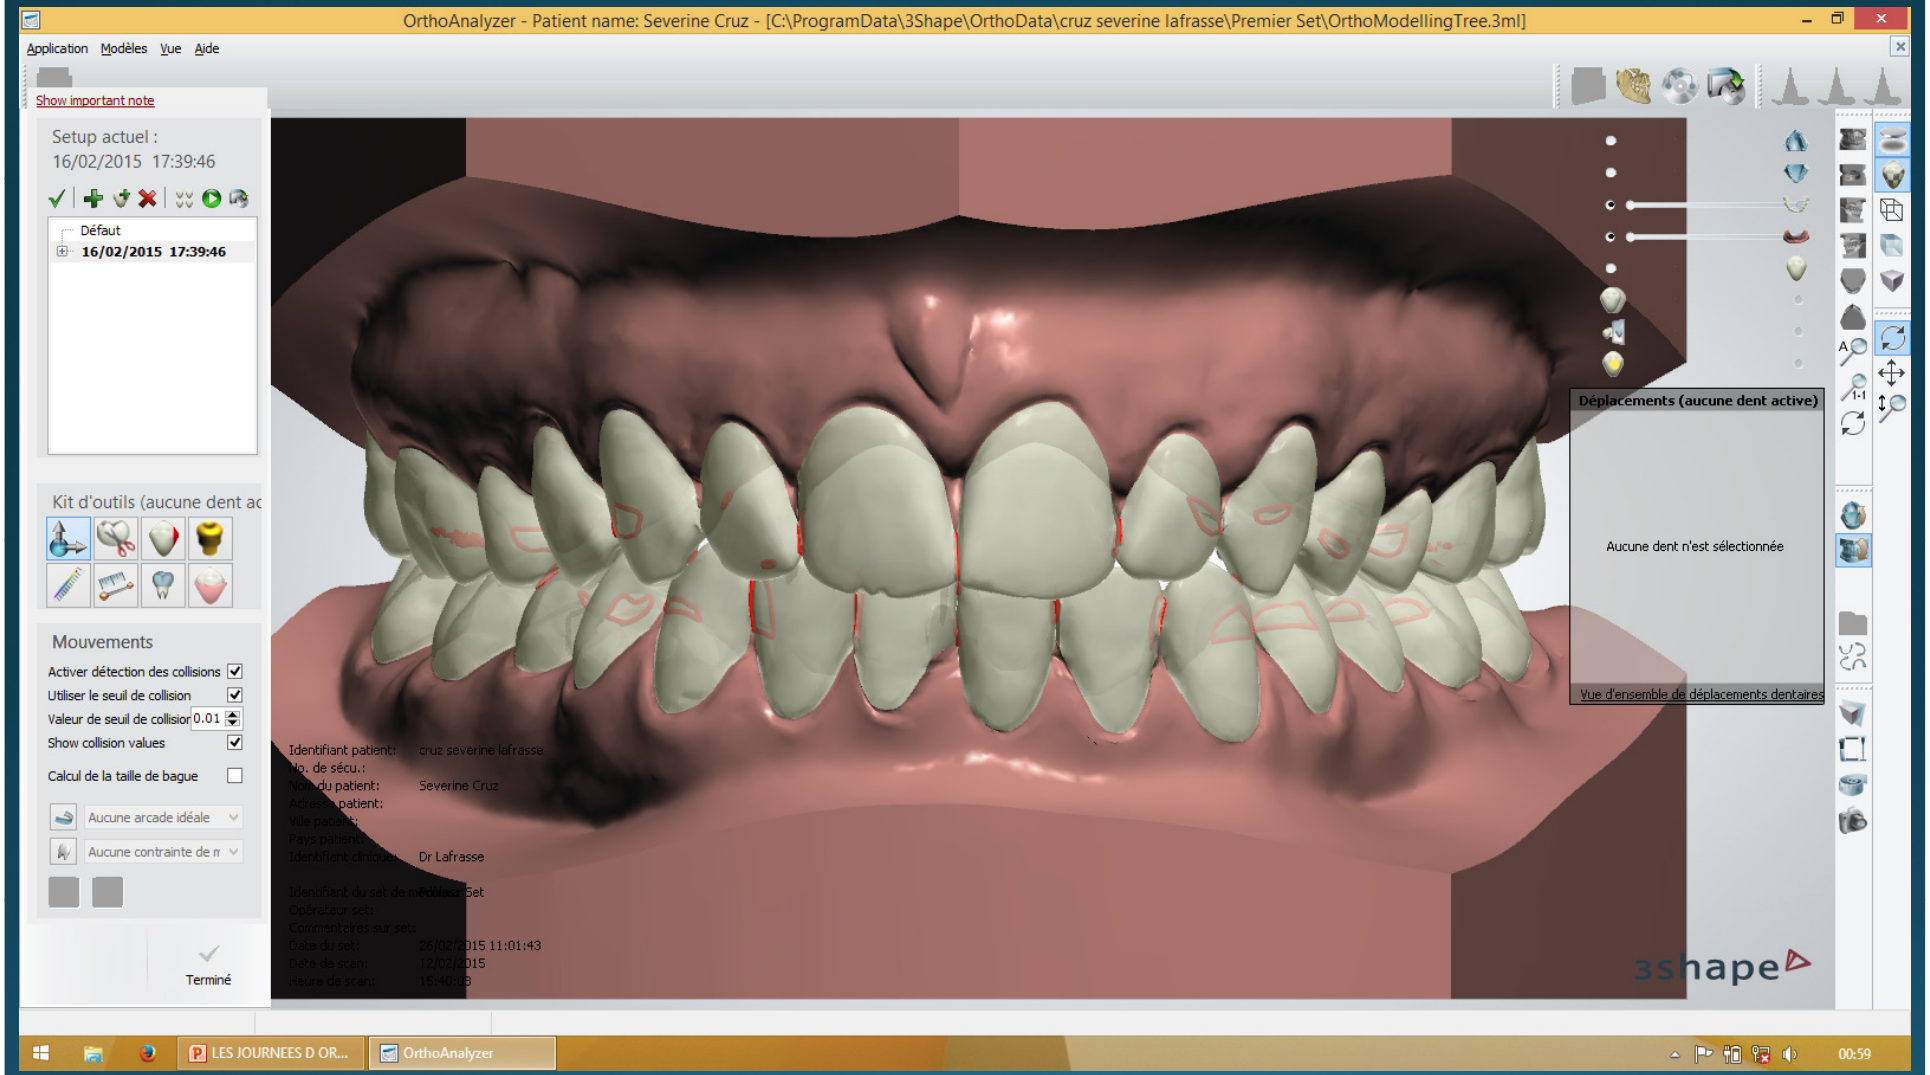

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
3shape

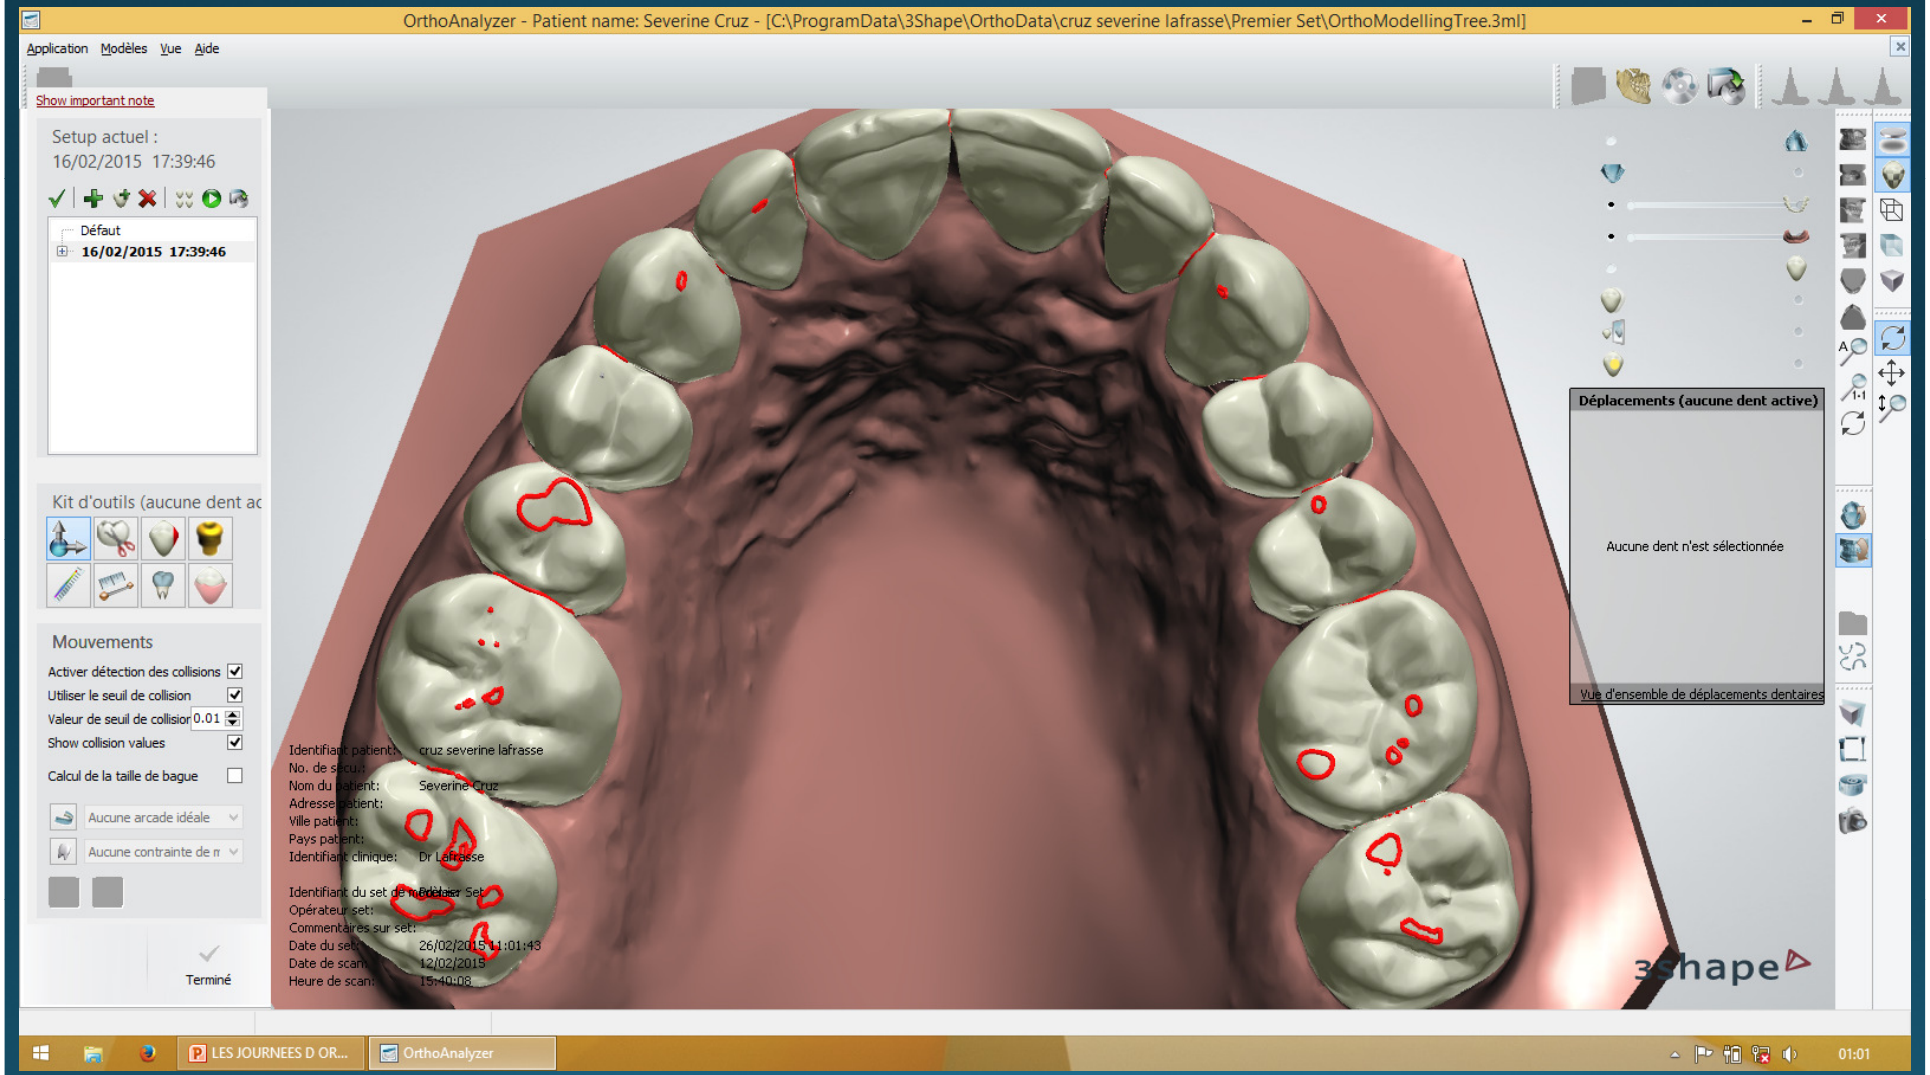

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Vue maxillaire
Vue mandibulaire
3shape

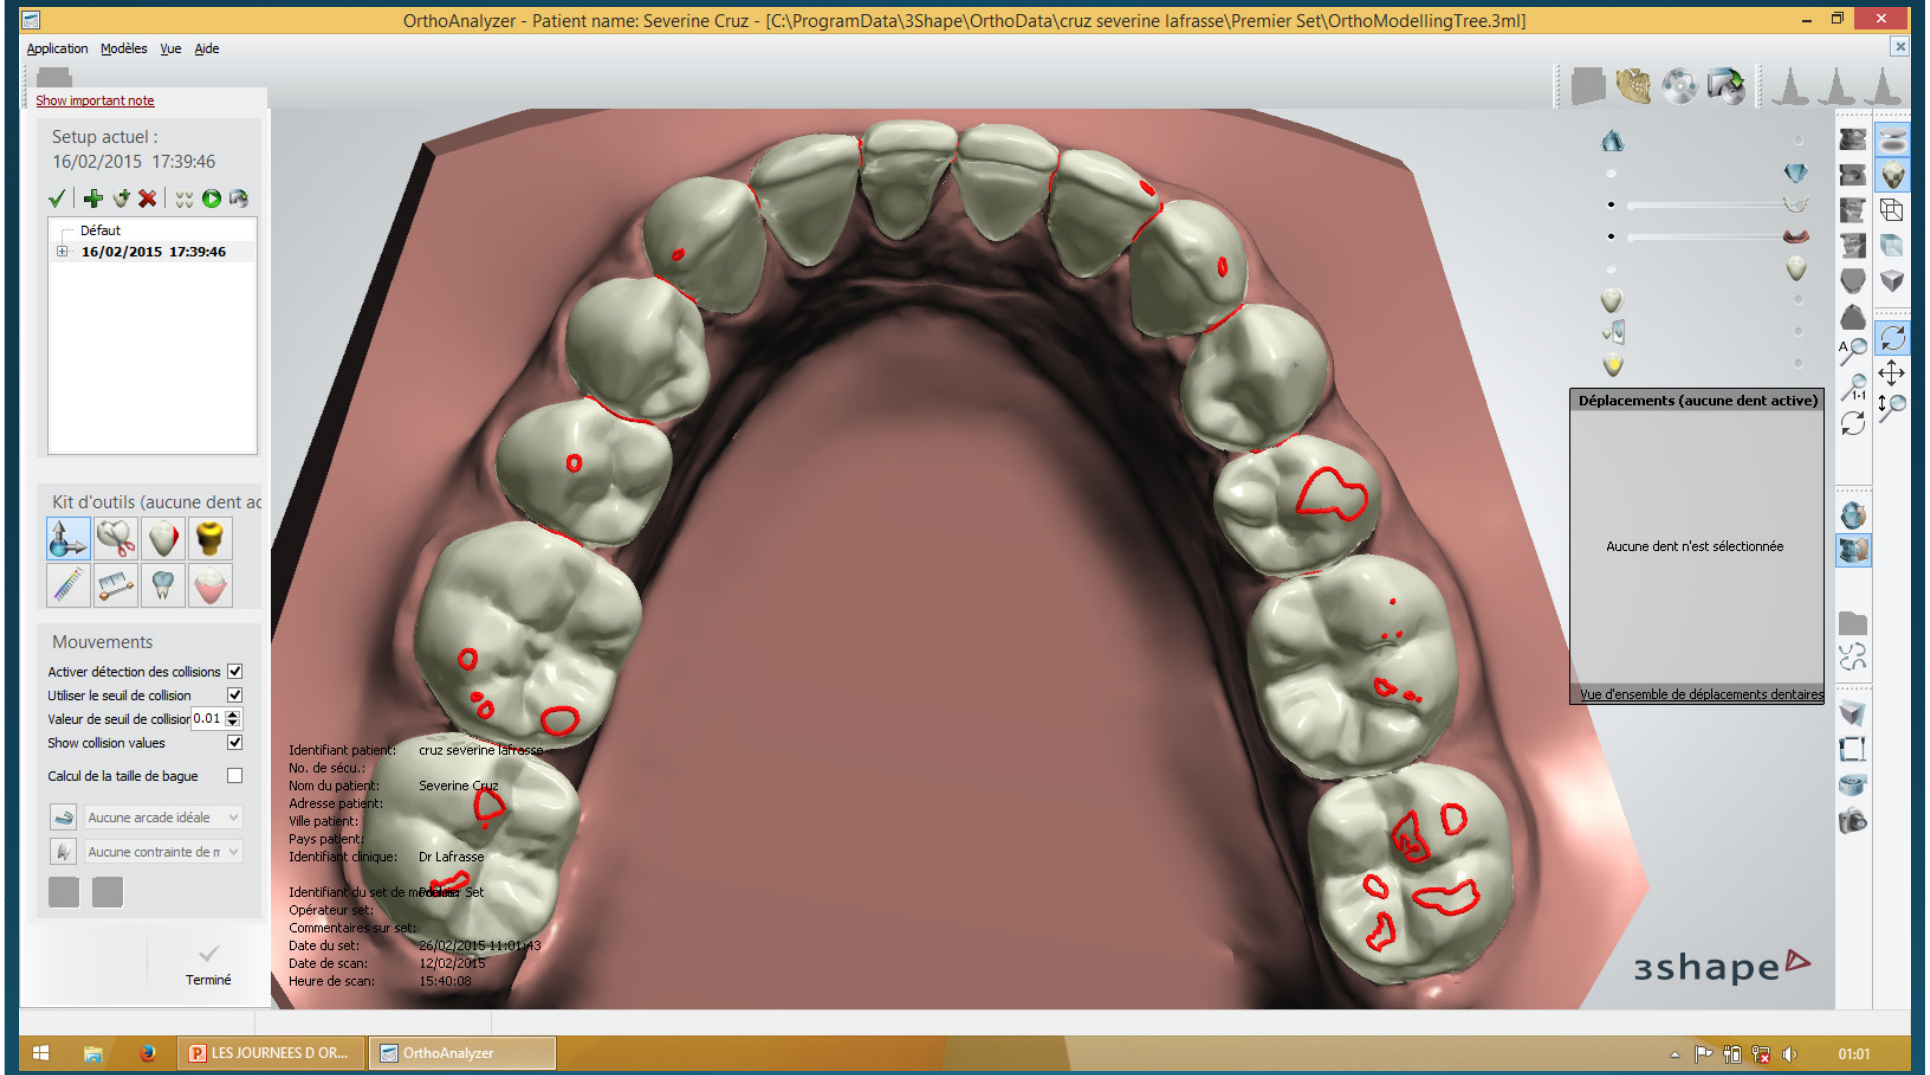

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
3shape

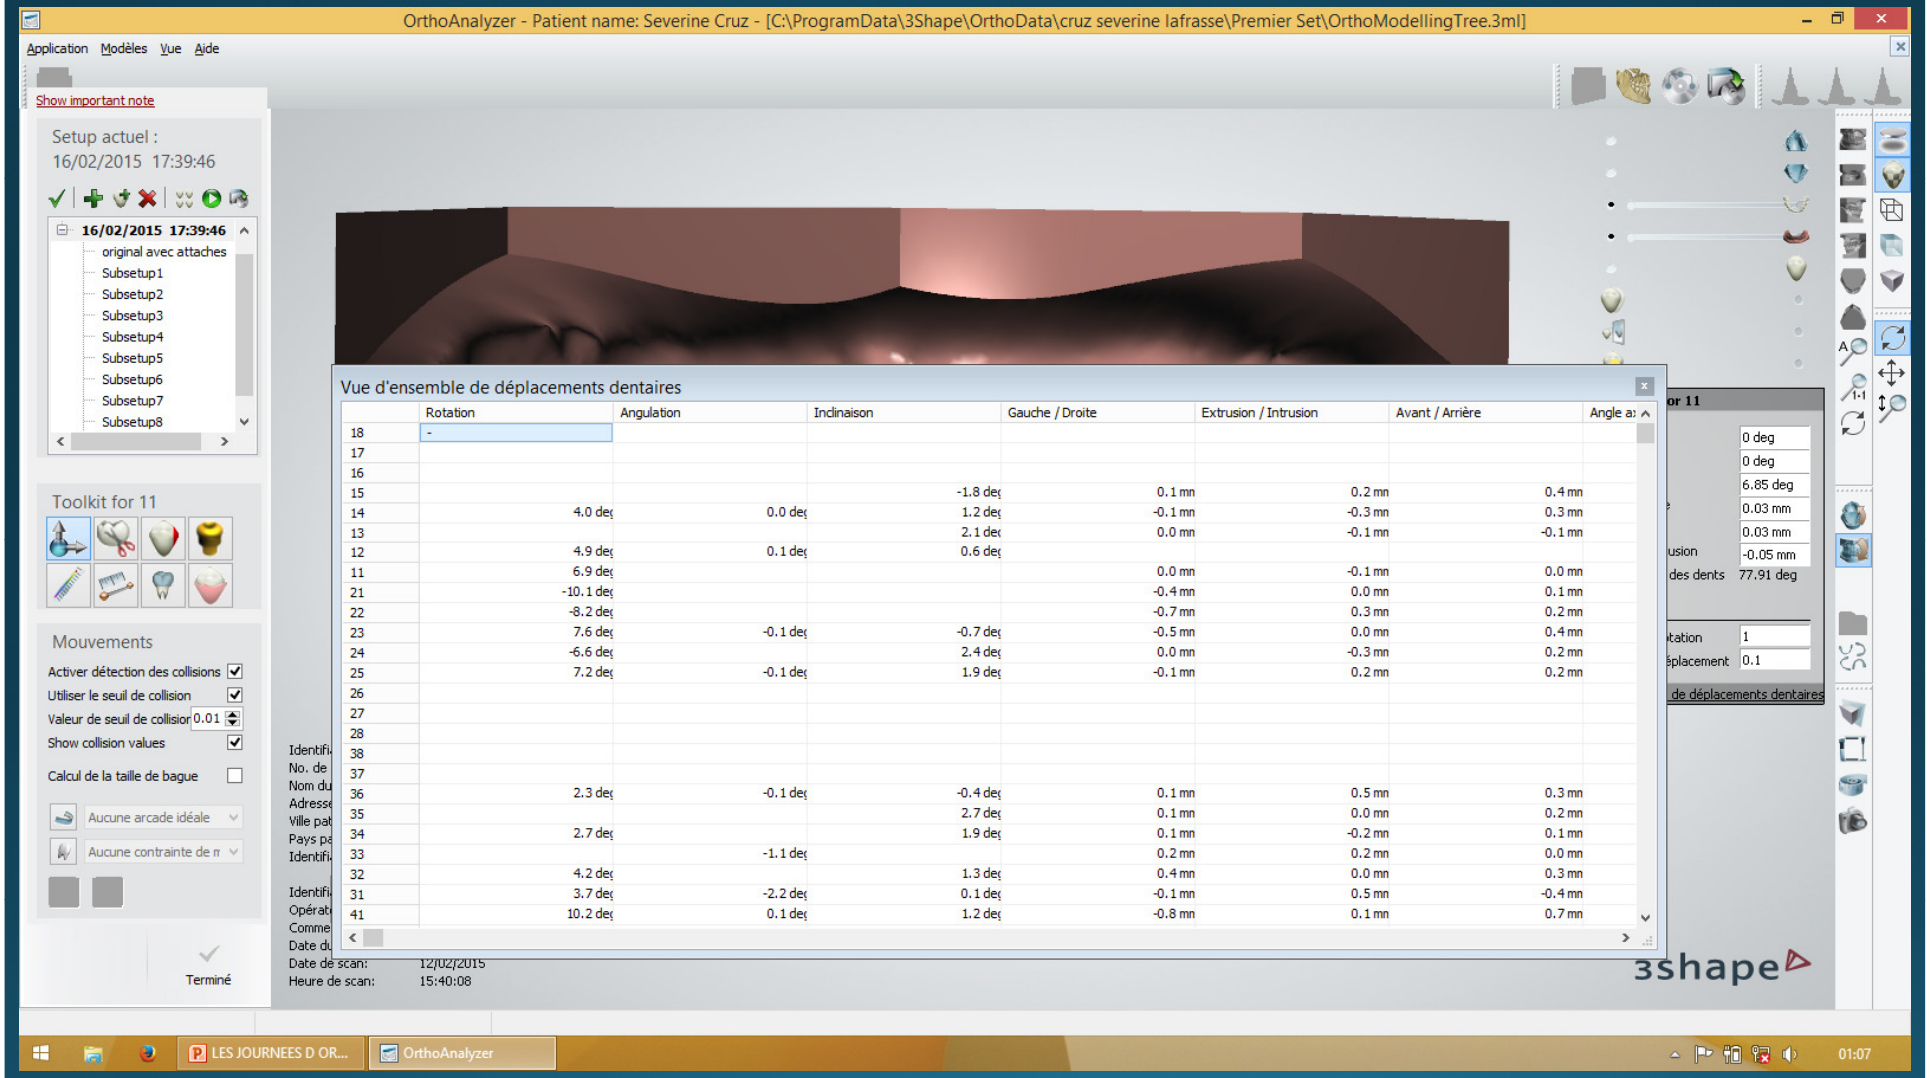

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [\\PC-01\3Shape Ortho System Data\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Manipulation
Configuration
Analyse
Comparaison de modèles
Comparaison de set de modèles
Visibilité des modèles
Référence
Les deux
Comparer
Vue double
Sélectionner
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cruz
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 13/02/2015 08:47:42
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/02/2015 07:24:23
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
Messagerie pro - (...
Boîte de réceptio...
OrthoAnalyzer
17:08
03/09/2015


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [\\PC-01\3Shape Ortho System Data\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Manipulation
Configuration
Analyse
Comparaison de modèles
Comparaison de set de modèles
Visibilité des modèles
Référence Les deux Comparer
Vue double Sélectionner
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cruz
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 13/02/2015 08:47:42
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/02/2015 07:24:23
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
Messagerie pro - (...
Boîte de réceptio...
OrthoAnalyzer
17:07
03/09/2015


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
Nom du patient: Severine Cruz
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
00:59


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
Nom du patient: Severine Cruz
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:01


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cruz
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:01


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
16/02/2015 17:39:46
original avec attaches
Subsetup1
Subsetup2
Subsetup3
Subsetup4
Subsetup5
Subsetup6
Subsetup7
Subsetup8
Toolkit for 11
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de m
Terminé
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Rotation
Angulation
Inclinaison
Gauche / Droite
Extrusion / Intrusion
Avant / Arrière
Angle a:
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:07

REALISATION DU SET UP AU LABORATOIRE SUIVANT LES INDICATIONS DU PRATICIEN

REALISATION DU SET UP AU LABORATOIRE SUIVANT LES INDICATIONS DU PRATICIEN

COMMUNICATION DU SET UP AVEC DEUX POSSIBILITES:

- SI LE CABINET POSSEDE LE LOGICIEL, INTEGRATION DU DOSSIER COMPLET DANS ORTHOANALYZER
- AU CAS ECHEANT, VISUALISATION AVEC ORTHOVIEWER ET TABLEAU DE RAPPORT

REALISATION DU SET UP AU LABORATOIRE SUIVANT LES INDICATIONS DU PRATICIEN

COMMUNICATION DU SET UP AVEC DEUX POSSIBILITES:

- SI LE CABINET POSSEDE LE LOGICIEL, INTEGRATION DU DOSSIER COMPLET DANS ORTHOANALYZER
- AU CAS ECHEANT, VISUALISATION AVEC ORTHOVIEWER ET TABLEAU DE RAPPORT

VALIDATION DU SET UP PAR LE PRATICIEN OU MODIFICATIONS EVENTUELLES

LE SET UP NUMERIQUE
et ses applications

LA SOLUTION GLOBALE 3D

LE SET UP NUMERIQUE
et ses applications

plan de traitement

LA SOLUTION GLOBALE 3D

LE SET UP NUMERIQUE
et ses applications

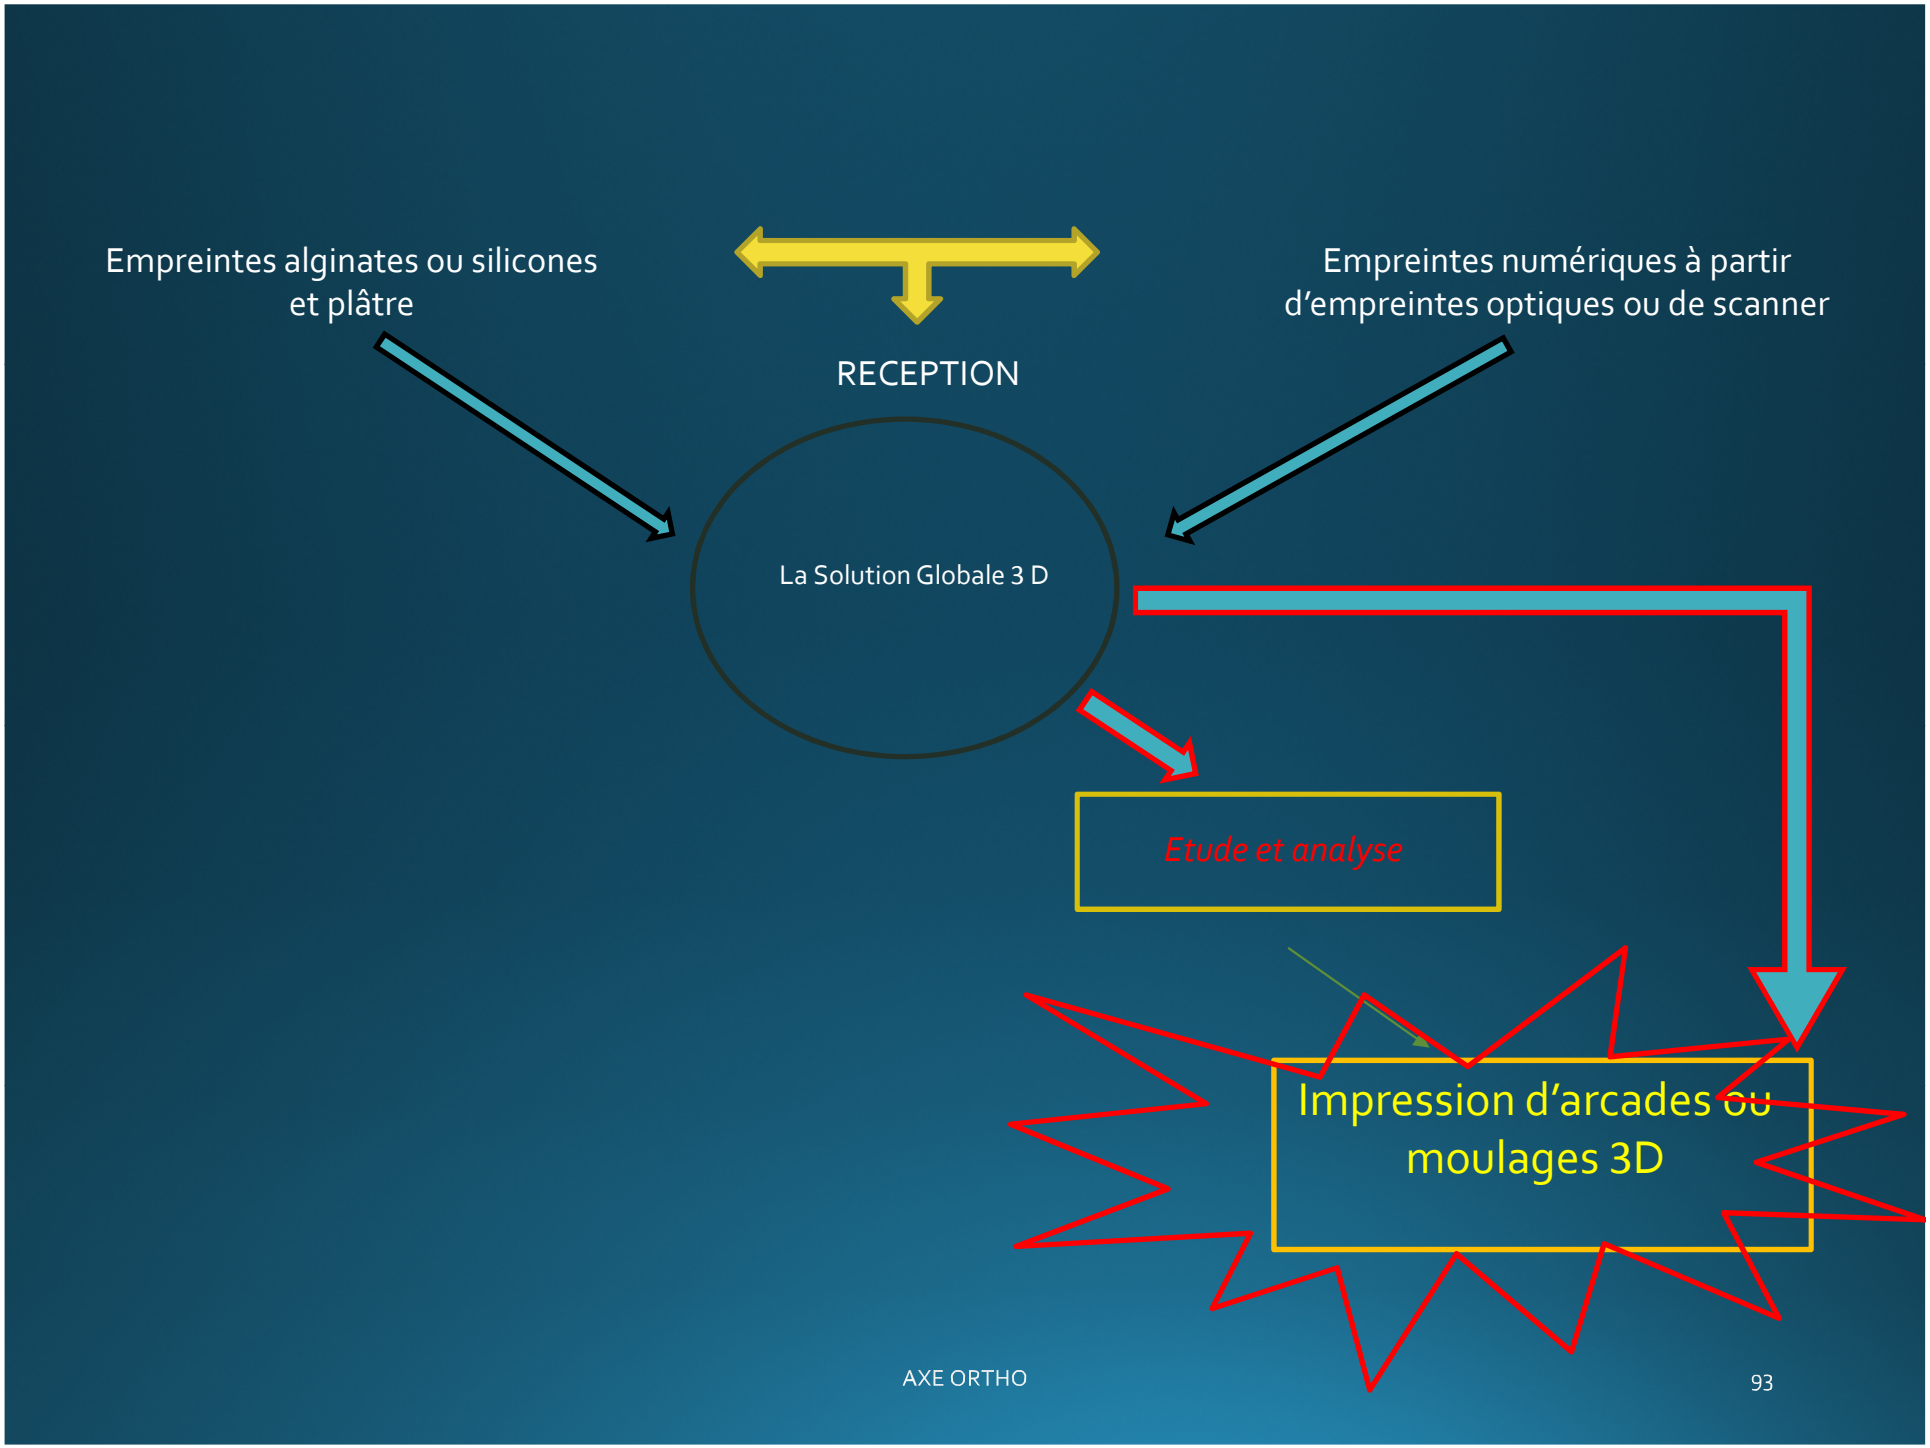
plan de traitement
positionner

LA SOLUTION GLOBALE 3D

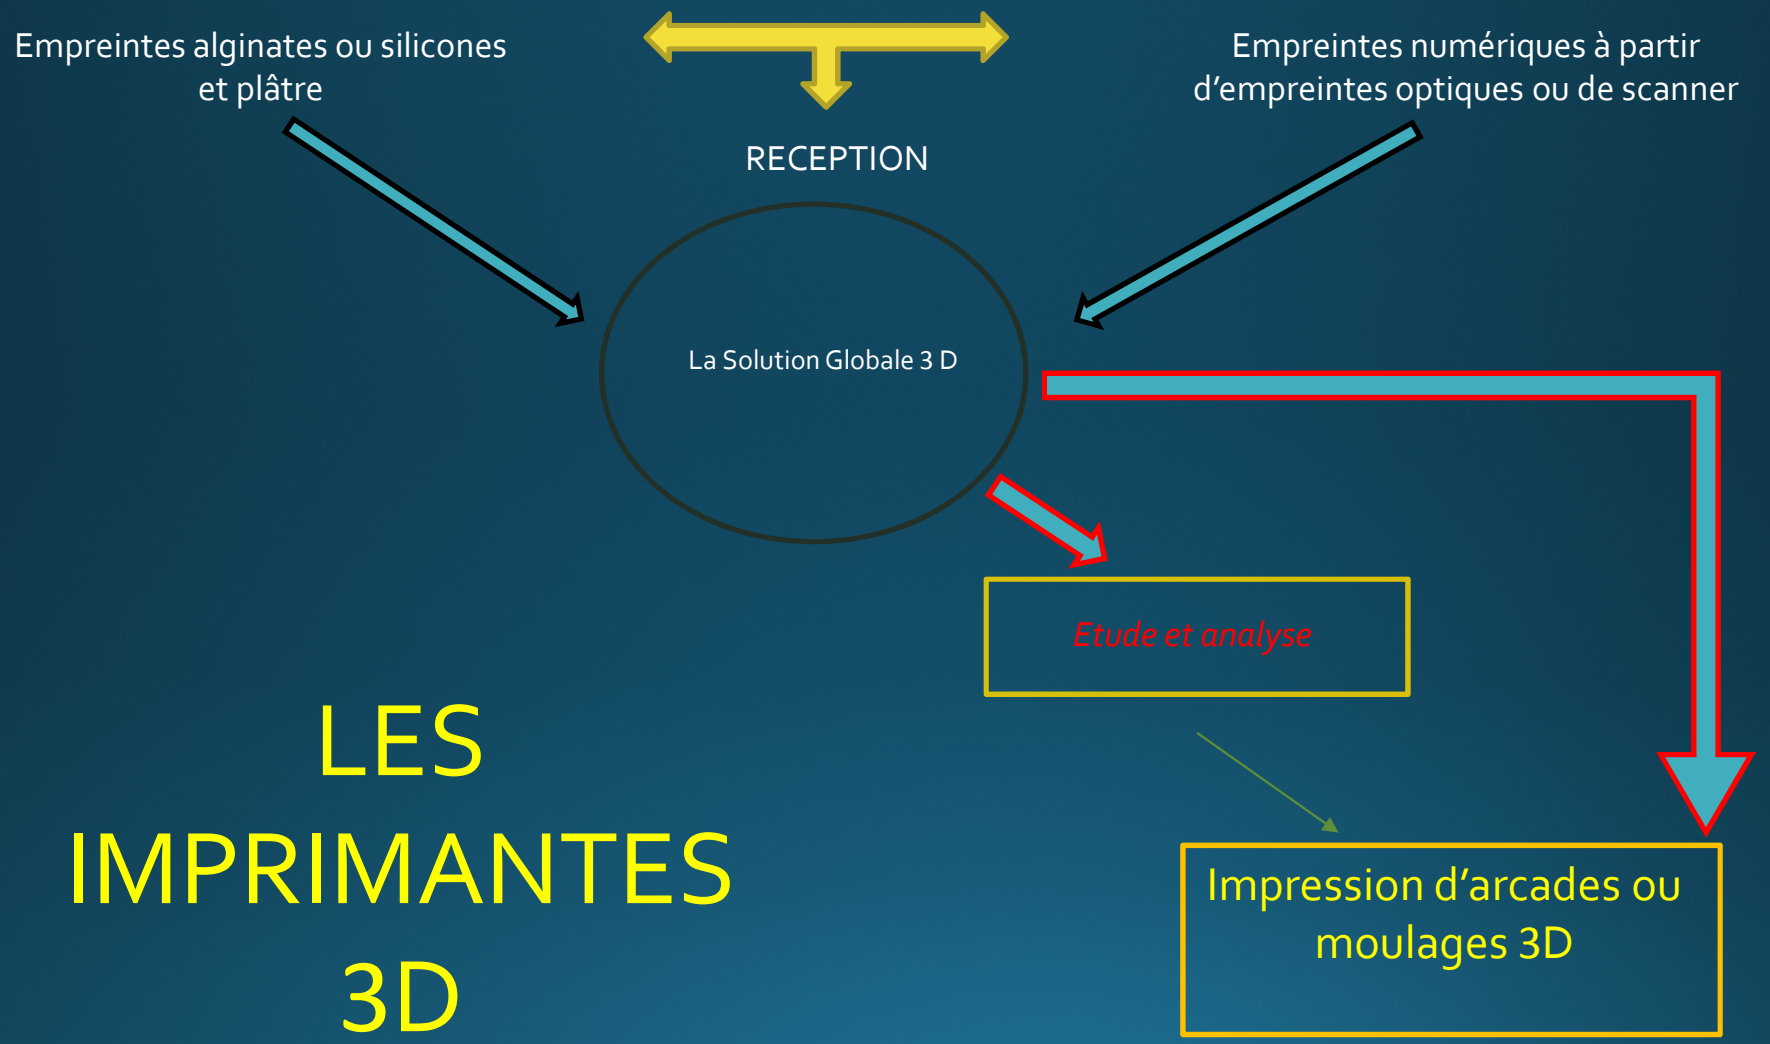
LE SET UP NUMERIQUE
et ses applications

plan de traitement
positionner
gouttières successives

LA SOLUTION GLOBALE 3D

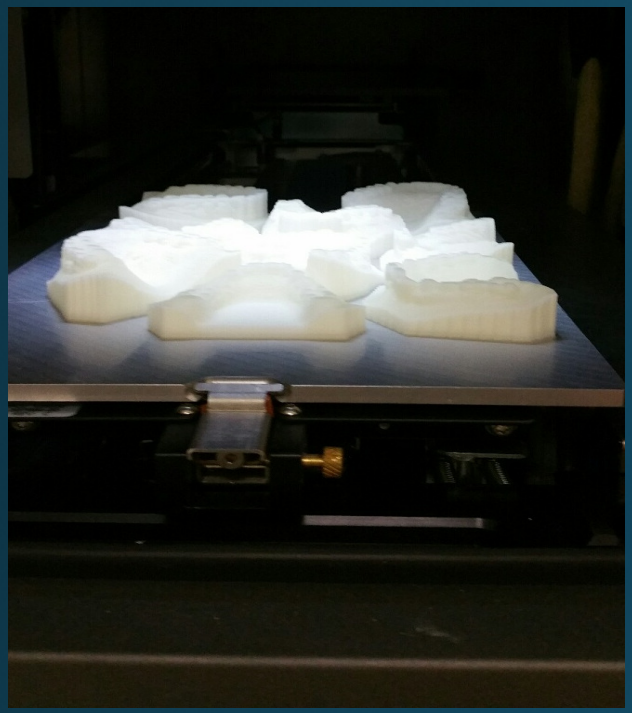

Empreintes alginates ou silicones et plâtre
RECEPTION
Empreintes numériques à partir d'empreintes optiques ou de scanner
La Solution Globale 3 D
Etude et analyse
Impression d'arcades ou moulages 3D

LES IMPRIMANTES 3D




ULTRA 3SP
SCAN SPIN AND SELECTIVELY PHOTOCURE






AXE ORTHO

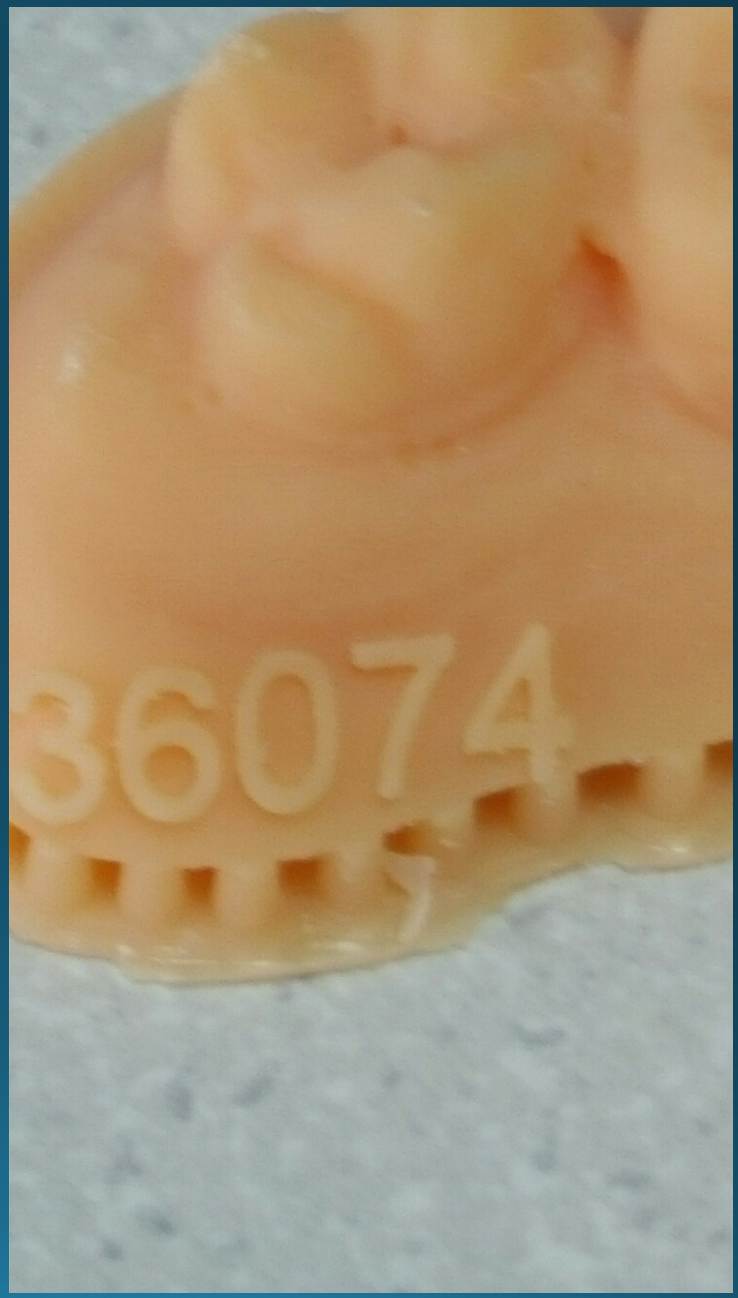






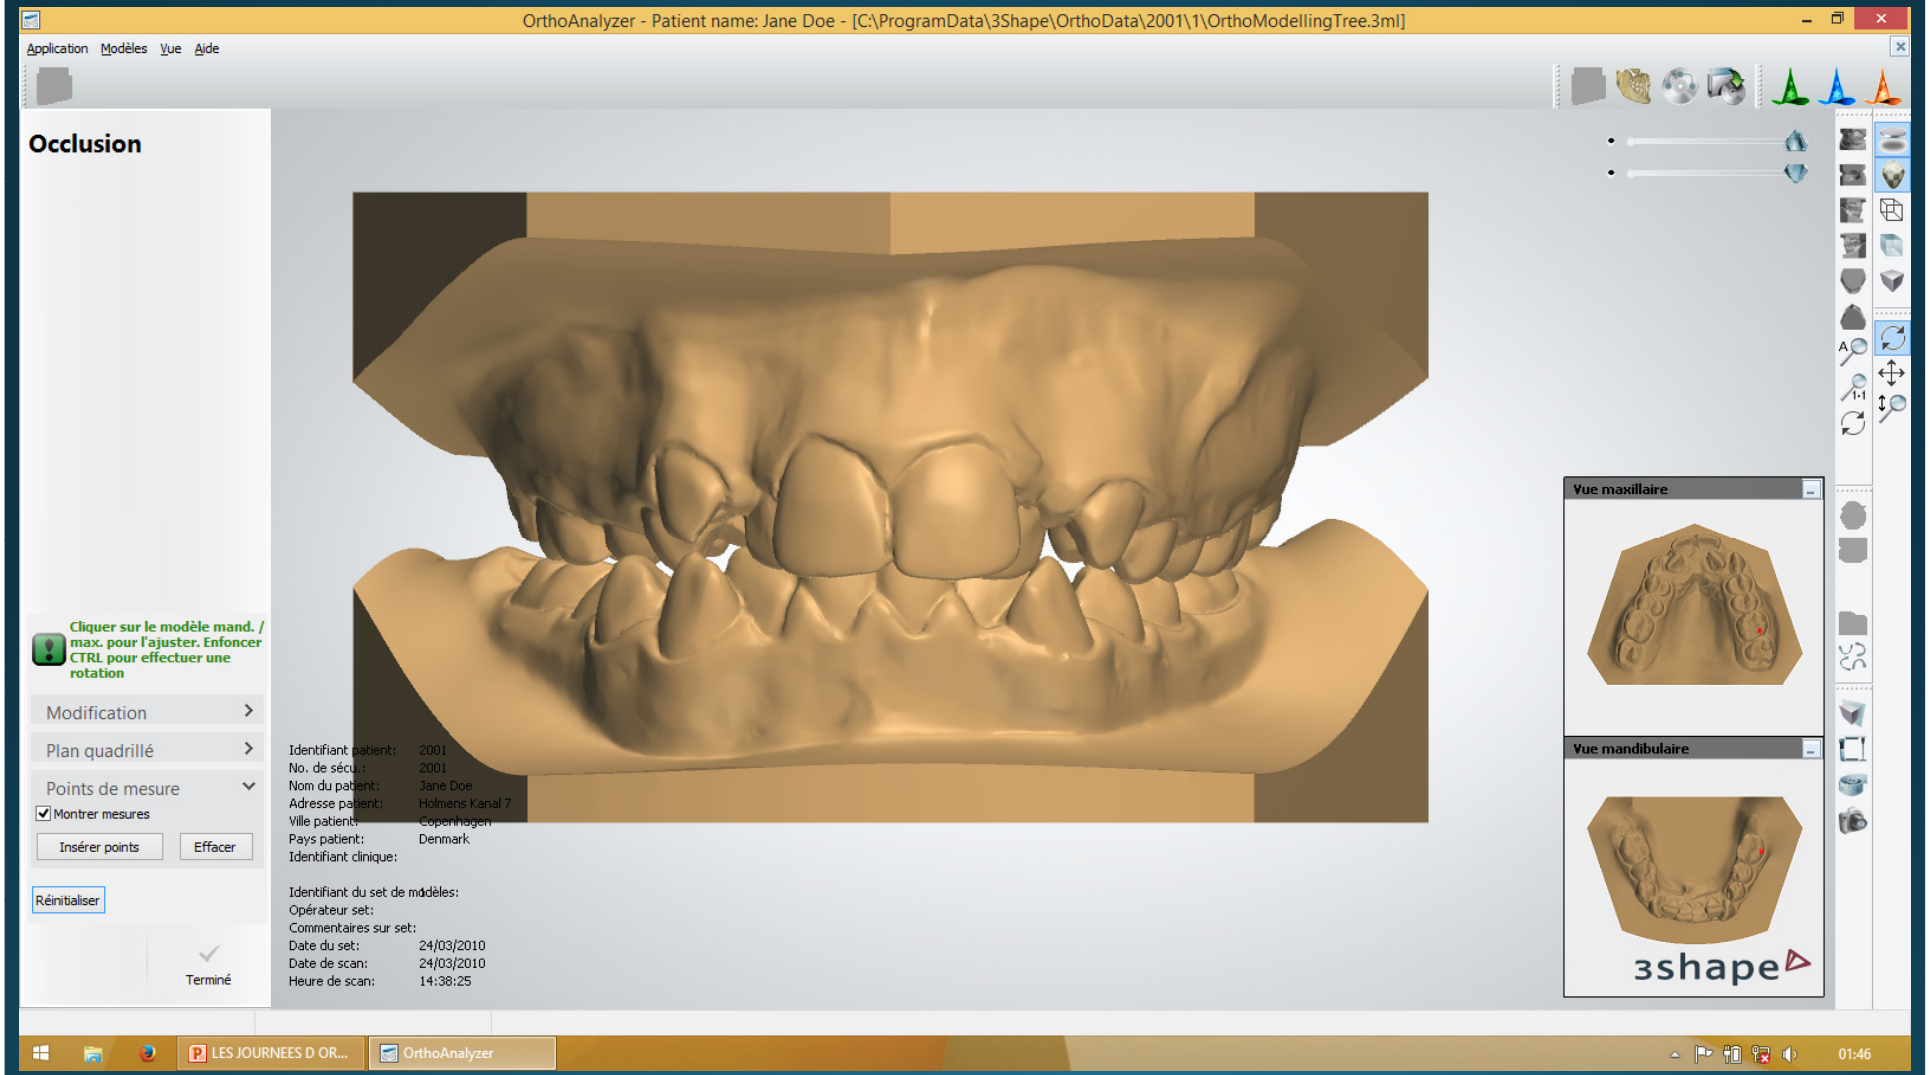


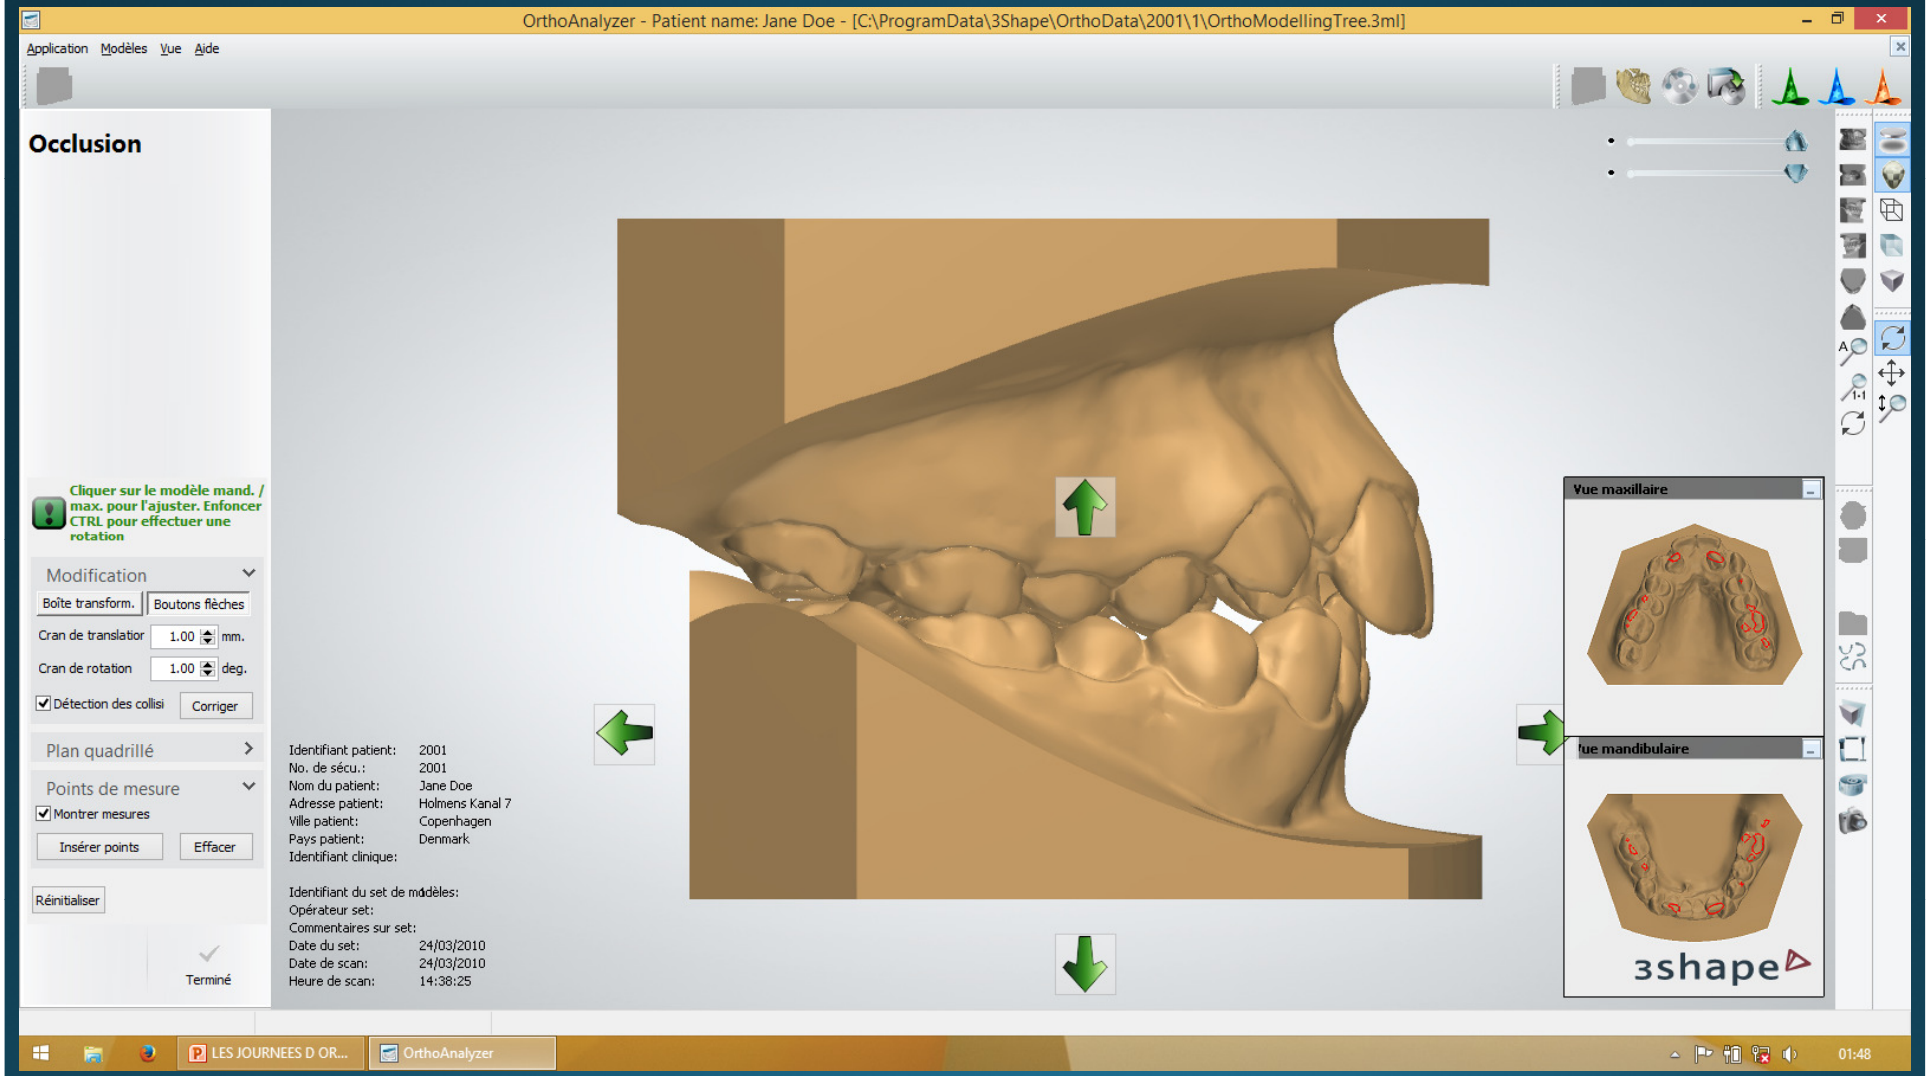

36074

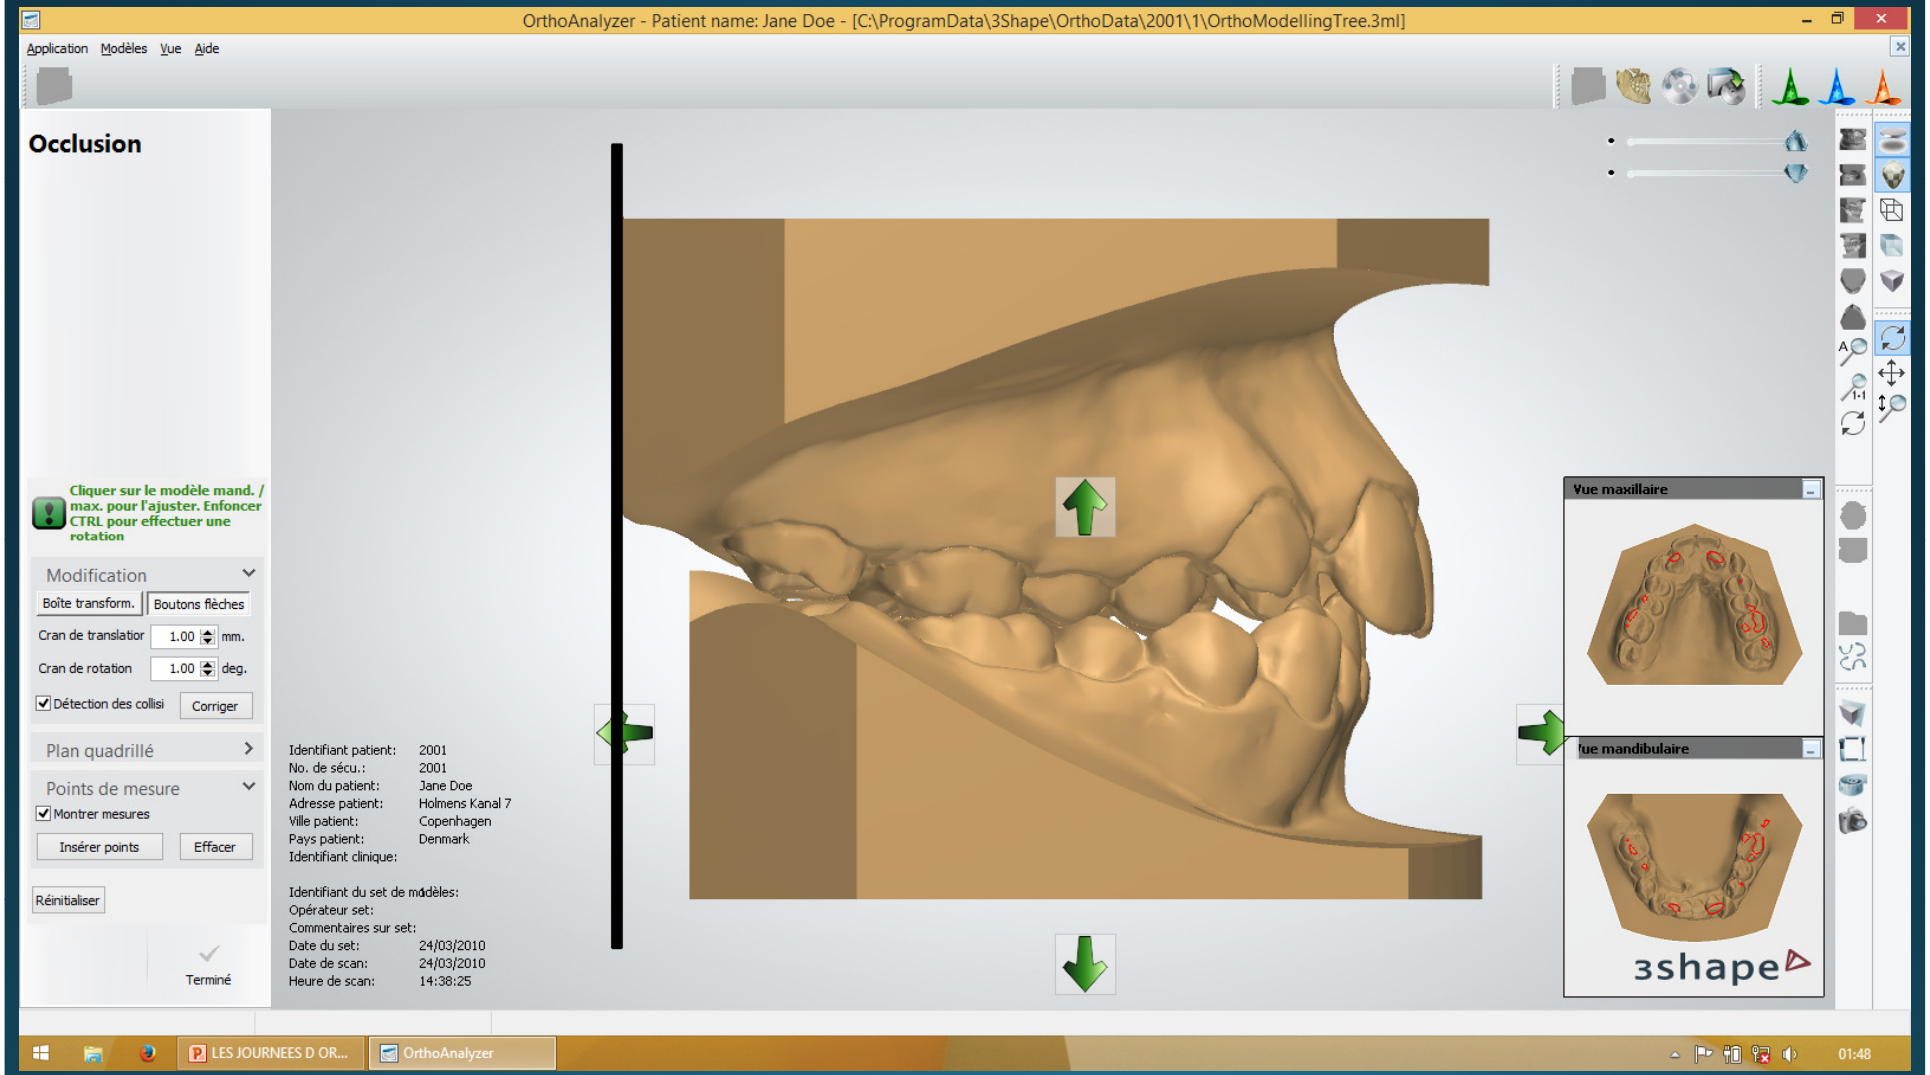

36074

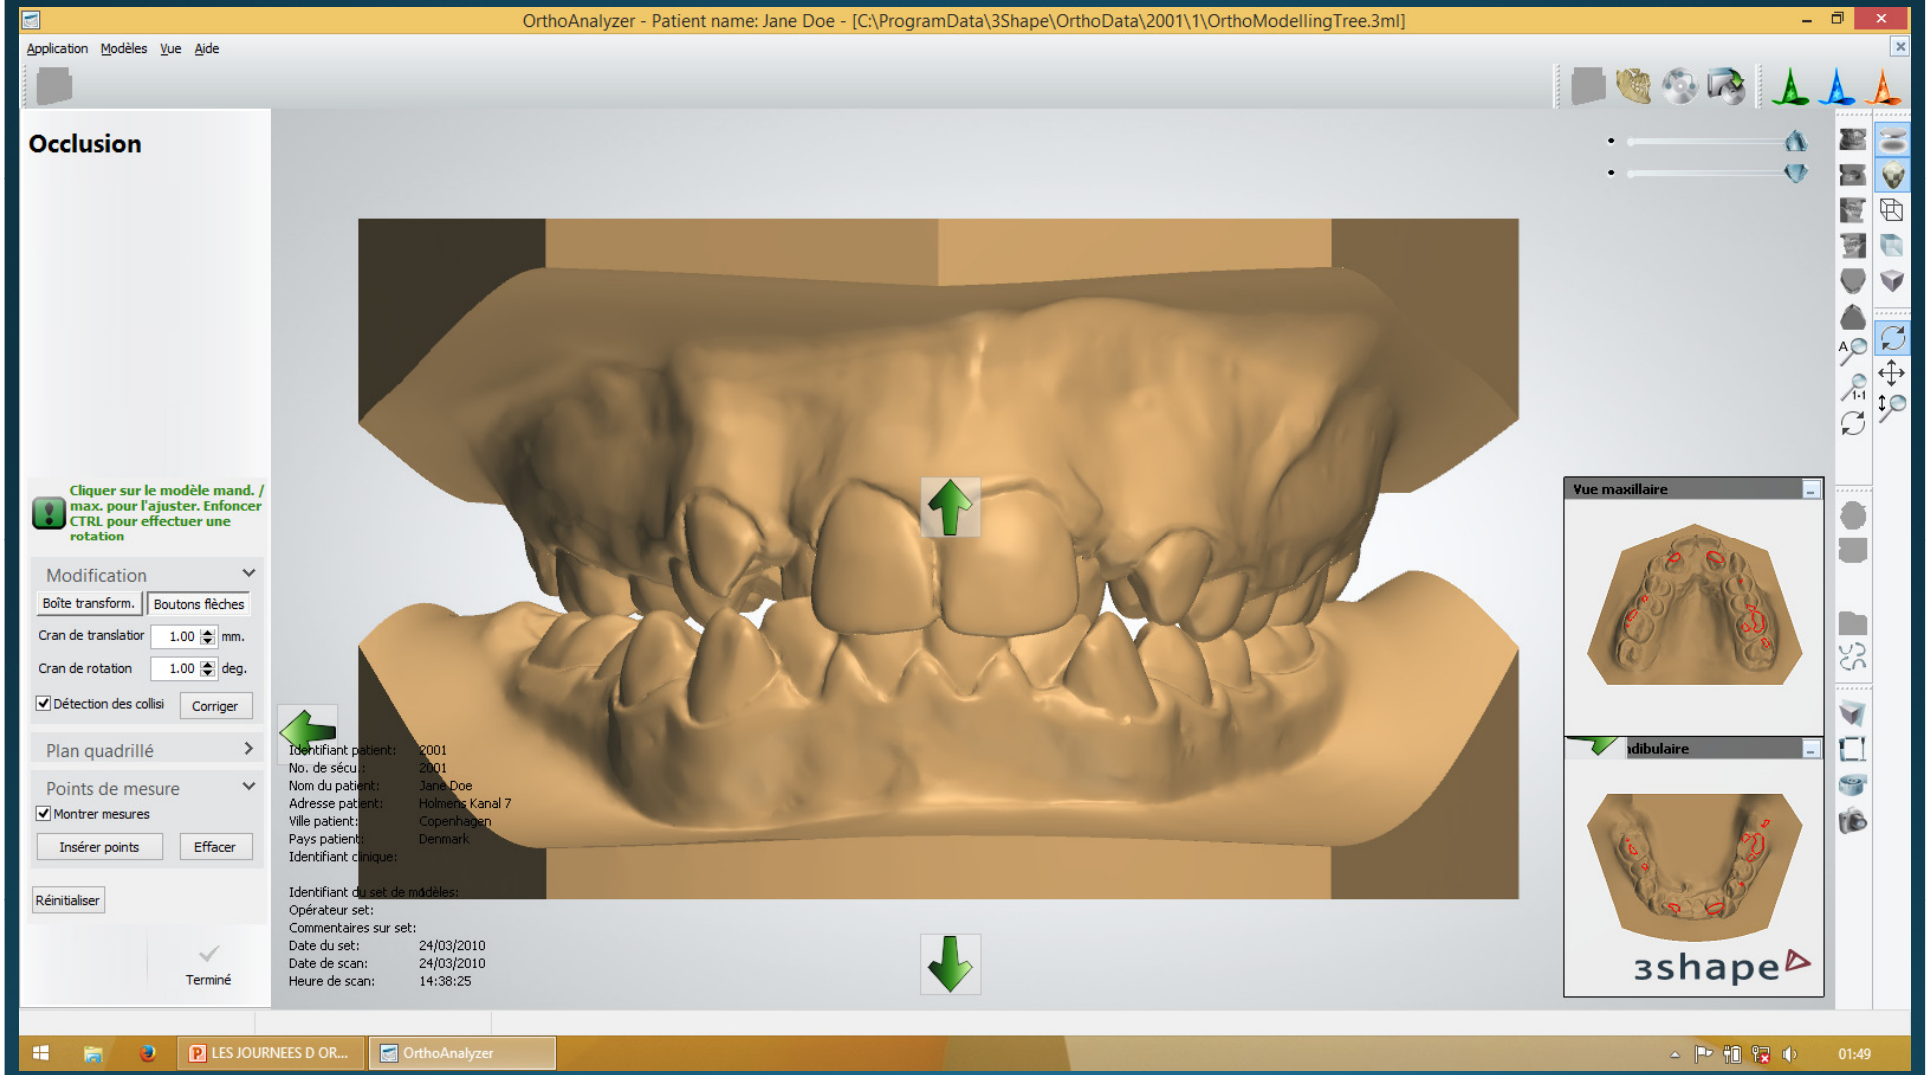
SIMULATIONS DE PLAN DE TRAITEMENT SUIVANT LES INDICATIONS ET CAS CHIRURGICAUX

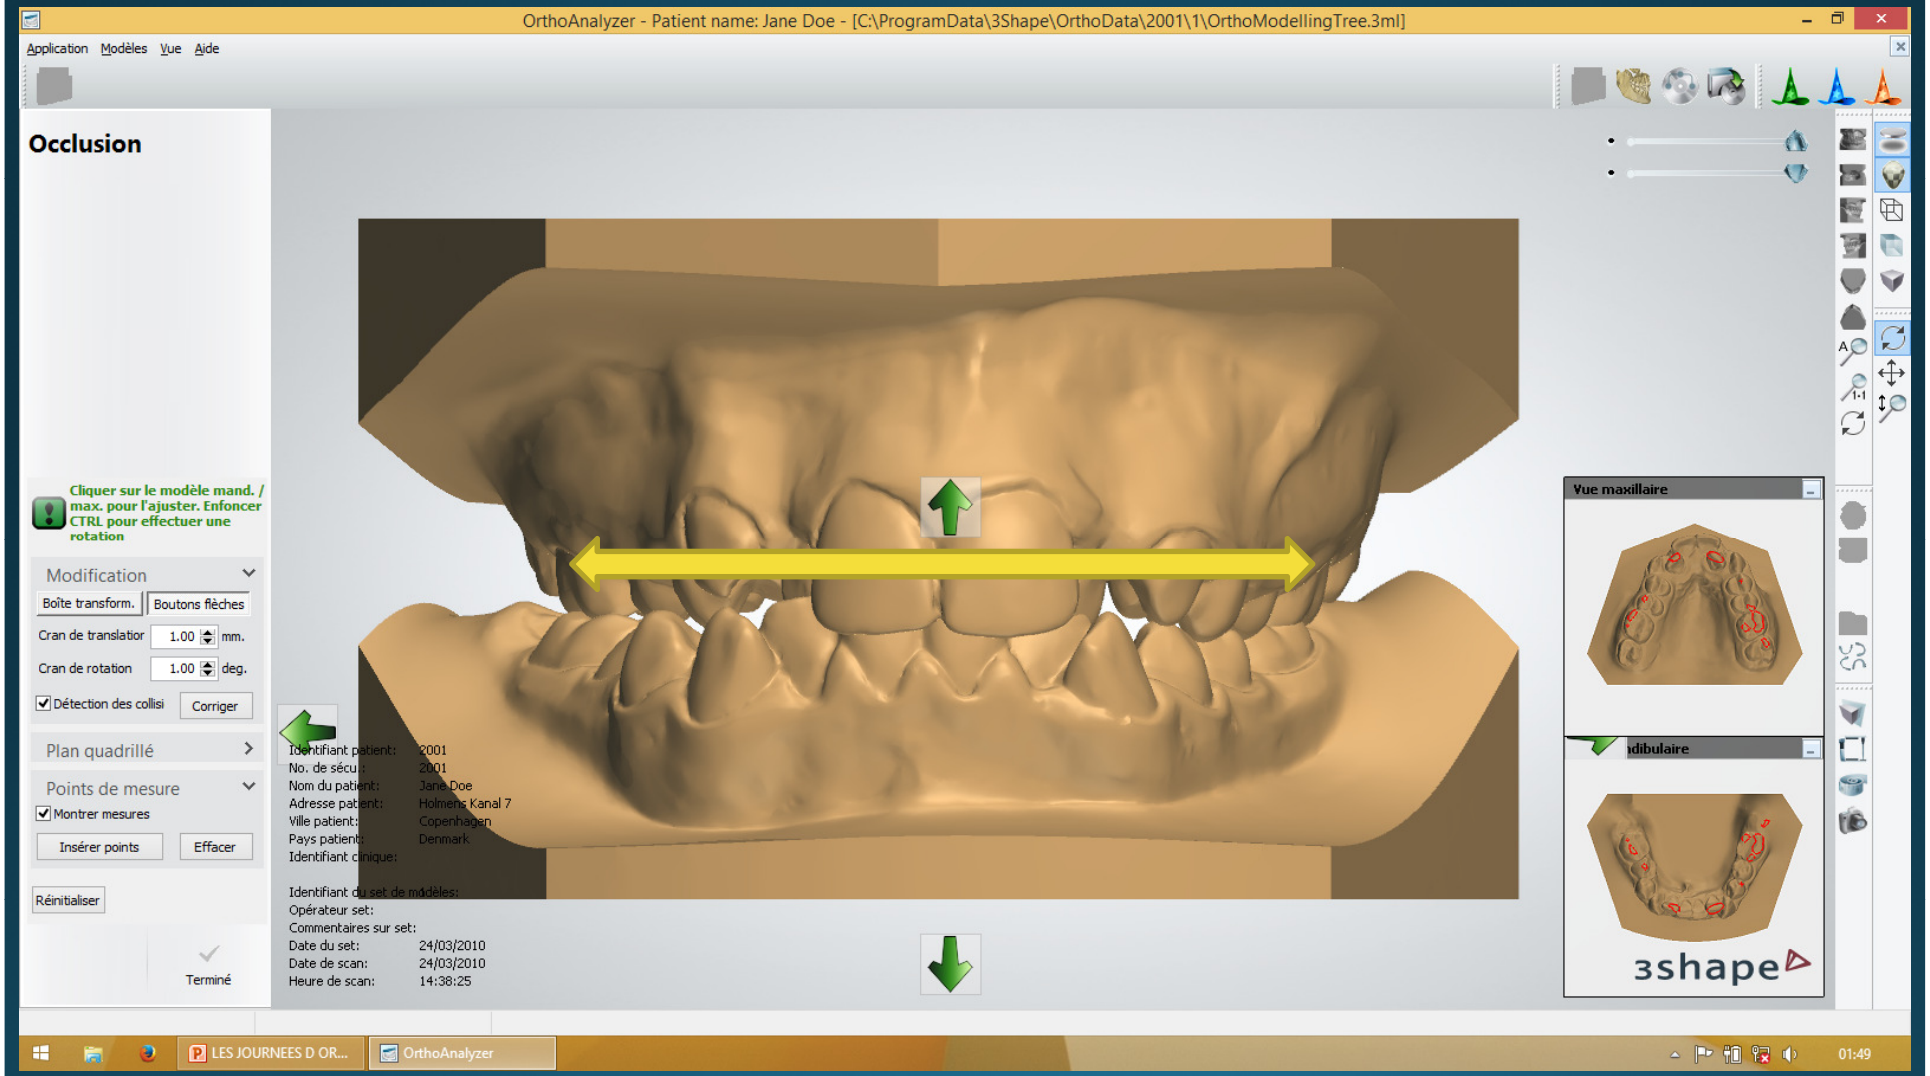
LA SOLUTION GLOBALE 3D

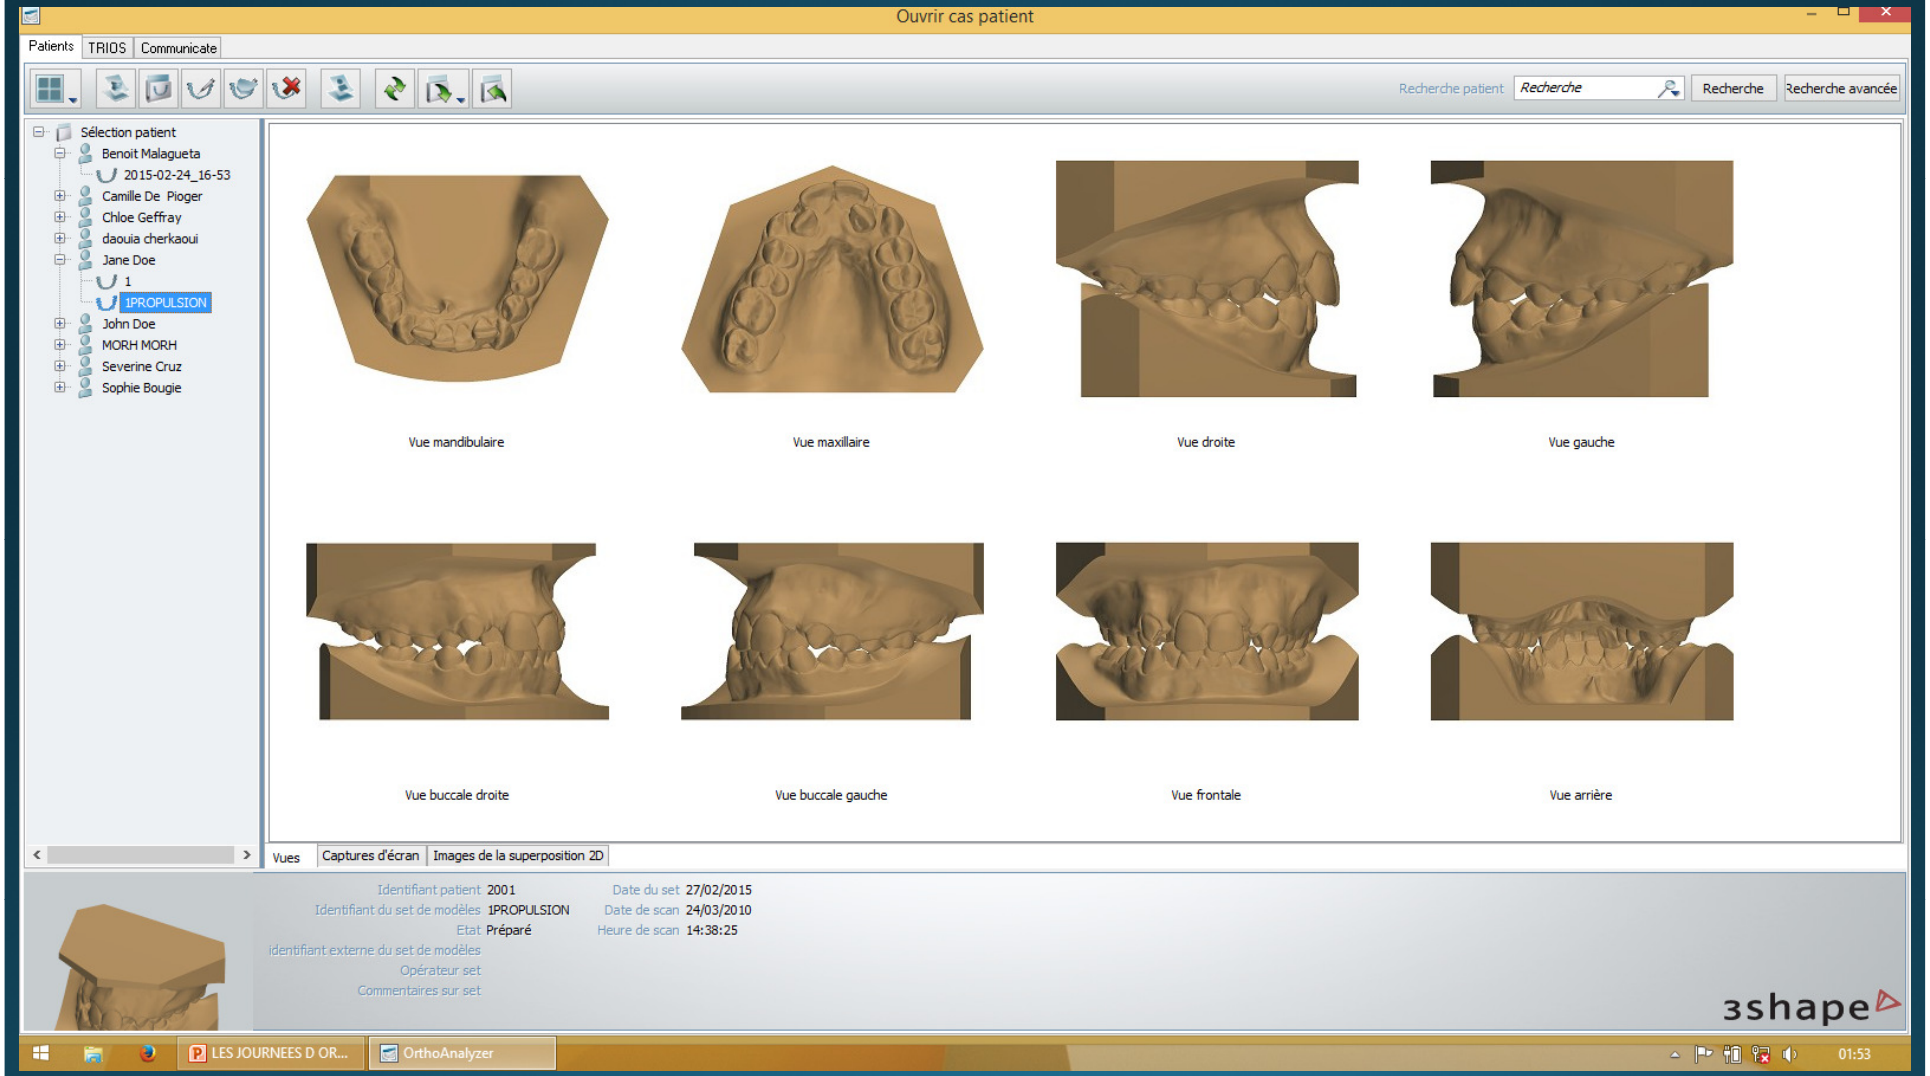

OrthoAnalyzer - Patient name: Jane Doe - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\2001\1\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Identifiant patient: 2001
No. de sécu.: 2001
Nom du patient: Jane Doe
Adresse patient: Holmens Kanal 7
Ville patient: Copenhagen
Pays patient: Denmark
Identifiant clinique:
Identifiant du set de modèles:
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/03/2010
Date de scan: 24/03/2010
Heure de scan: 14:38:25
Vue maxillaire
Vue mandibulaire
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:46

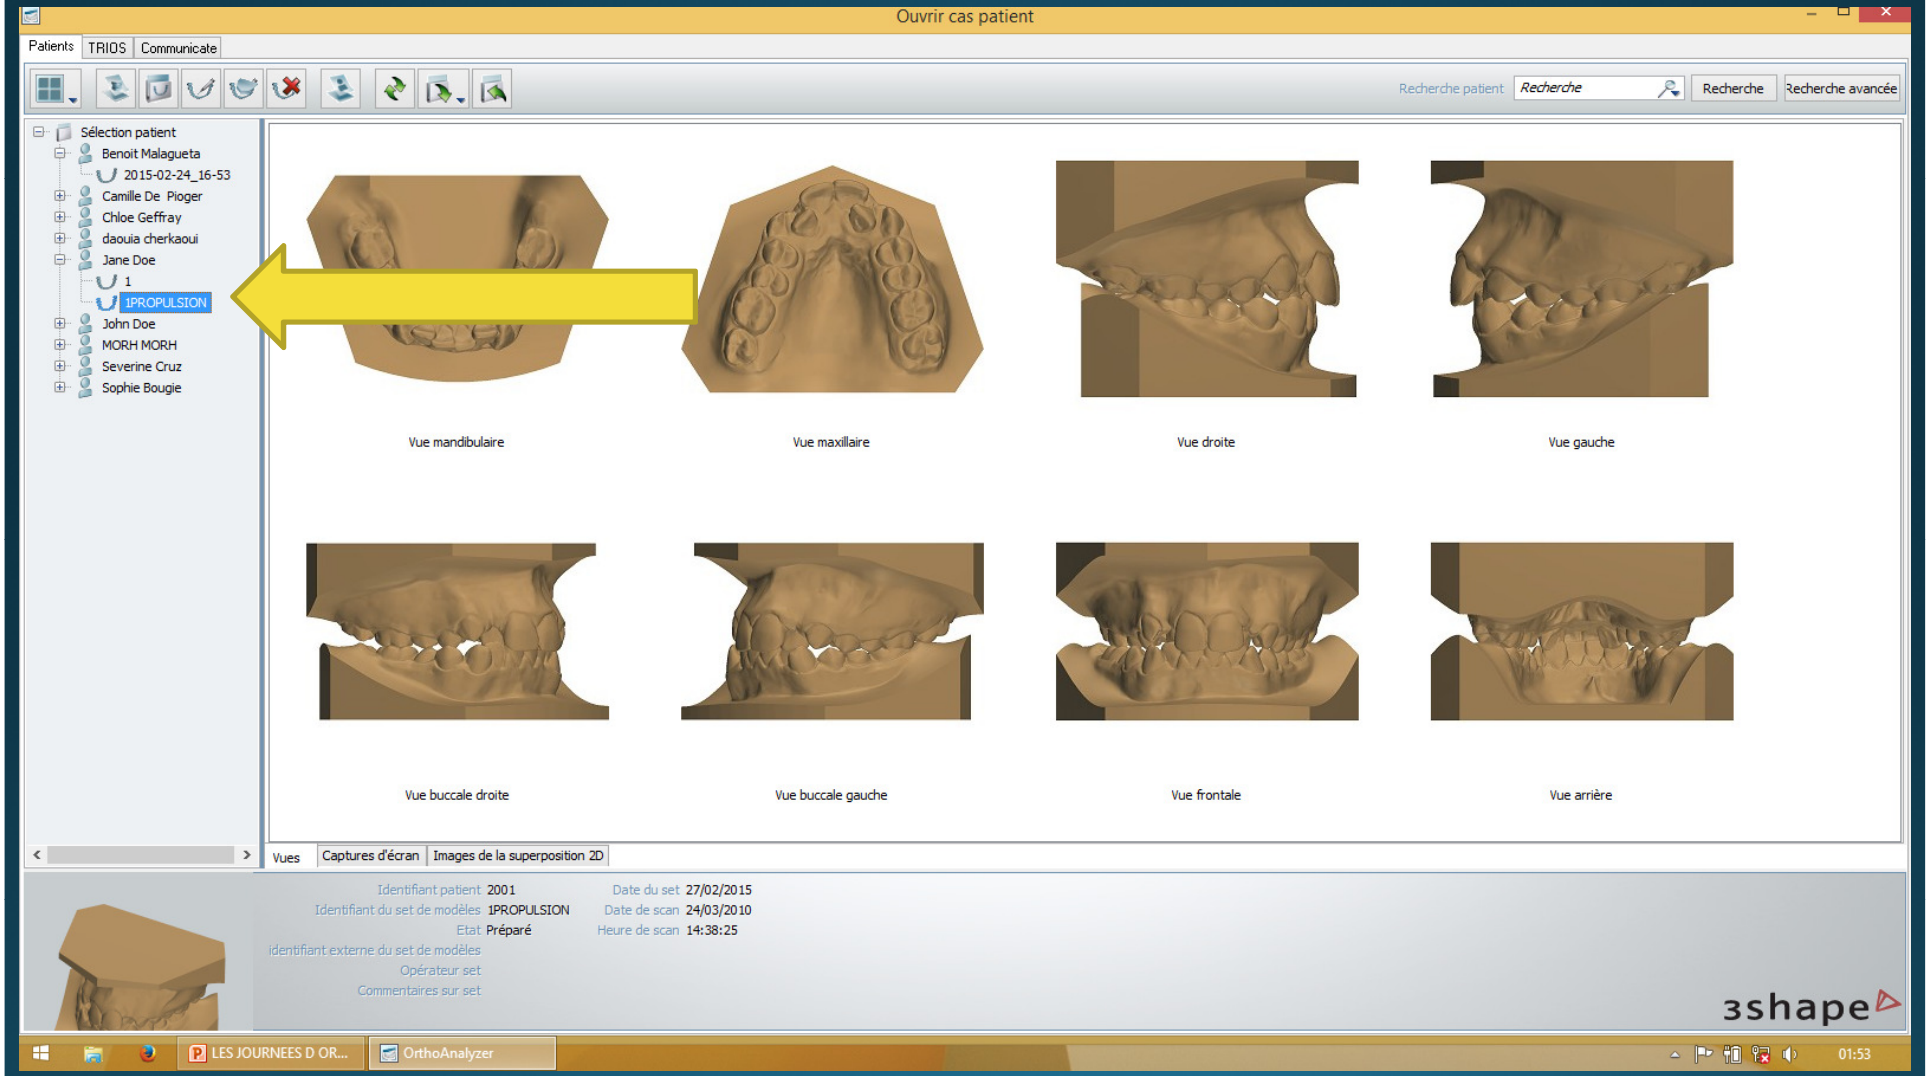

OrthoAnalyzer - Patient name: Jane Doe - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\2001\1\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Boîte transform.
Boutons flèches
Cran de translatior 1.00 mm.
Cran de rotation 1.00 deg.
Détection des collisi
Corriger
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Identifiant patient: 2001
No. de sécu.: 2001
Nom du patient: Jane Doe
Adresse patient: Holmens Kanal 7
Ville patient: Copenhagen
Pays patient: Denmark
Identifiant clinique:
Identifiant du set de modèles:
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/03/2010
Date de scan: 24/03/2010
Heure de scan: 14:38:25
Vue maxillaire
Vue mandibulaire
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:48

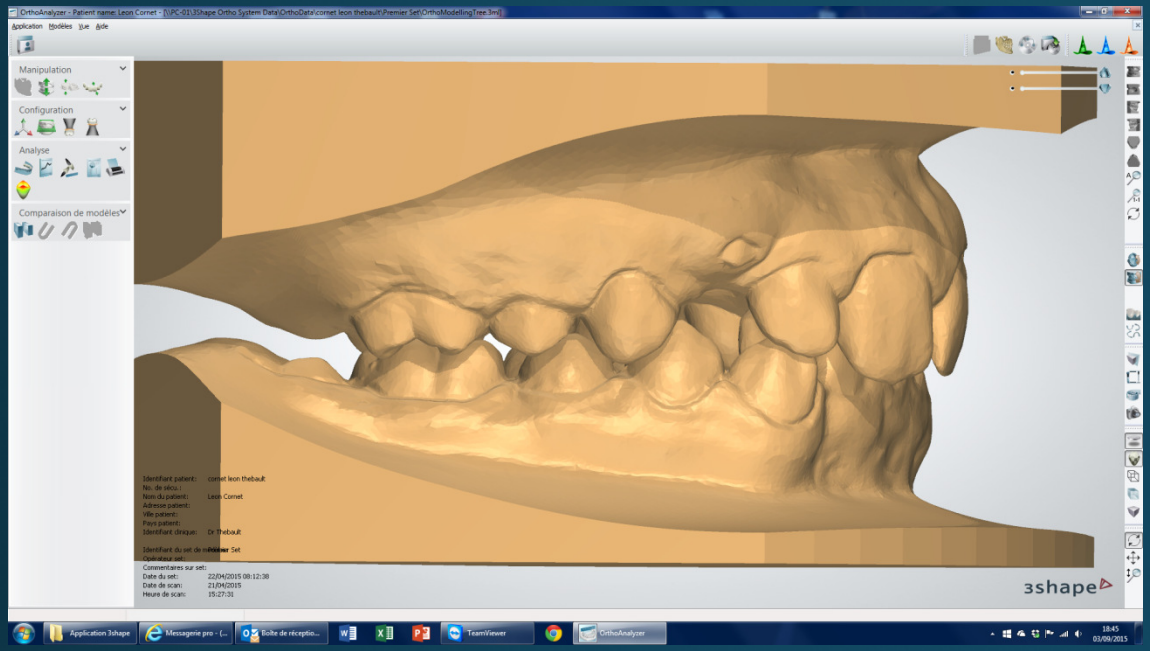

OrthoAnalyzer - Patient name: Jane Doe - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\2001\1\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Boîte transform.
Boutons flèches
Cran de translatior 1.00 mm.
Cran de rotation 1.00 deg.
Détection des collisi
Corriger
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Identifiant patient: 2001
No. de sécu.: 2001
Nom du patient: Jane Doe
Adresse patient: Holmens Kanal 7
Ville patient: Copenhagen
Pays patient: Denmark
Identifiant clinique:
Identifiant du set de modèles:
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/03/2010
Date de scan: 24/03/2010
Heure de scan: 14:38:25
Vue maxillaire
Vue mandibulaire
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:48

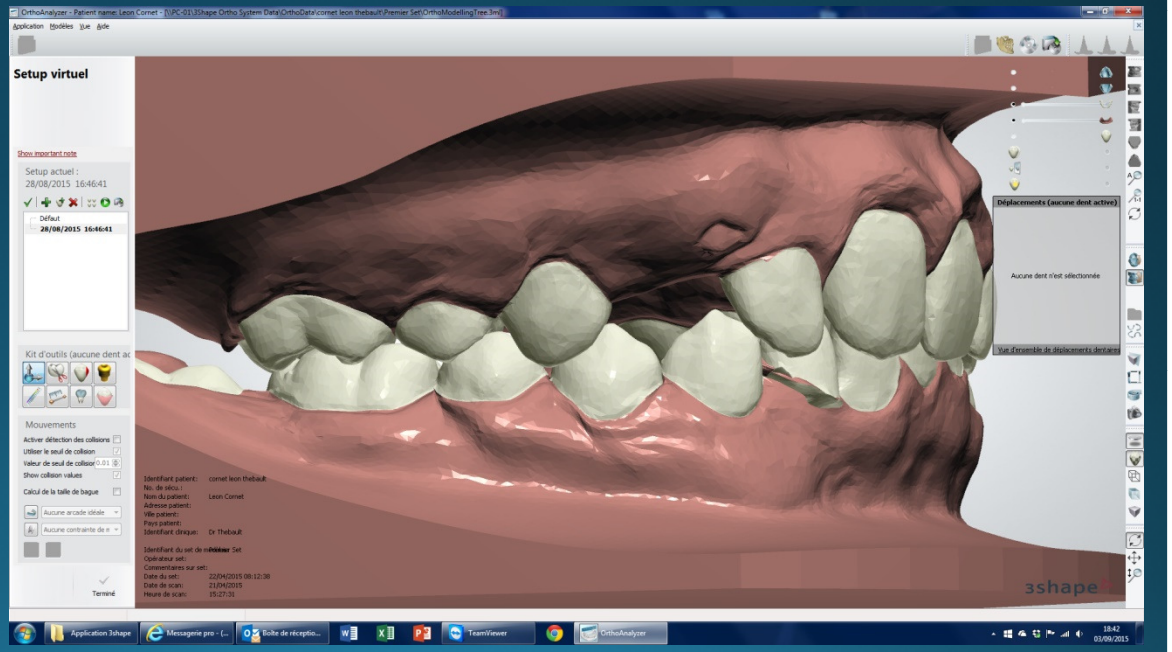

OrthoAnalyzer - Patient name: Jane Doe - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\2001\1\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Boîte transform.
Boutons flèches
Cran de translatior 1.00 mm.
Cran de rotation 1.00 deg.
Détection des collisi
Corriger
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Identifiant patient: 2001
No. de sécu : 2001
Nom du patient: Jane Doe
Adresse patient: Holmens Kanal 7
Ville patient: Copenhagen
Pays patient: Denmark
Identifiant clinique:
Identifiant du set de modèles:
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/03/2010
Date de scan: 24/03/2010
Heure de scan: 14:38:25
Vue maxillaire
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:49

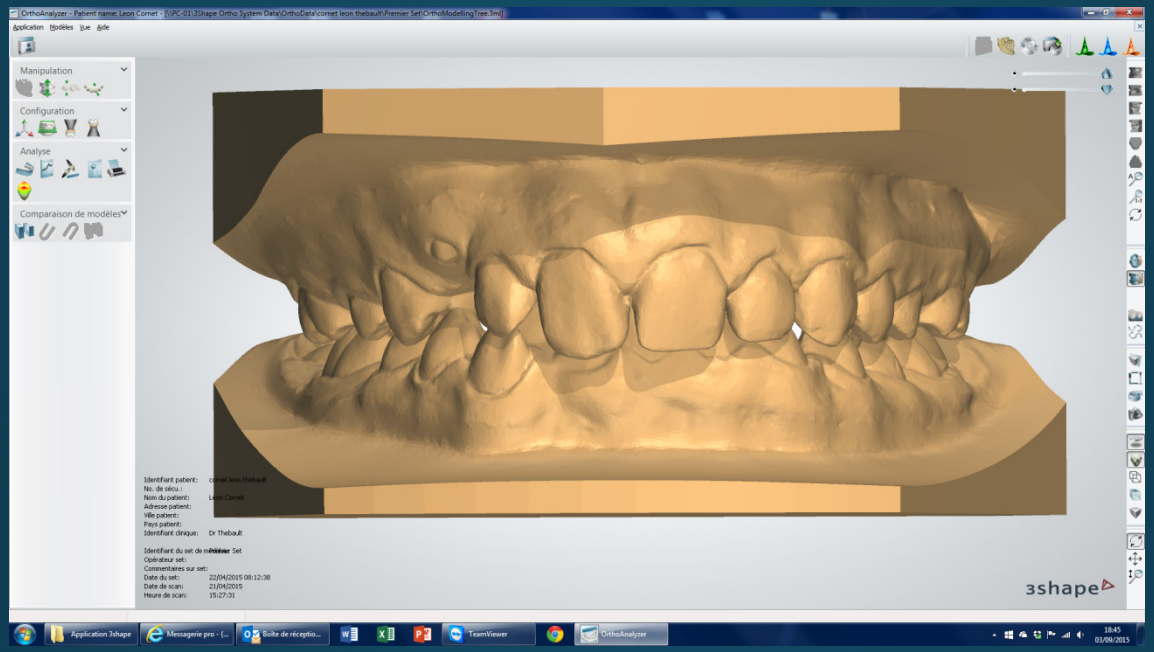

OrthoAnalyzer - Patient name: Jane Doe - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\2001\1\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Occlusion
Cliquer sur le modèle mand. / max. pour l'ajuster. Enfoncer CTRL pour effectuer une rotation
Modification
Boîte transform.
Boutons flèches
Cran de translatior 1.00 mm.
Cran de rotation 1.00 deg.
Détection des collisi
Corriger
Plan quadrillé
Points de mesure
Montrer mesures
Insérer points
Effacer
Réinitialiser
Terminé
Identifiant patient: 2001
No. de sécu : 2001
Nom du patient: Jane Doe
Adresse patient: Holmens Kanal 7
Ville patient: Copenhagen
Pays patient: Denmark
Identifiant clinique:
Identifiant du set de modèles:
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 24/03/2010
Date de scan: 24/03/2010
Heure de scan: 14:38:25
Vue maxillaire
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:49

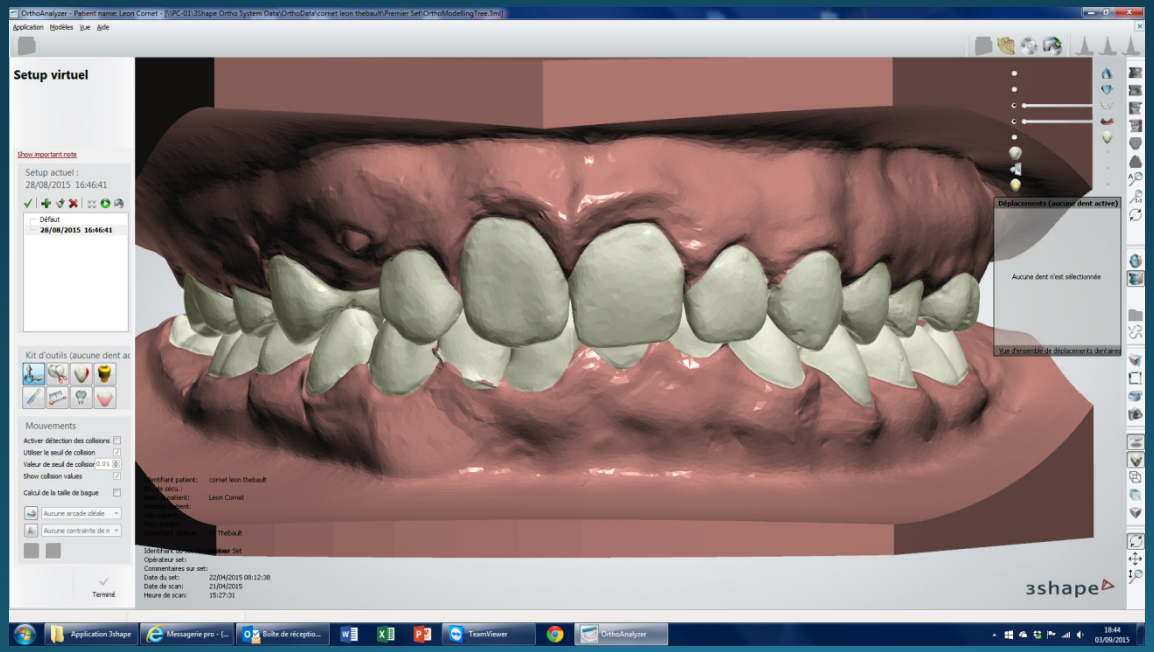

Ouvrir cas patient
Patients
TRIOS
Communicate
Recherche patient
Recherche
Recherche
Recherche avancée
Sélection patient
Benoit Malagueta
2015-02-24_16-53
Camille De Pioger
Chloe Geffray
daouia cherkaoui
Jane Doe
1
1PROPULSION
John Doe
MORH MORH
Severine Cruz
Sophie Bougie
Vue mandibulaire
Vue maxillaire
Vue droite
Vue gauche
Vue buccale droite
Vue buccale gauche
Vue frontale
Vue arrière
Vues
Captures d'écran
Images de la superposition 2D
Identifiant patient 2001
Identifiant du set de modèles 1PROPULSION
Etat Préparé
identifiant externe du set de modèles
Opérateur set
Commentaires sur set
Date du set 27/02/2015
Date de scan 24/03/2010
Heure de scan 14:38:25
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:53

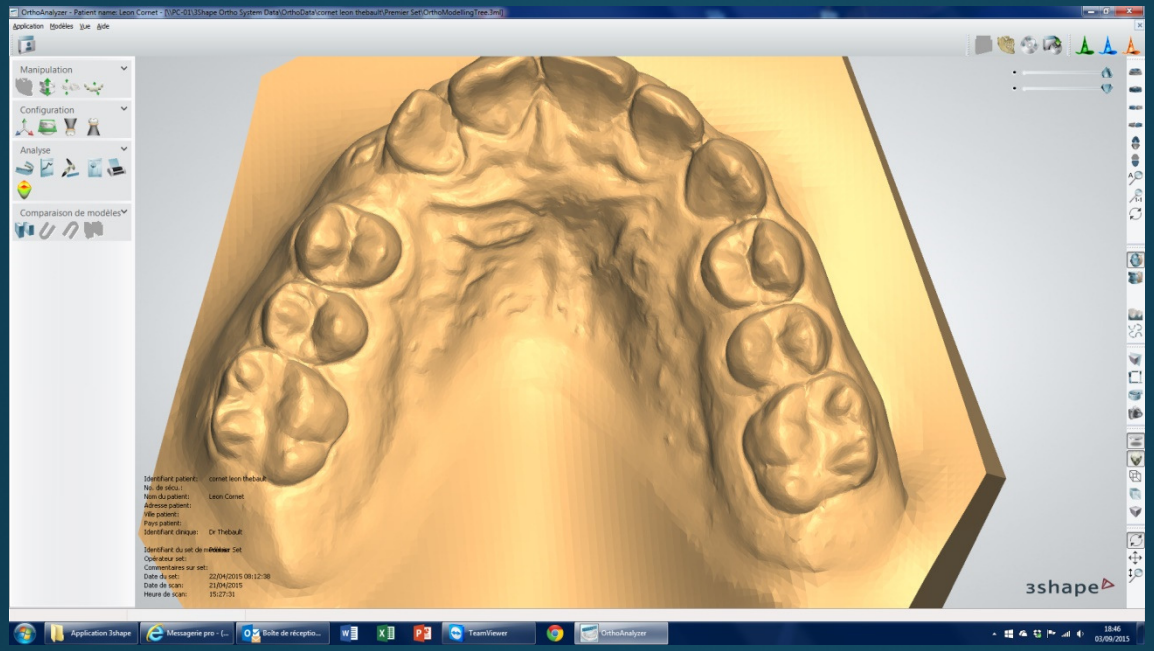

Ouvrir cas patient
Patients
TRIOS
Communicate
Recherche patient
Recherche
Recherche
Recherche avancée
Sélection patient
Benoit Malagueta
2015-02-24_16-53
Camille De Pioger
Chloe Geffray
daouia cherkaoui
Jane Doe
1
1PROPULSION
John Doe
MORH MORH
Severine Cruz
Sophie Bougie
Vue mandibulaire
Vue maxillaire
Vue droite
Vue gauche
Vue buccale droite
Vue buccale gauche
Vue frontale
Vue arrière
Vues
Captures d'écran
Images de la superposition 2D
Identifiant patient 2001
Identifiant du set de modèles 1PROPULSION
Etat Préparé
identifiant externe du set de modèles
Opérateur set
Commentaires sur set
Date du set 27/02/2015
Date de scan 24/03/2010
Heure de scan 14:38:25
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:53

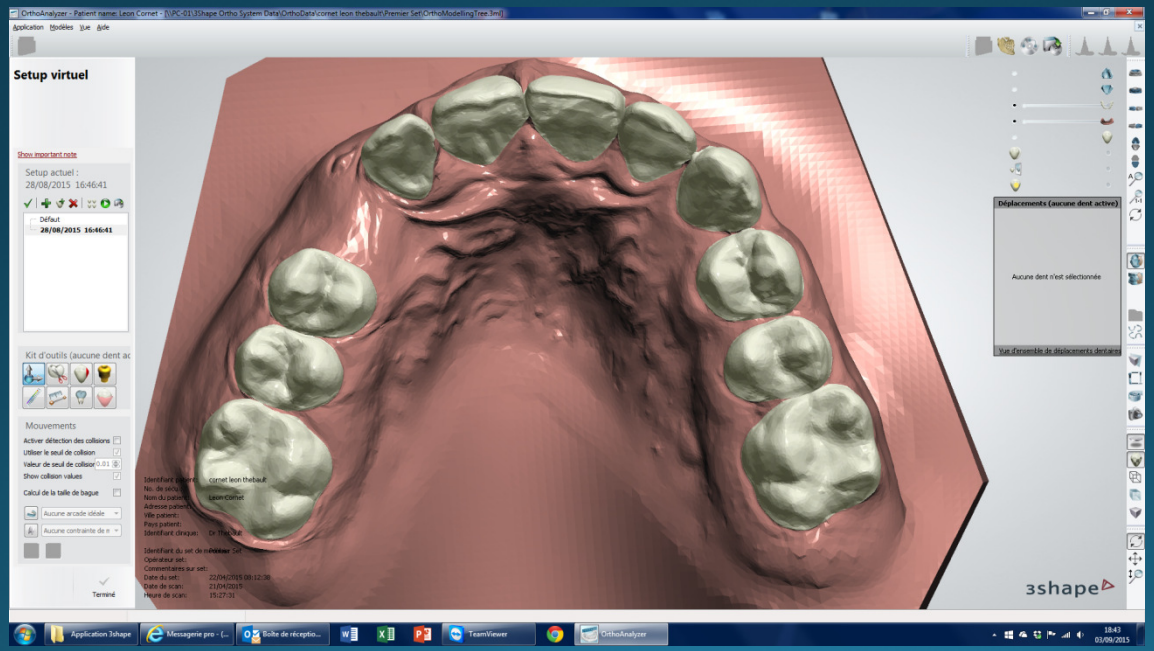

Manipulation
Configuration
Analyse
Comparaison de modèles
3shape

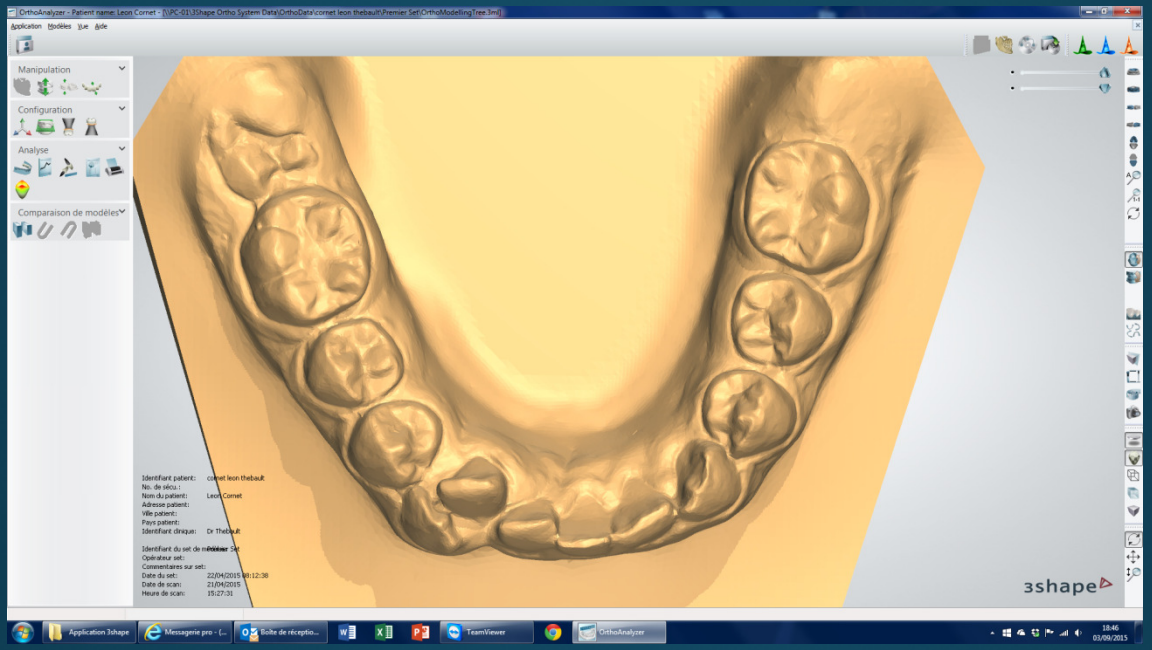

Setup virtuel
Show important note
Setup actuel :
28/08/2015 16:46:41
Défaut
28/08/2015 16:46:41
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de m
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
3shape

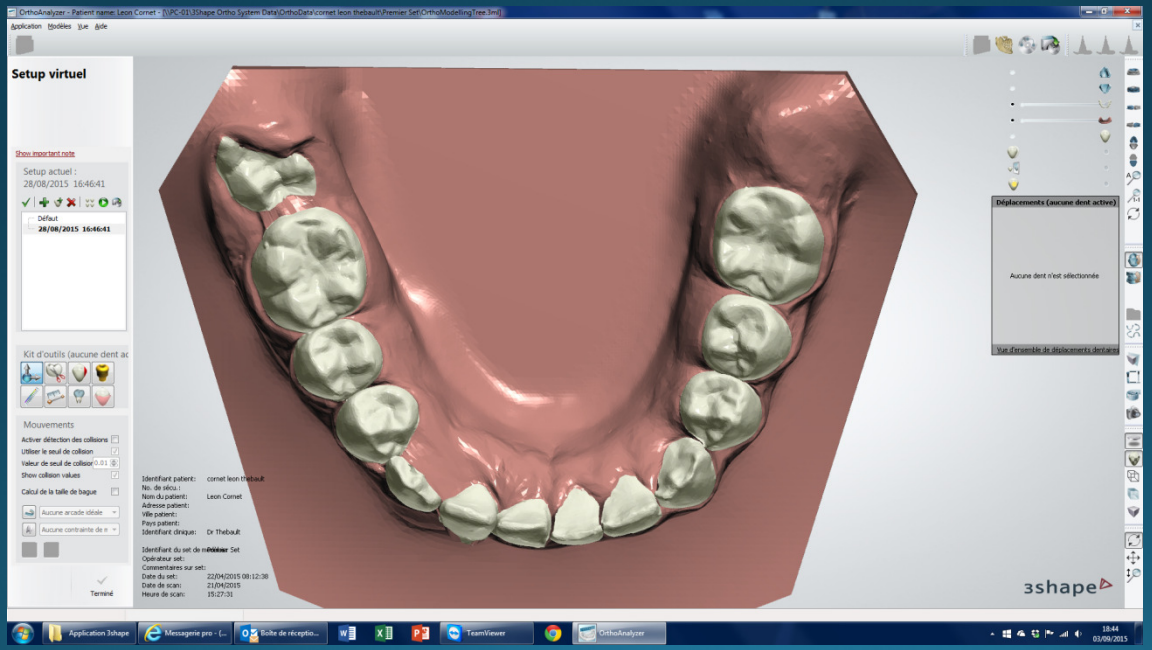

Manipulation
Configuration
Analyse
Comparaison de modèles
3shape


Setup virtuel
Show important note
Setup actuel :
28/08/2015 16:46:41
Défaut
28/08/2015 16:46:41
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
3shape


Manipulation
Configuration
Analyse
Comparaison de modèles
3shape


Setup virtuel
Show important note
Setup actuel :
28/08/2015 16:46:41
Défaut
28/08/2015 16:46:41
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
3shape

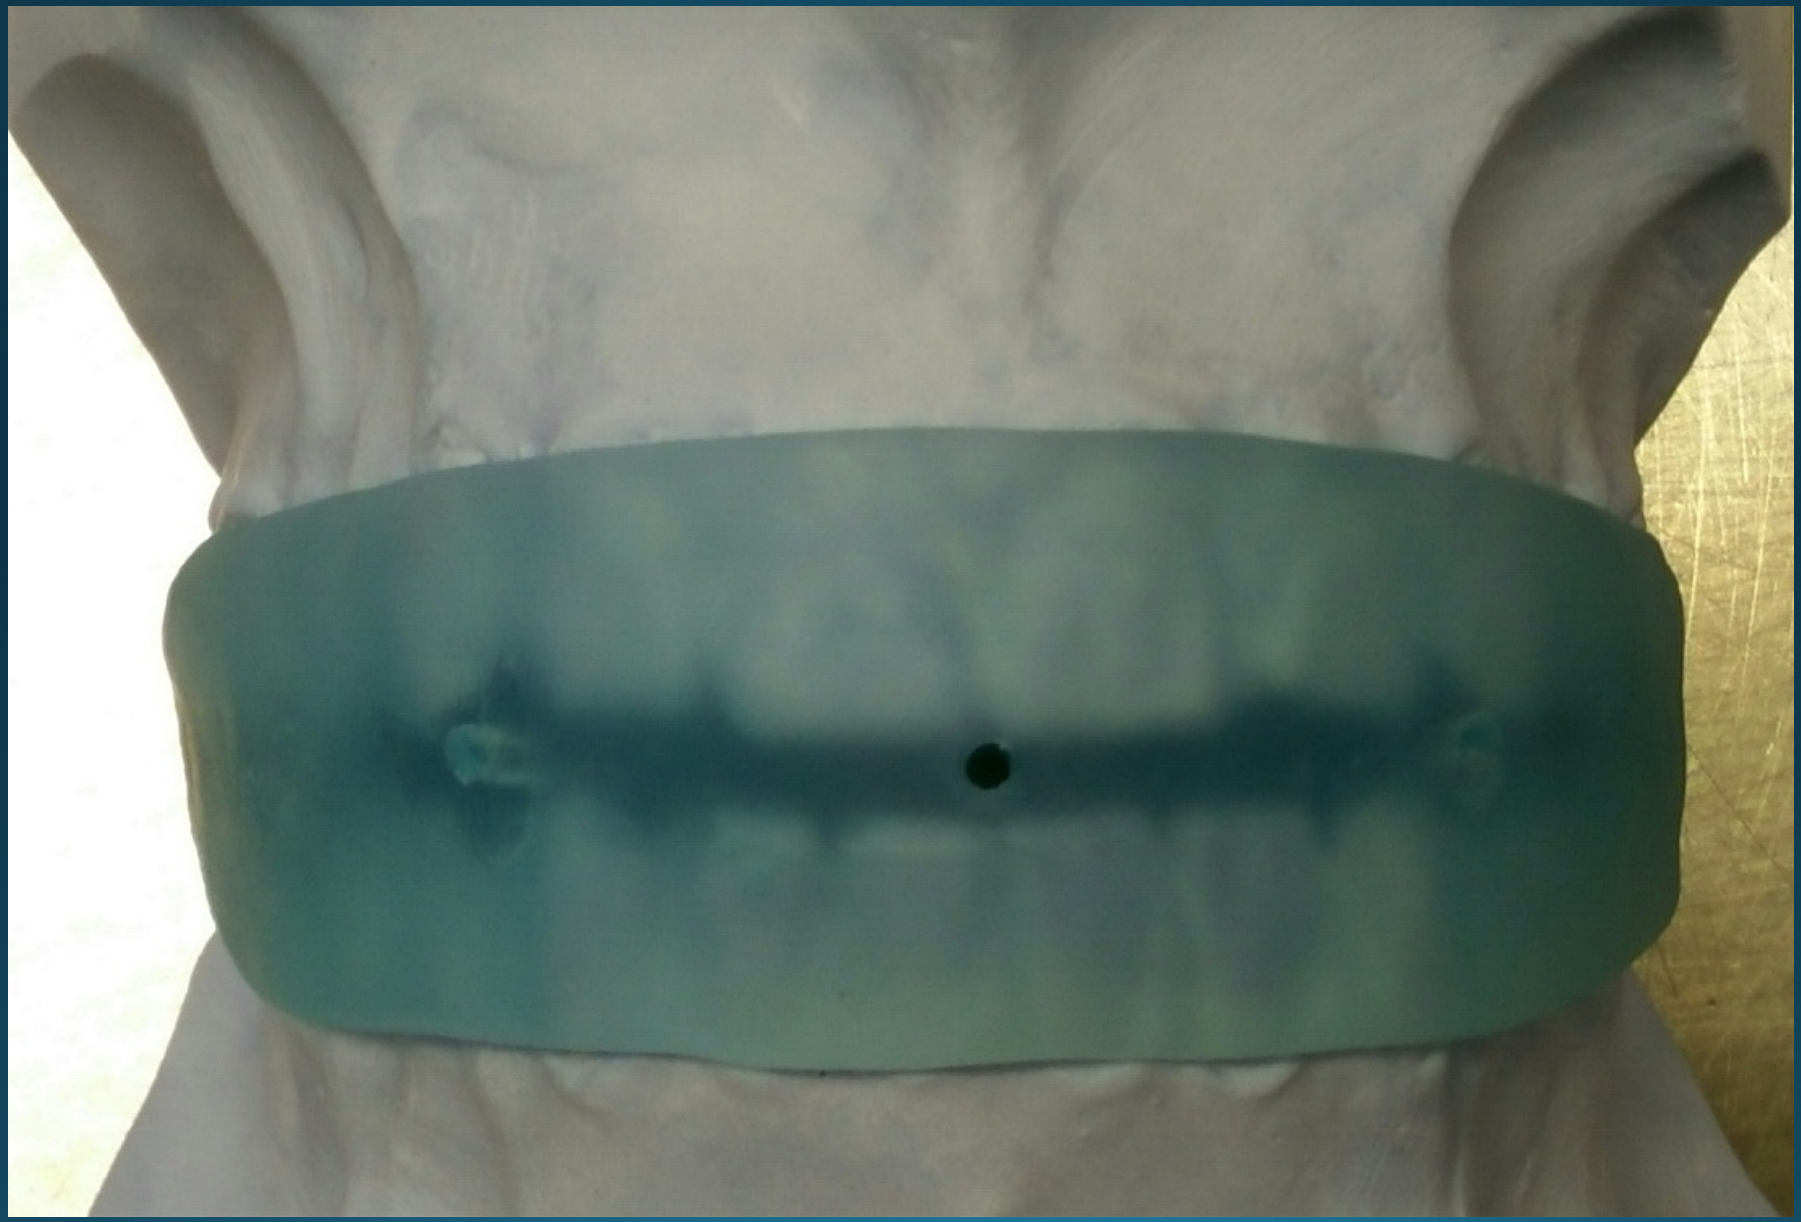

Manipulation
Configuration
Analyse
Comparaison de modèles
3shape


Setup virtuel
Setup actuel :
28/08/2015 16:46:41
Défaut
28/08/2015 16:46:41
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
3shape

PRE-FINISHER
POSITIONNER

LA SOLUTION GLOBALE 3D

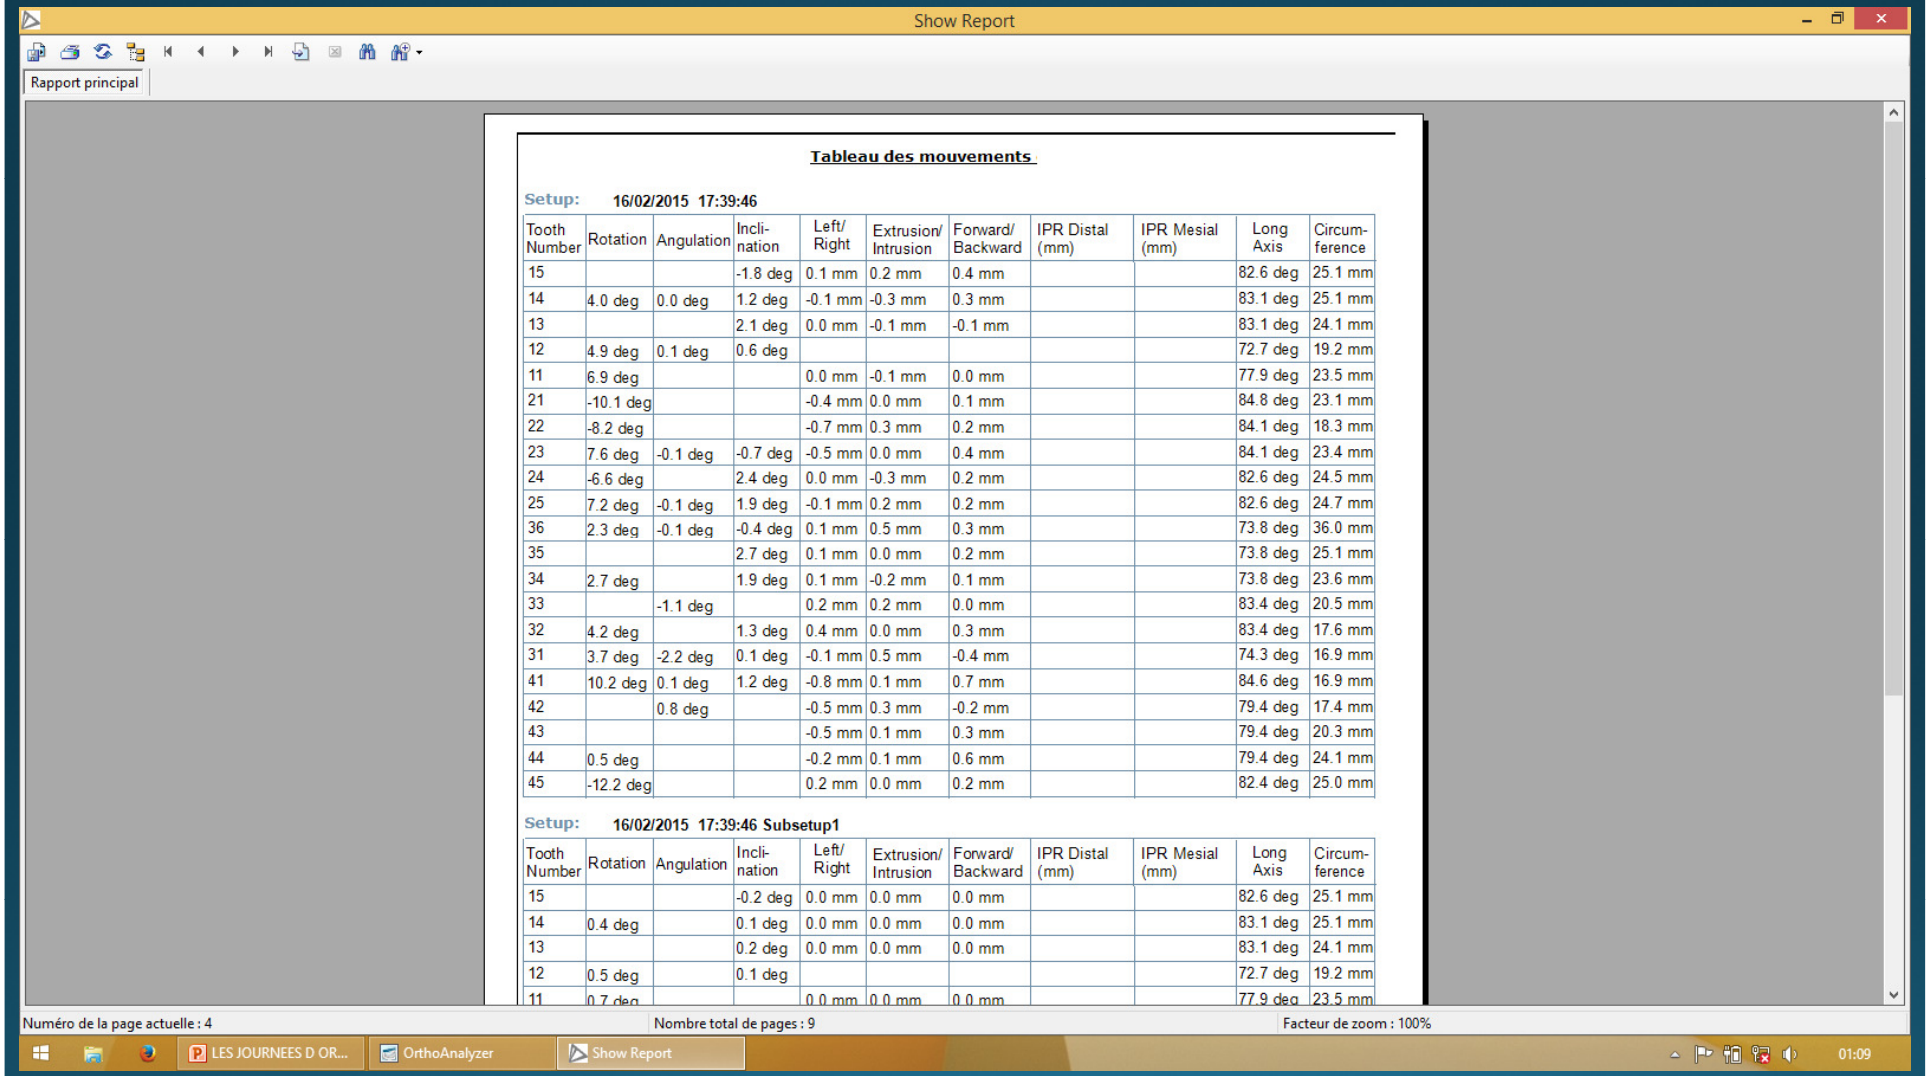
Dans le cadre d'alignements parfaits d'arcades et d'optimisation occlusale



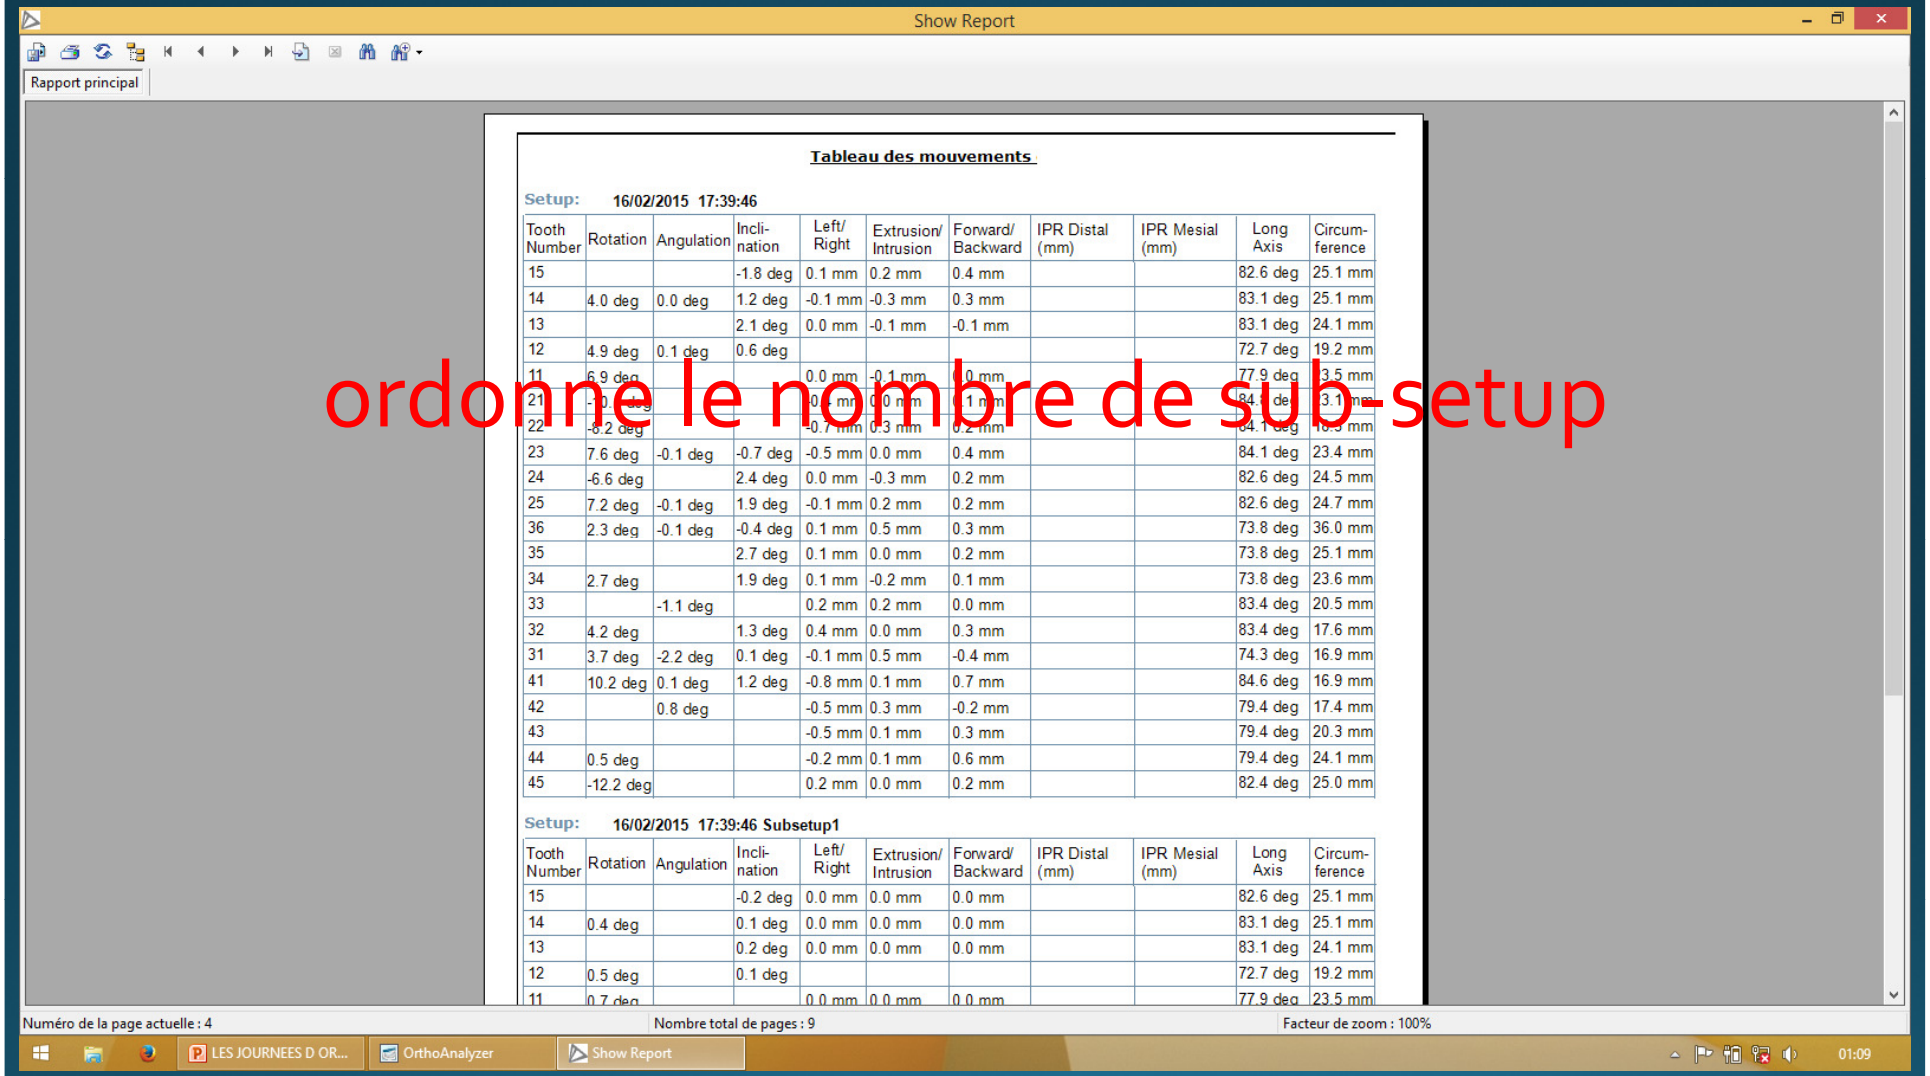
GOUTTIERES SUCCESSIVES

LA SOLUTION GLOBALE 3D

Le rapport principal des mouvements

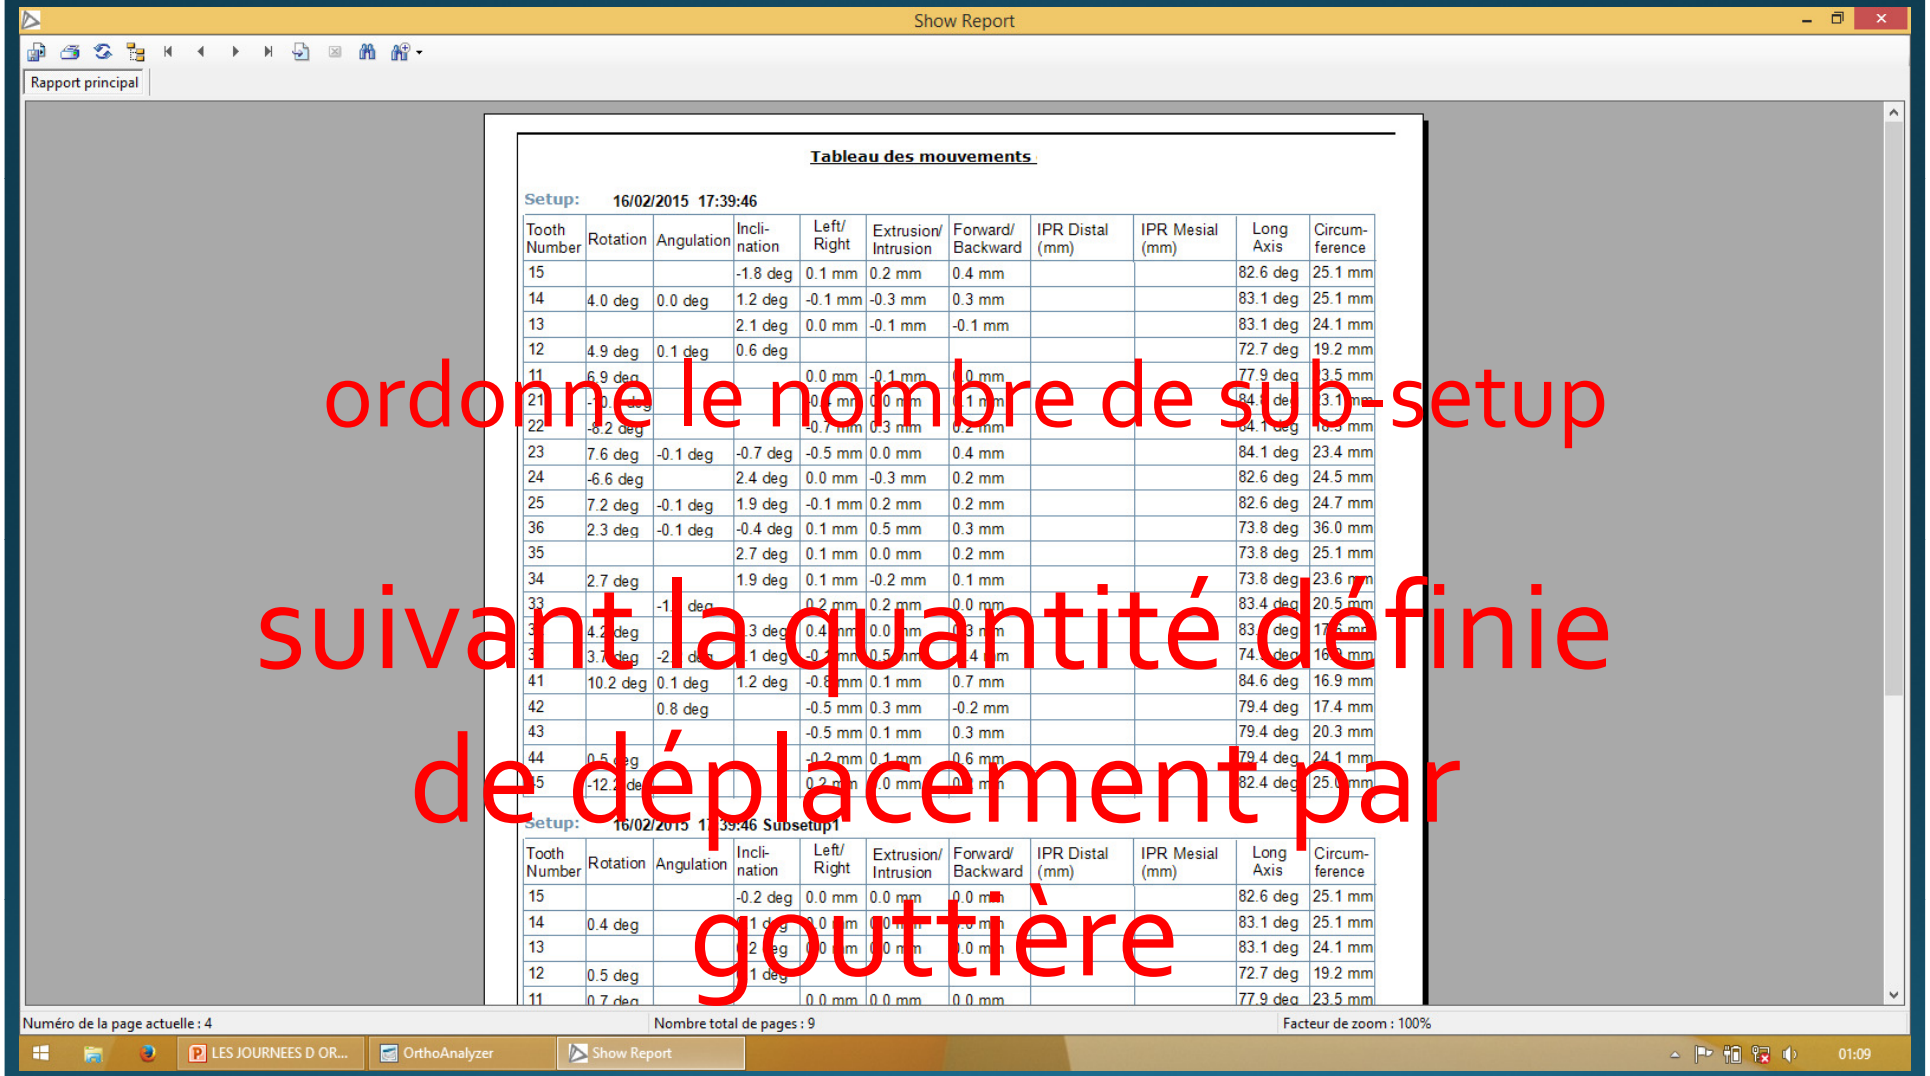


Le rapport principal des mouvements

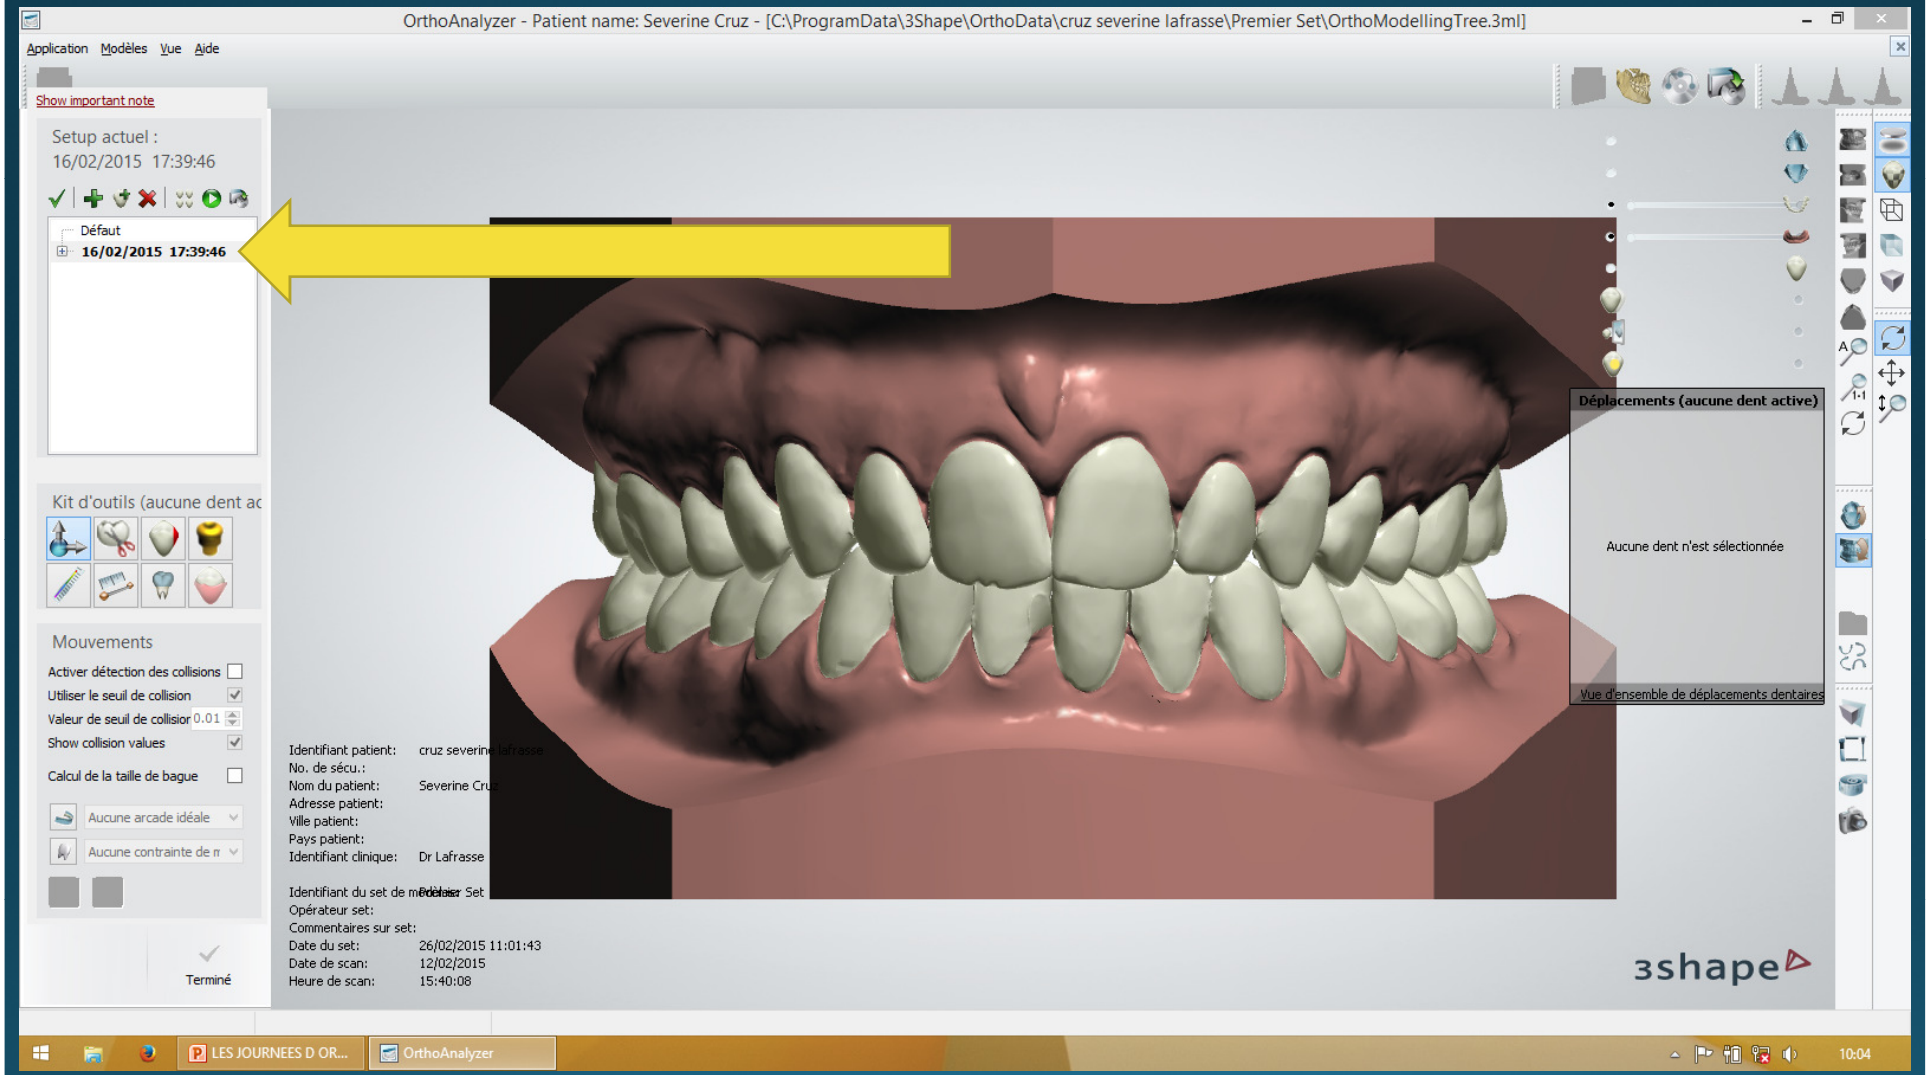


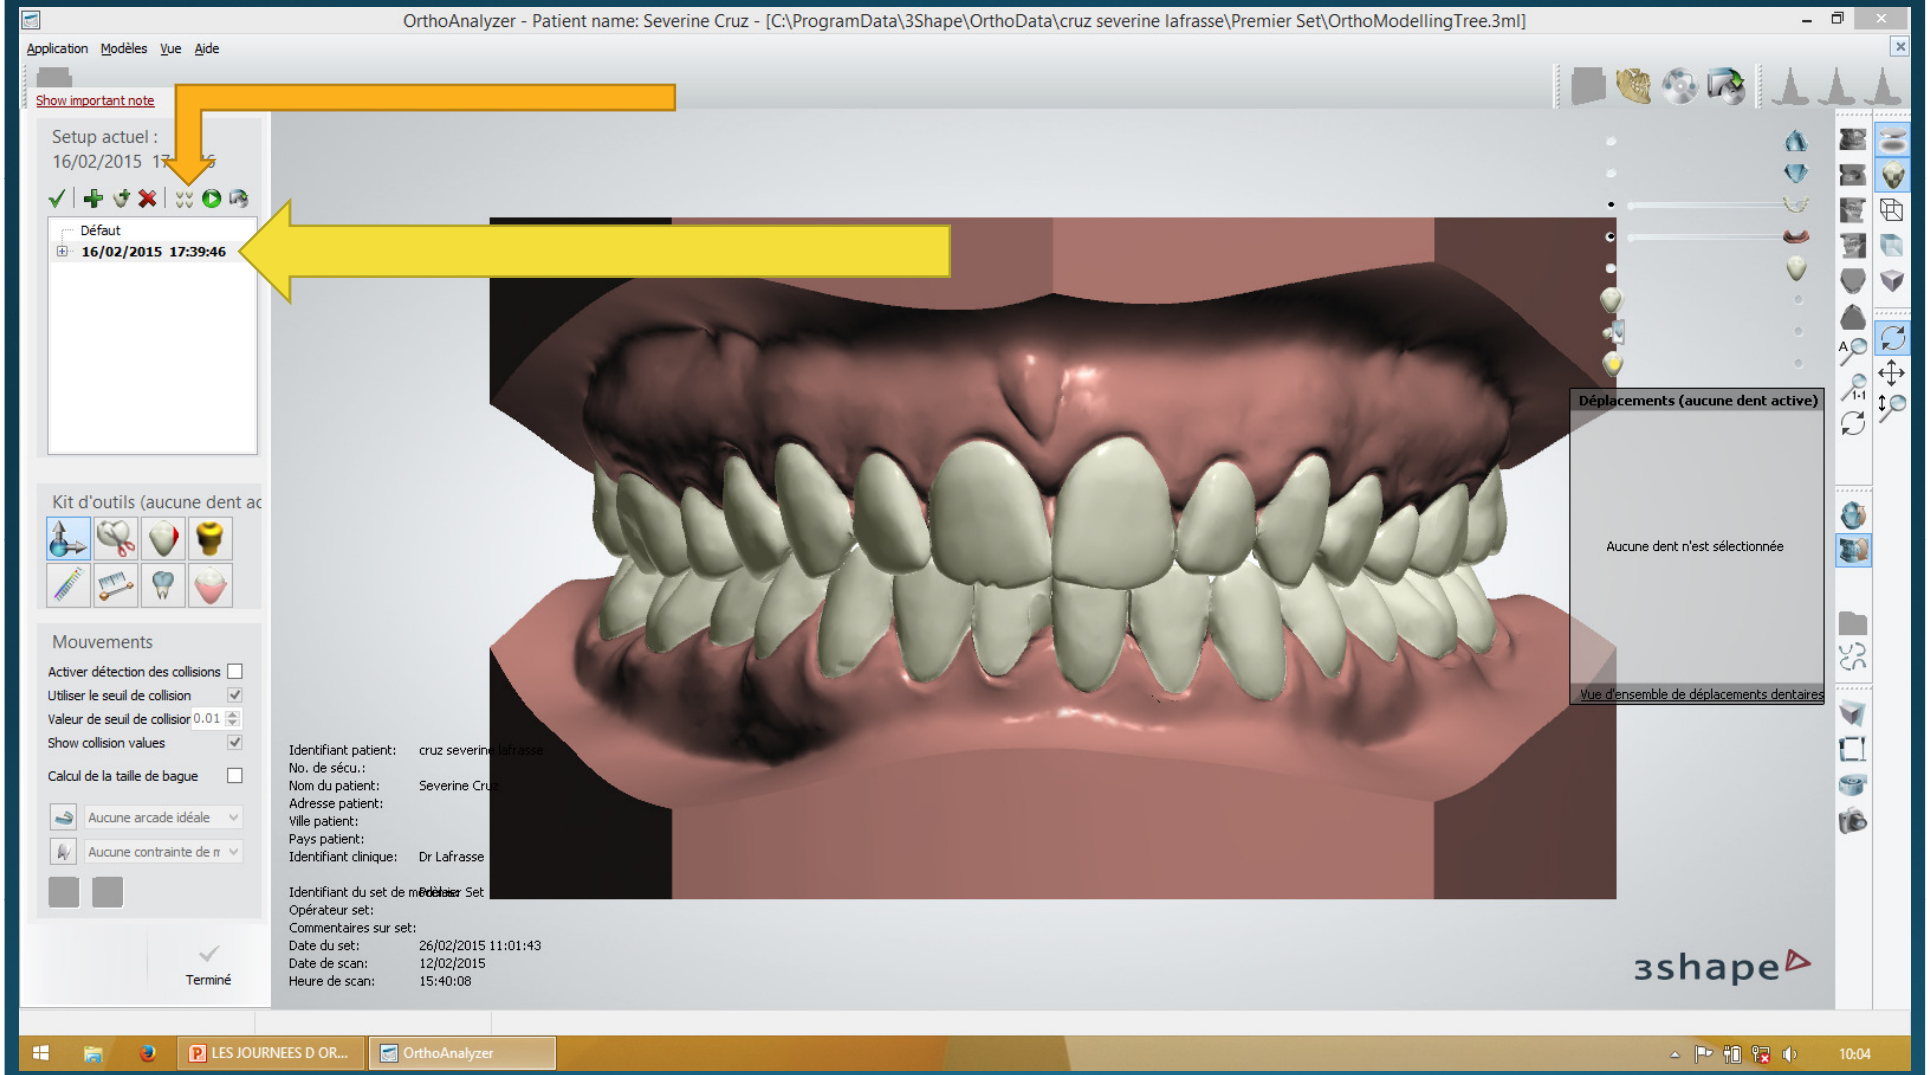
ordonne le nombre de sub-setup

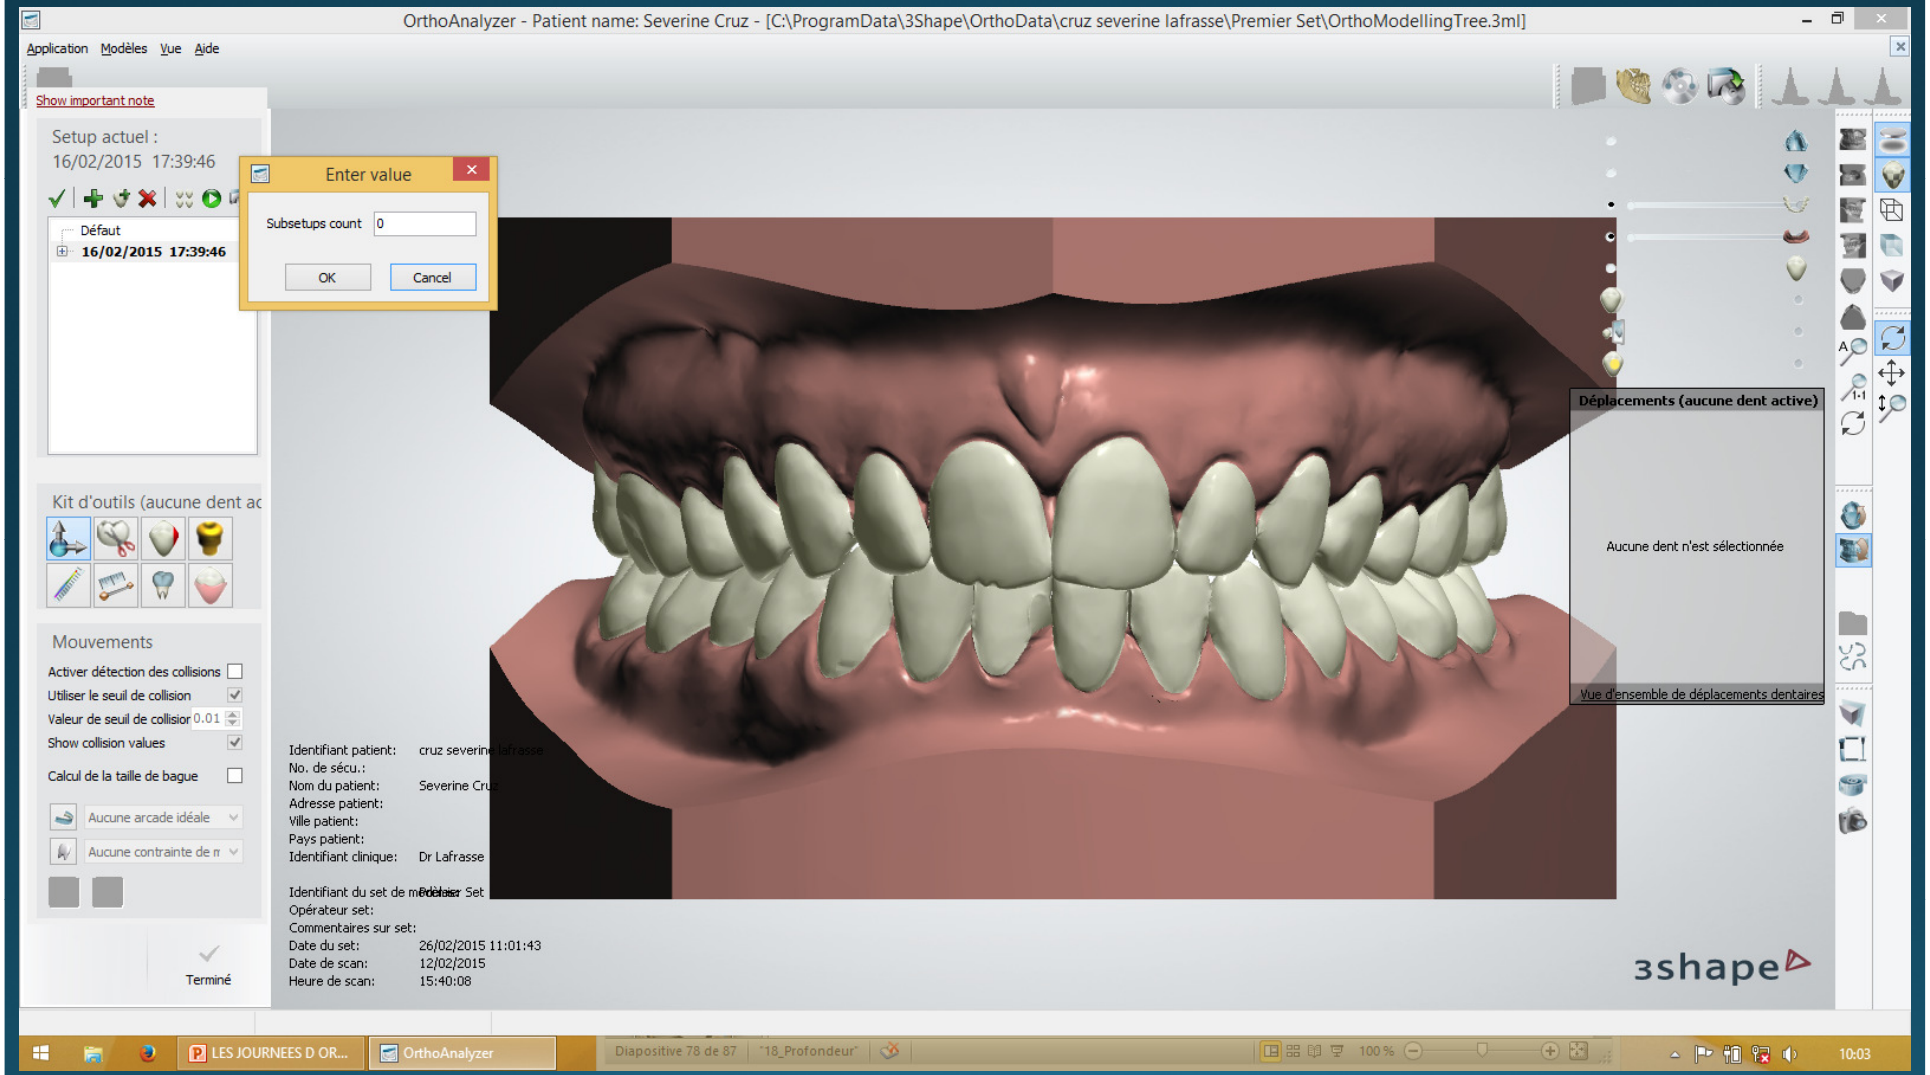
Le rapport principal des mouvements

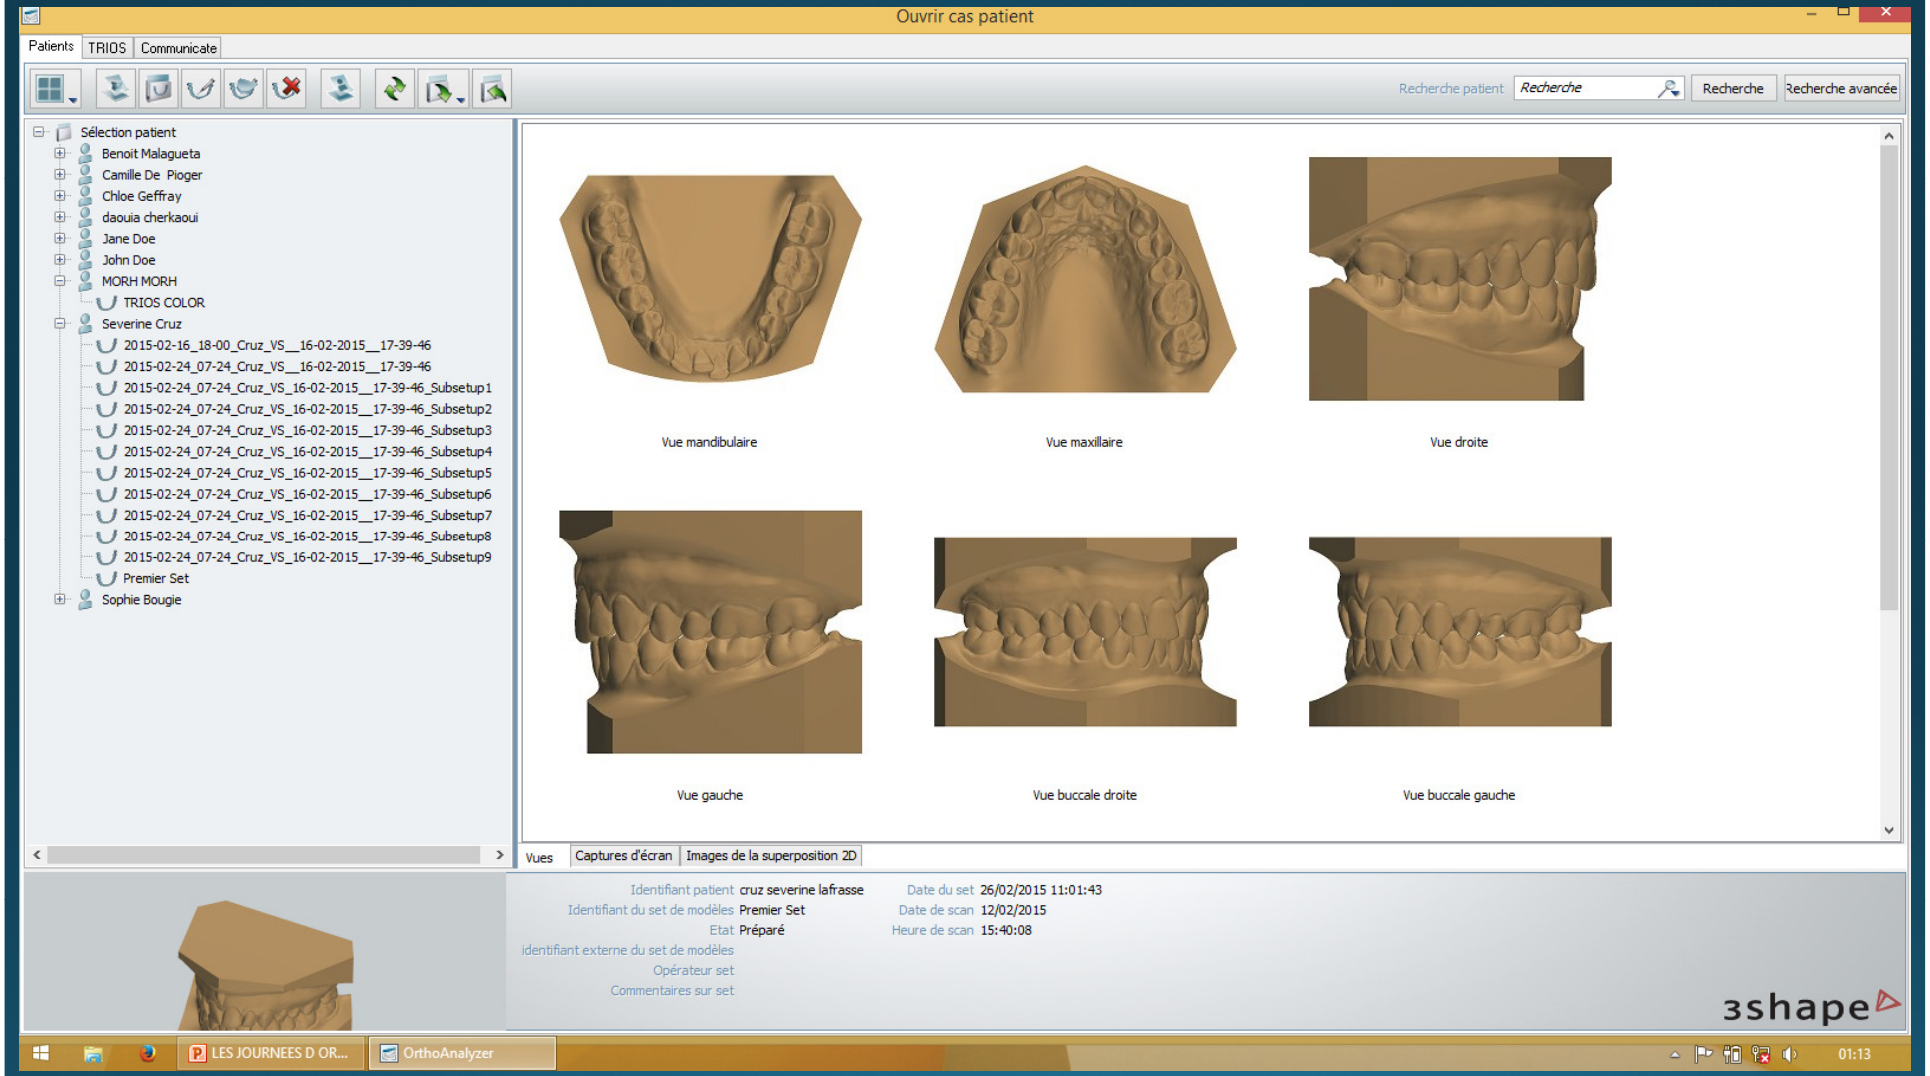


ordonne le nombre de sub-setup suivant la quantité définie de déplacement par gouttière

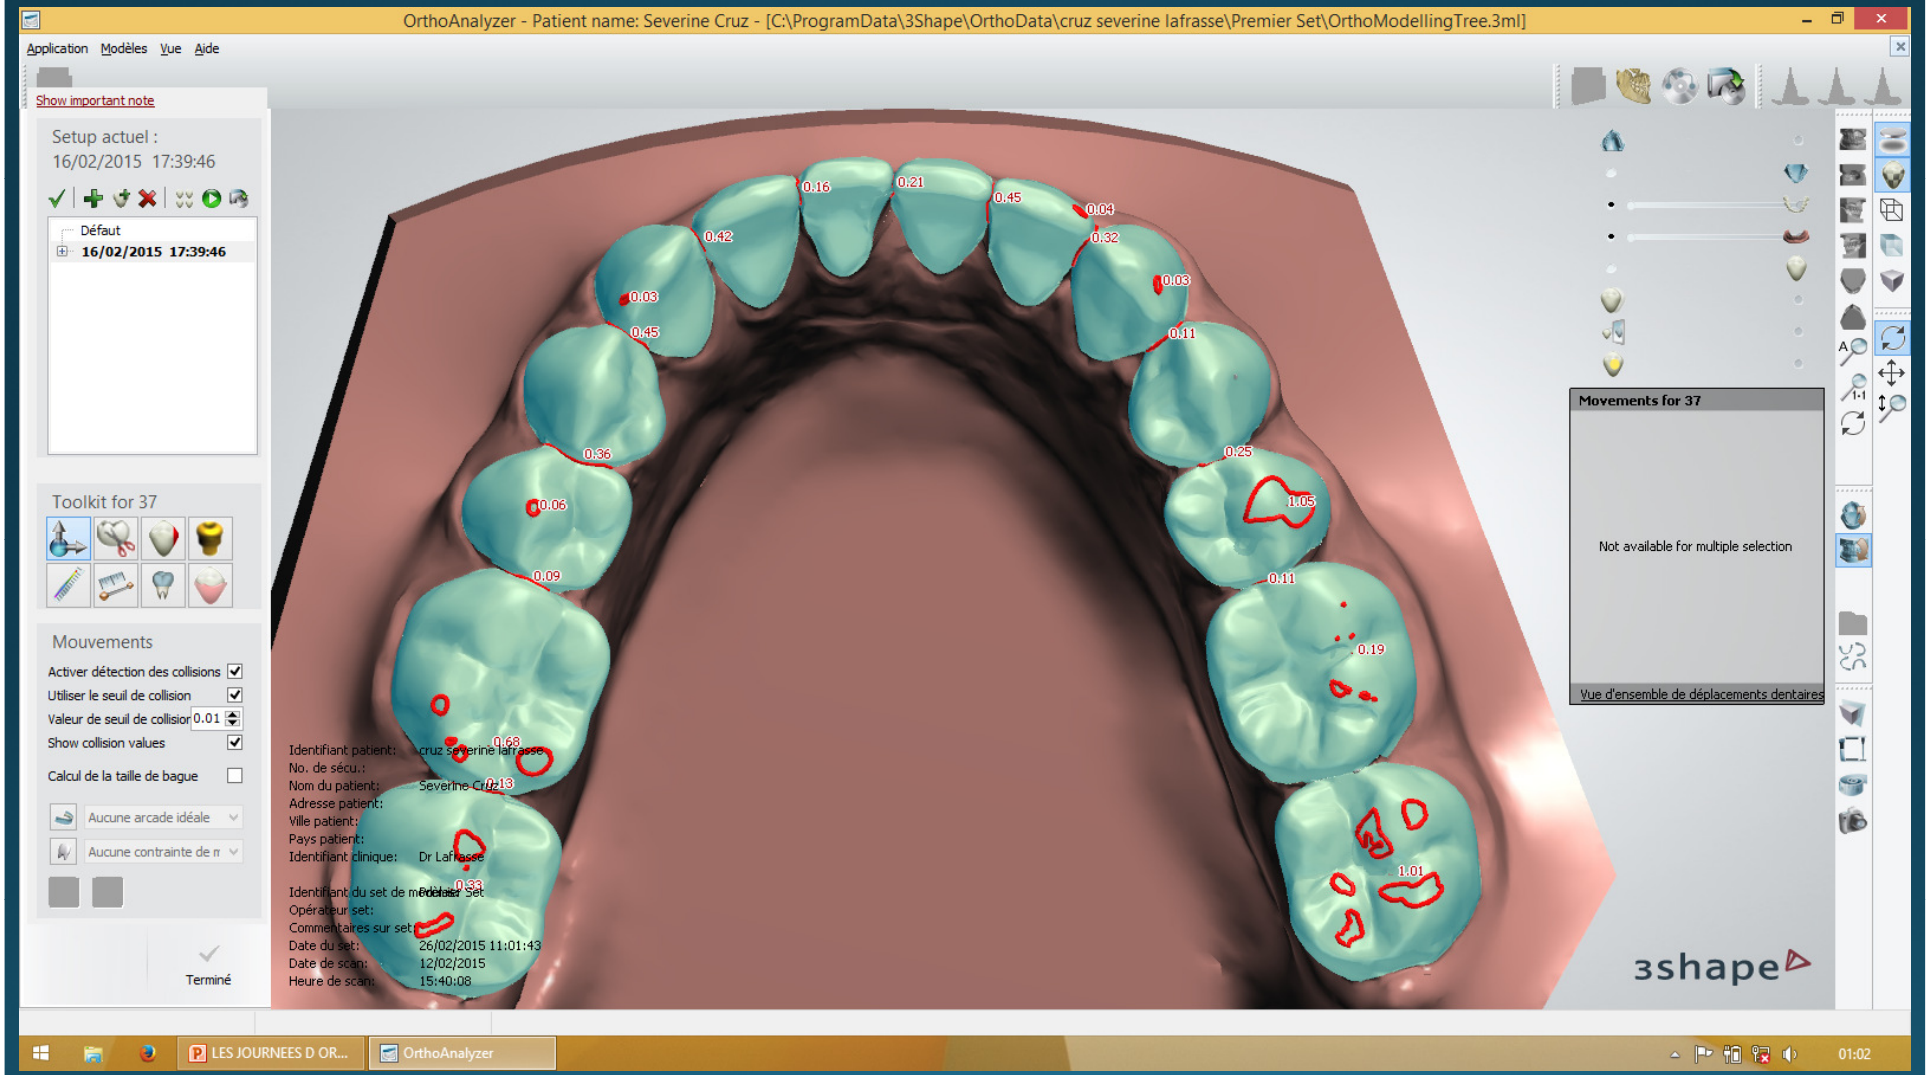

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cru
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Identifiant du set de modèles: Premier Set
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
10:04

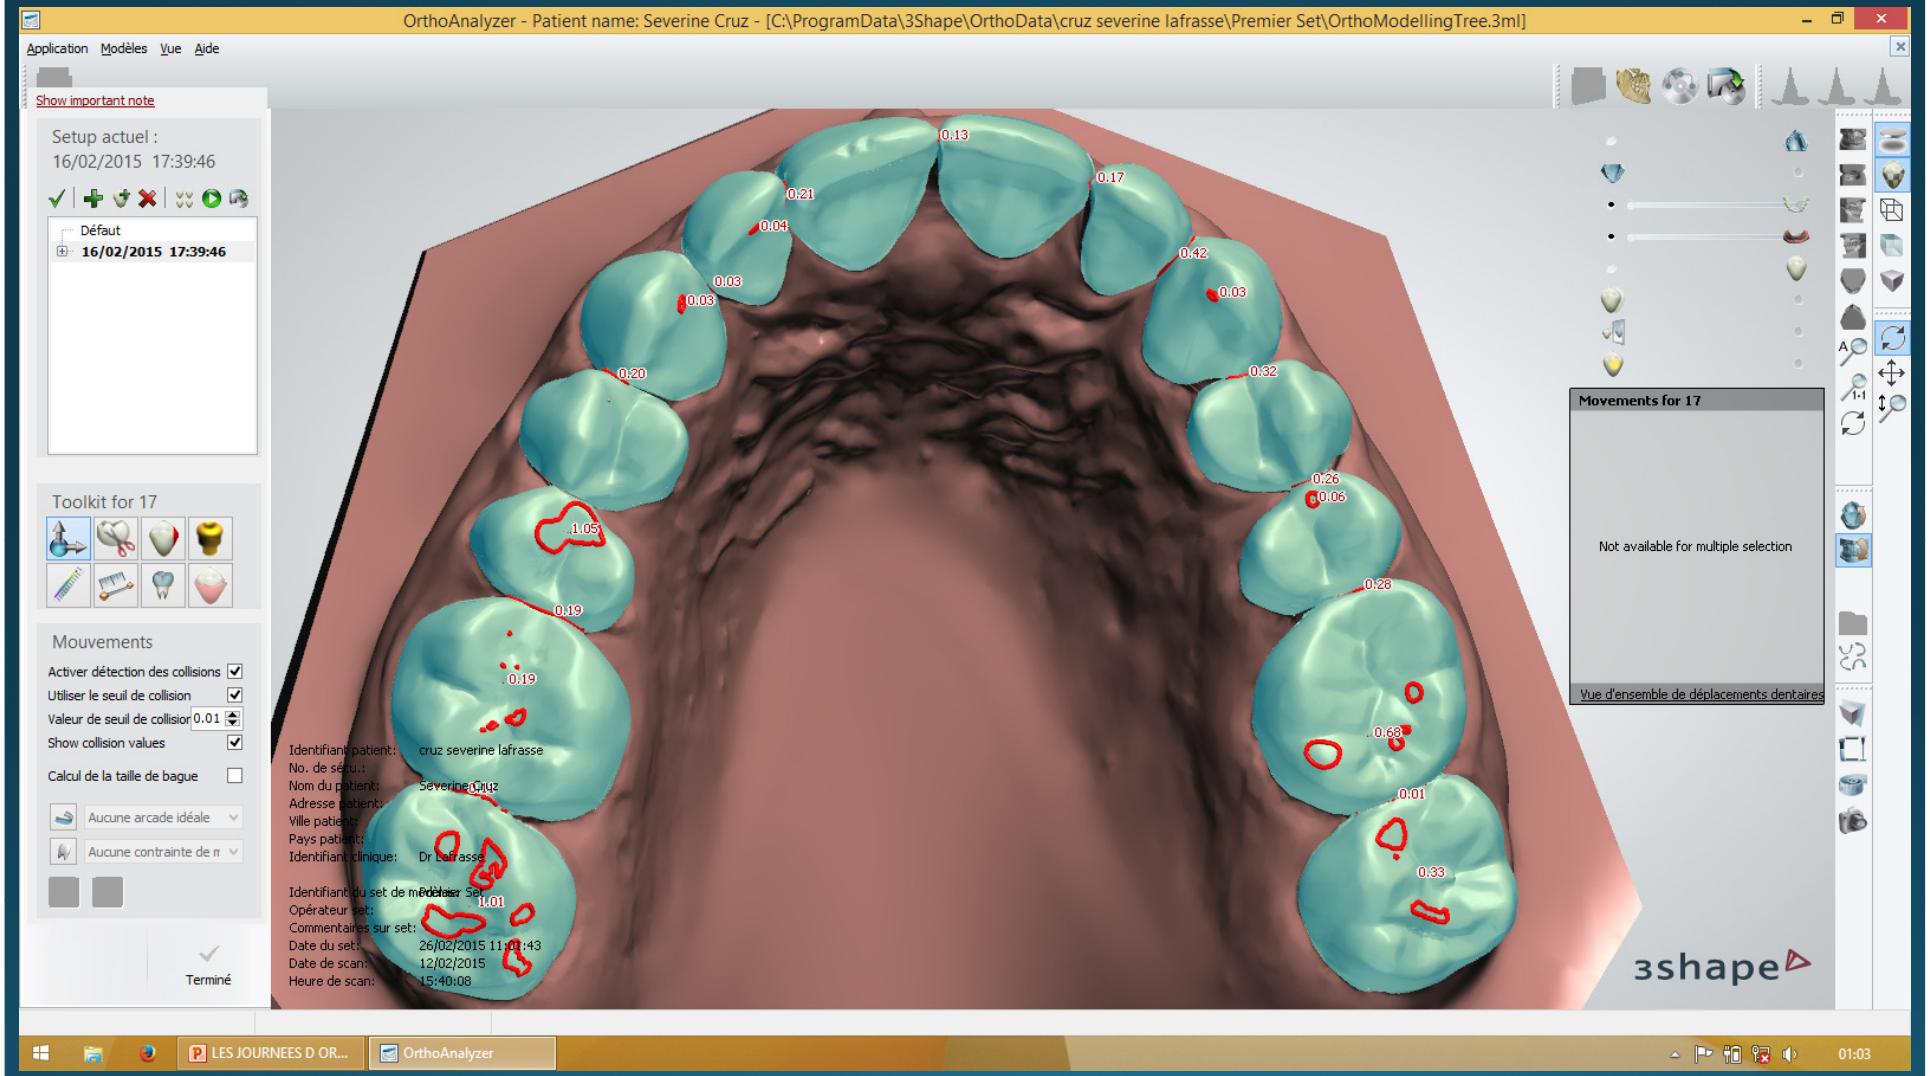

OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cru
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Identifiant du set de modèles: Premier Set
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
10:04


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Enter value
Subsetups count 0
OK
Cancel
Kit d'outils (aucune dent ac
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de m
Terminé
Déplacements (aucune dent active)
Aucune dent n'est sélectionnée
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cru
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Identifiant du set de modèles: Premier Set
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
Diapositive 78 de 87
'18_Profondeur'
100 %
10:03


Ouvrir cas patient
Patients
TRIOS
Communicate
Recherche patient
Recherche
Recherche
Recherche avancée
Sélection patient
Benoit Malagueta
Camille De Pioger
Chloe Geffray
daouia cherkaoui
Jane Doe
John Doe
MORH MORH
TRIOS COLOR
Severine Cruz
2015-02-16_18-00_Cruz_VS__16-02-2015__17-39-46
2015-02-24_07-24_Cruz_VS__16-02-2015__17-39-46
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup1
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup2
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup3
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup4
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup5
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup6
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup7
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup8
2015-02-24_07-24_Cruz_VS_16-02-2015__17-39-46_Subsetup9
Premier Set
Sophie Bougie
Vue mandibulaire
Vue maxillaire
Vue droite
Vue gauche
Vue buccale droite
Vue buccale gauche
Vues
Captures d'écran
Images de la superposition 2D
Identifiant patient cruz severine lafrasse
Identifiant du set de modèles Premier Set
Etat Préparé
identifiant externe du set de modèles
Opérateur set
Commentaires sur set
Date du set 26/02/2015 11:01:43
Date de scan 12/02/2015
Heure de scan 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:13

Le stripping?


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Toolkit for 37
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collisior 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de r
Terminé
Movements for 37
Not available for multiple selection
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de sécu.:
Nom du patient: Severine Cruz
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Opérateur set:
Commentaires sur set
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:02


OrthoAnalyzer - Patient name: Severine Cruz - [C:\ProgramData\3Shape\OrthoData\cruz severine lafrasse\Premier Set\OrthoModellingTree.3ml]
Application Modèles Vue Aide
Show important note
Setup actuel :
16/02/2015 17:39:46
Défaut
16/02/2015 17:39:46
Toolkit for 17
Mouvements
Activer détection des collisions
Utiliser le seuil de collision
Valeur de seuil de collision 0.01
Show collision values
Calcul de la taille de bague
Aucune arcade idéale
Aucune contrainte de m
Terminé
Movements for 17
Not available for multiple selection
Vue d'ensemble de déplacements dentaires
Identifiant patient: cruz severine lafrasse
No. de séc.u.:
Nom du patient: Severine Cruz
Adresse patient:
Ville patient:
Pays patient:
Identifiant clinique: Dr Lafrasse
Identifiant du set de modèles: Set
Opérateur set:
Commentaires sur set:
Date du set: 26/02/2015 11:01:43
Date de scan: 12/02/2015
Heure de scan: 15:40:08
3shape
LES JOURNEES D OR...
OrthoAnalyzer
01:03

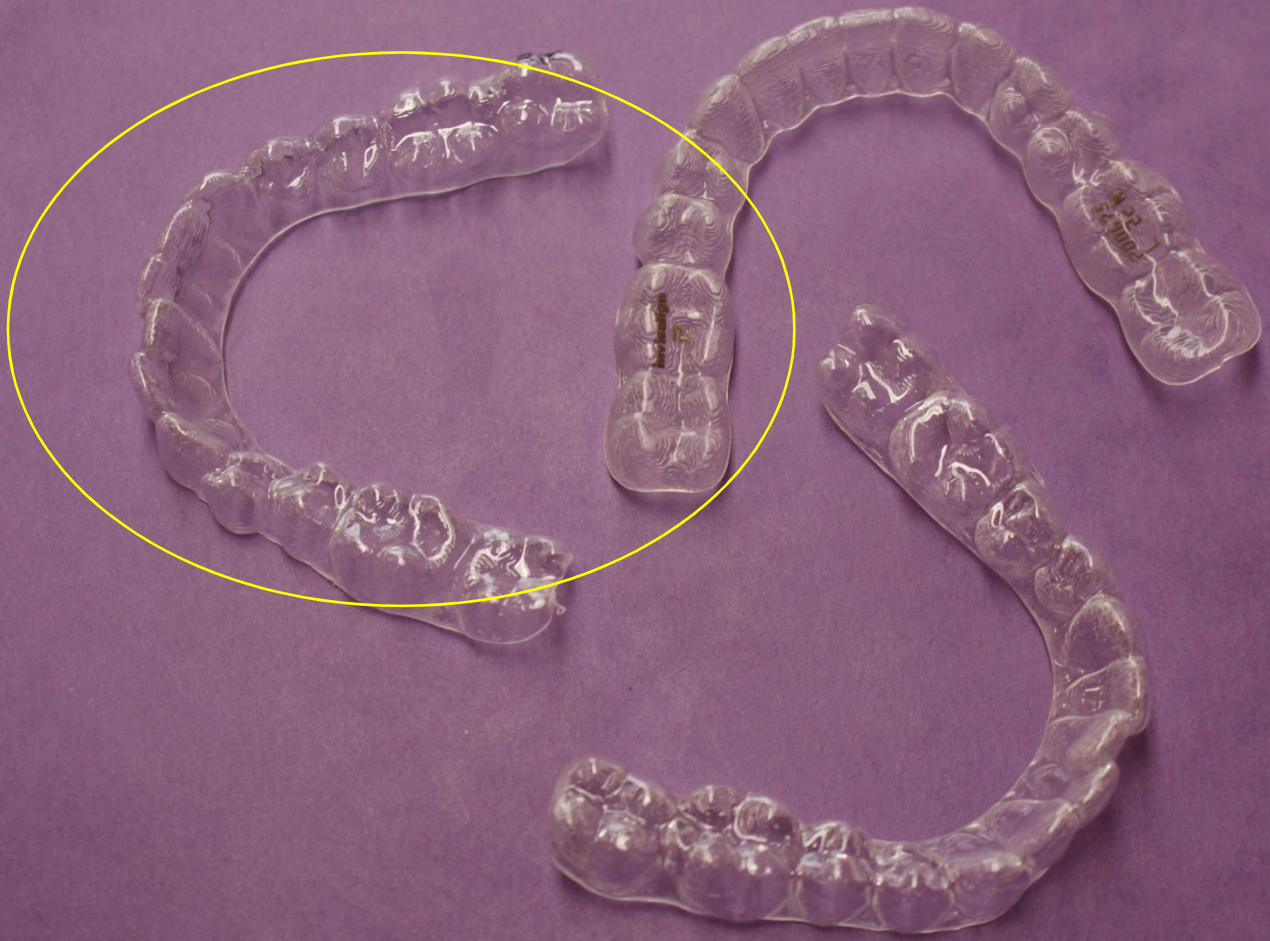
Quel choix dans les plaques thermoformables?



Quel choix dans les plaques thermoformables?



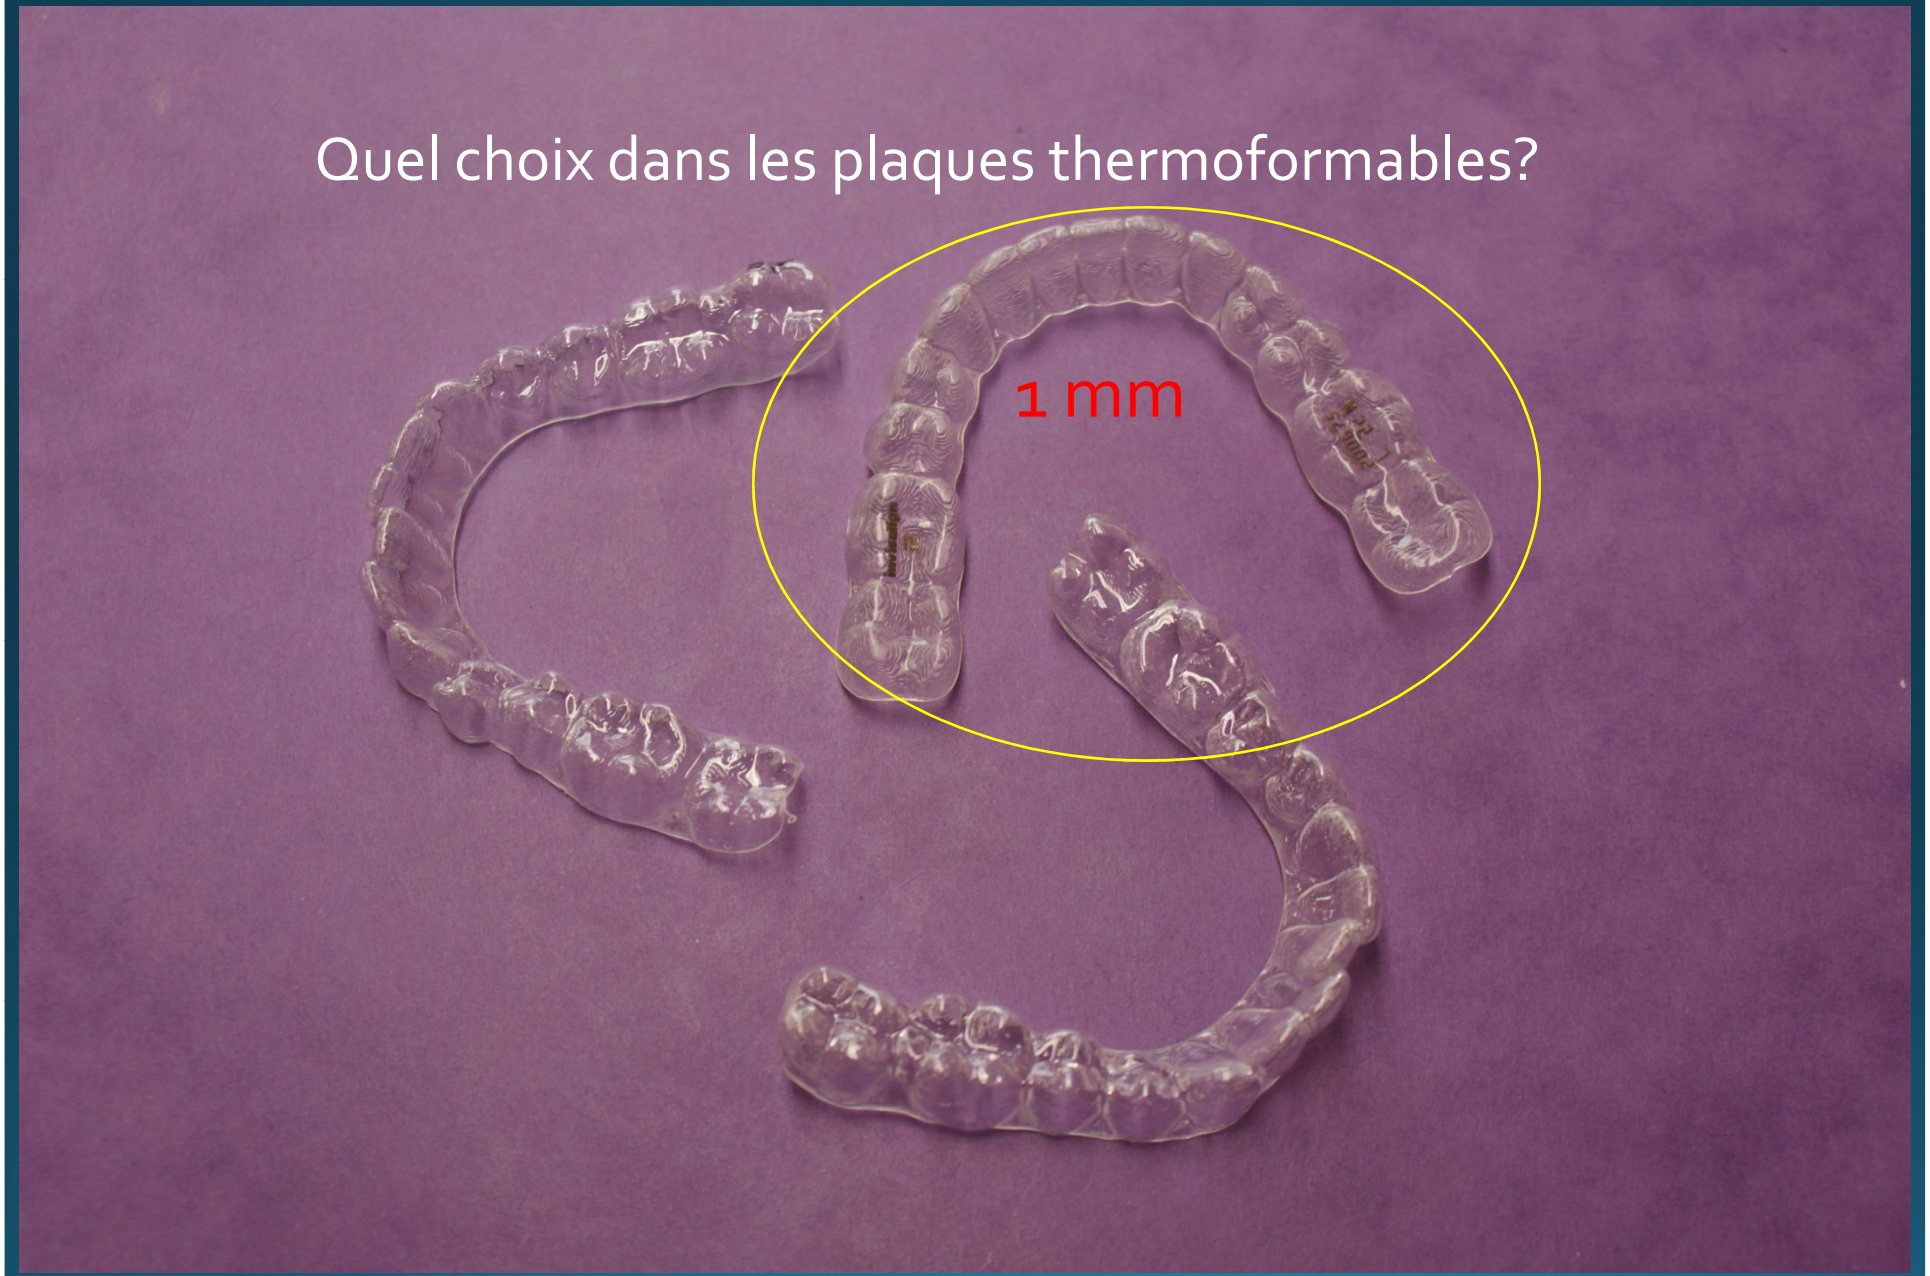
Quel choix dans les plaques thermoformables?



Quel choix dans les plaques thermoformables?



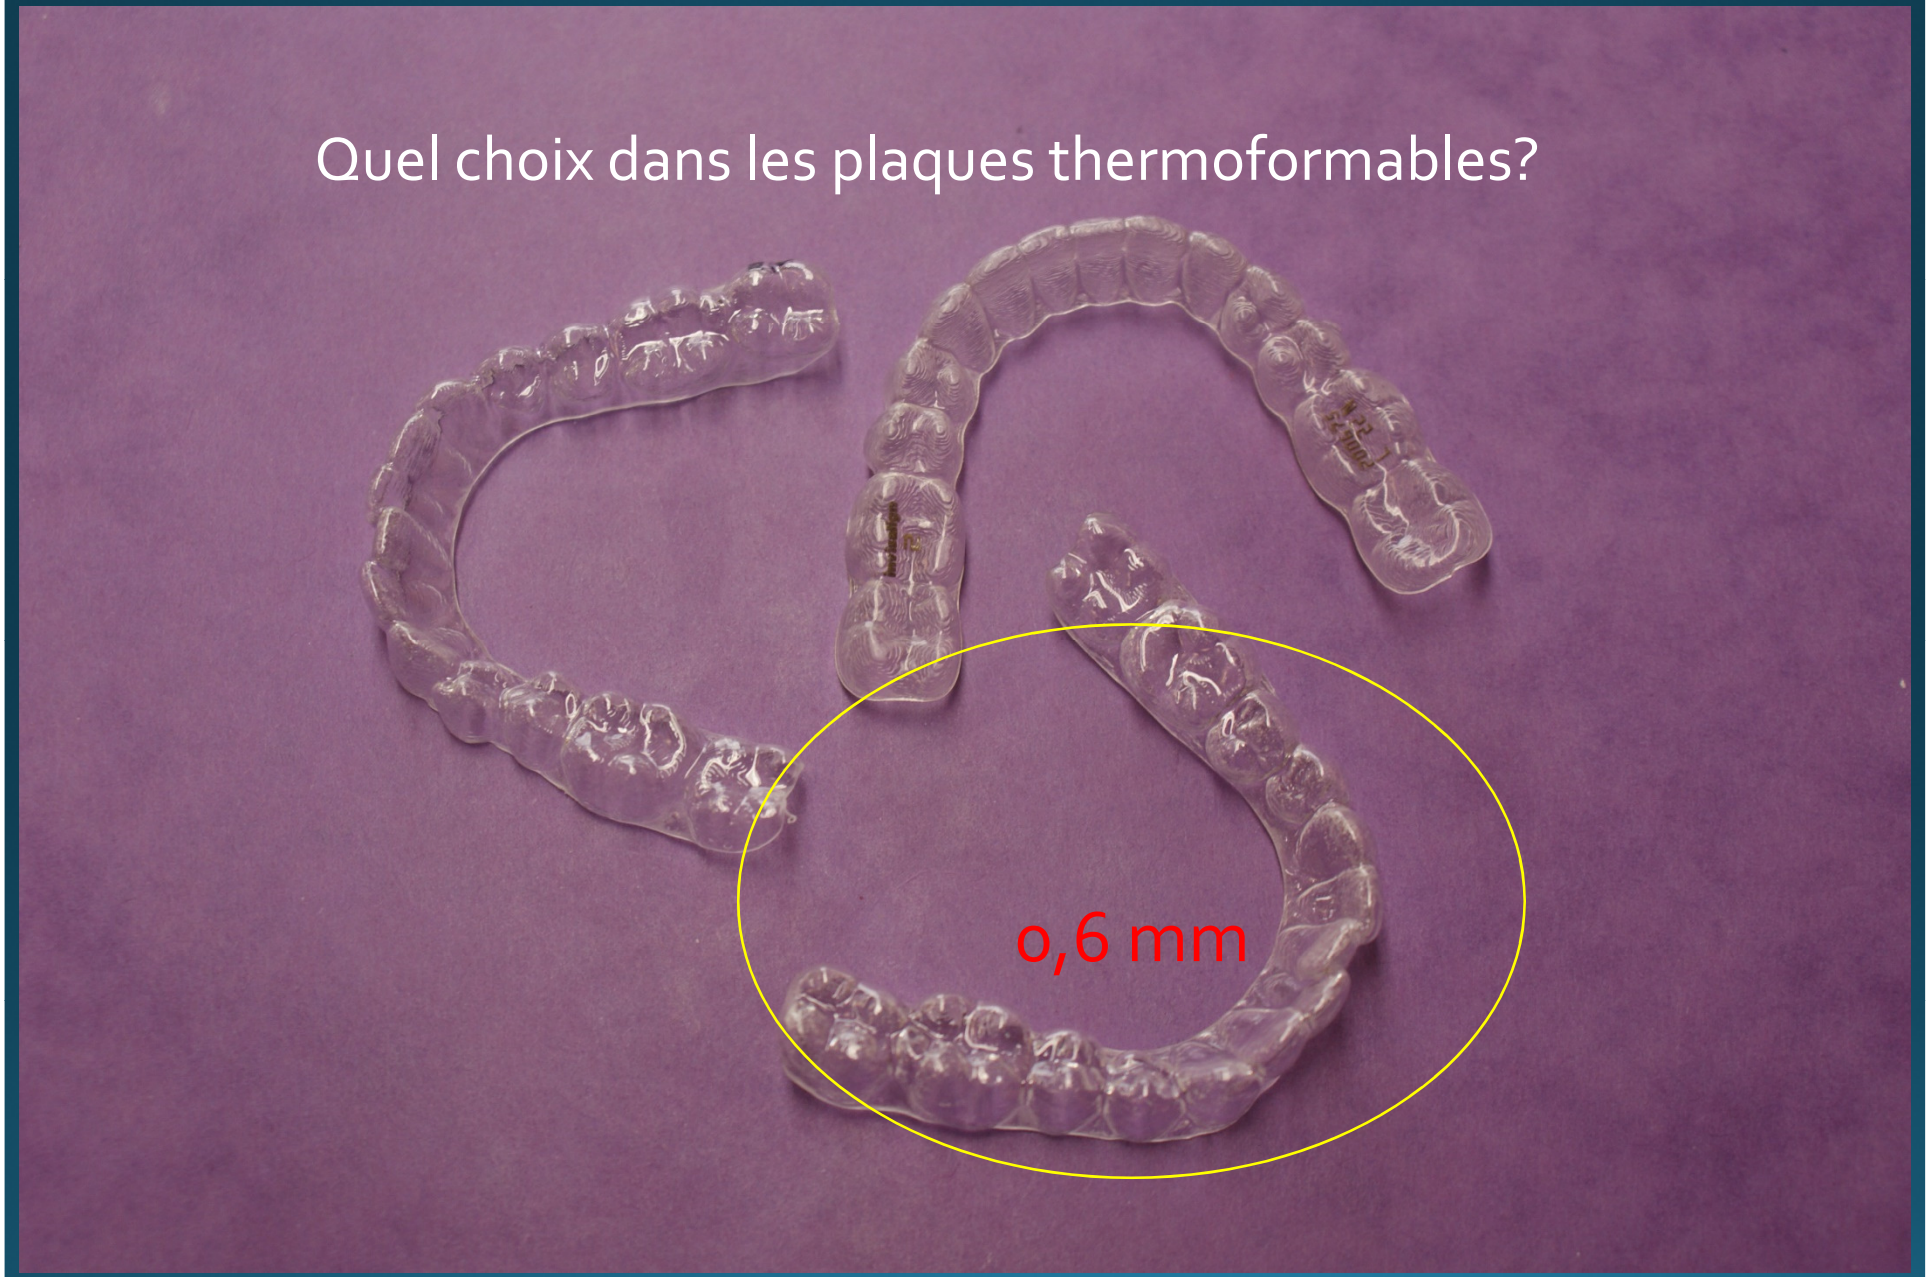
Quel choix dans les plaques thermoformables?



Quel choix dans les plaques thermoformables?



Quel choix dans les plaques thermoformables?



LES ORTHESES

LA SOLUTION GLOBALE 3D


36059



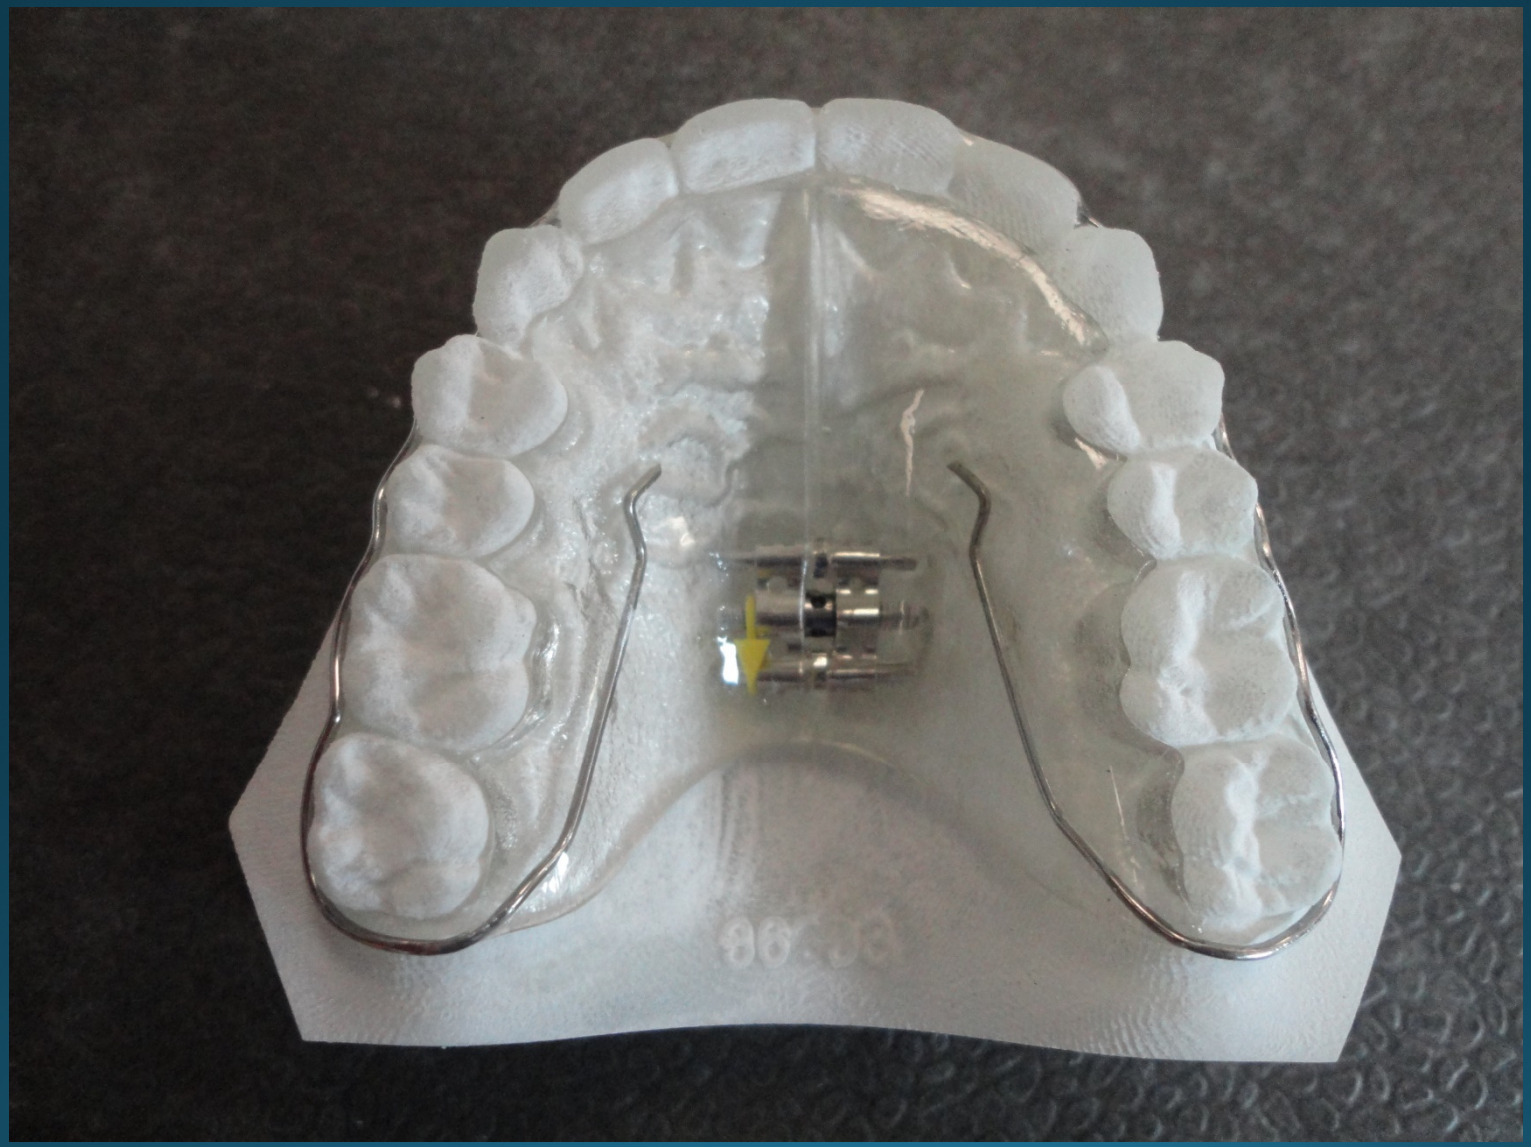

34654















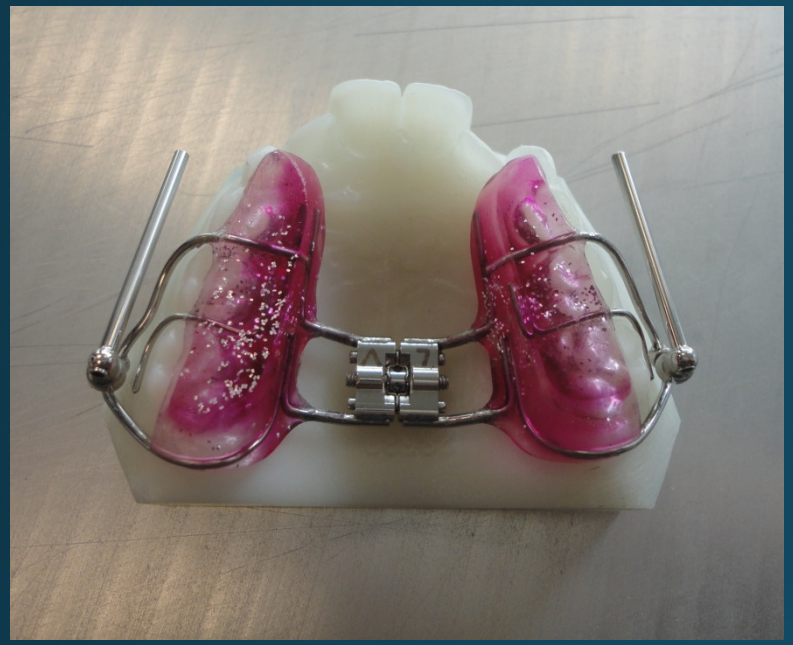

LORY




346540


24548















www.axe-ortho.fr

hubert.droy@orange.fr